



## SERVIZIO PROVVEDITORATO

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE, RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'ALLESTIMENTO DI FARMACI ANTIBLASTICI PER L'U.M.A.C.A. DEL P.O. MOSCATI DI AVERSA.**

**Numero Gara ANAC 9076811**

**Valore totale stimato € 901.000,00 oltre IVA, di cui base d'asta € 530.000,00 opzione del rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi € 265.000,00.**

## PROCESSO VERBALE n. 5

L'anno duemilaventitrè il giorno trenta (30) del mese di Ottobre alle ore 09:30 presso gli uffici dell'UOC Provveditorato dell'Asl Caserta si è riunito in seduta riservata il Seggio di gara costituito da:

- Dott.ssa Marisa Di Sano – Direttore del Servizio Provveditorato – RUP - **Presidente;**
- Dr.ssa Gioia Giuseppina Cristofaro – Collaboratore Amministrativo del Servizio Provveditorato - **Componente**
- Dott.ssa Floriana Landolfi – Collaboratore Amministrativo del Servizio Provveditorato - **Segretario Verbalizzante**

**È altresì presente**, per la verifica della conformità delle offerte tecniche e della relativa campionatura presentata dalle Ditte partecipanti alla gara, quale Referente Delegato dal Direttore del Dipartimento Farmaceutico Funzionale, il Dr. Valerio Marotta – Farmacista Dirigente P.O. "S.G. Moscati" di Aversa – **Referente Tecnico**

## PREMESSO

- che, in data 11/10/2023 il RUP, in vista dell'apertura delle Buste tecniche e della valutazione tecnica della campionatura e della documentazione ivi contenuta, aveva proceduto con nota prot. n. 0237613/PROVV a richiedere al Direttore *f.f.* del Dipartimento Farmaceutico, la nomina di un Referente Tecnico per la valutazione delle offerte tecniche e della relativa campionatura;
- che con nota prot. n. 0242095/DF del 16.10.2023, il Direttore *f.f.* del Dipartimento Farmaceutico individuava, quale Referente Tecnico, il Dott. Valerio Marotta – Farmacista Dirigente P.O. "S.G. Moscati" di Aversa;

- che nella seduta pubblica del 24/10/2023, come da verbale n. 4, il Seggio di gara procedeva con l'apertura delle buste tecniche, riservandosi di procedere in sedute riservate, successive, per la verifica di conformità da parte del Referente Tecnico, della Campionatura pervenuta e della documentazione contenuta nelle buste tecniche presentate dagli O.E. concorrenti, rispetto alle specifiche tecniche richieste;

- che, contattato il Referente Tecnico, il Dr. Valerio Marotta, per le vie brevi, comunicava la disponibilità a recarsi, per la data odierna, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato dell'Asl Caserta, per l'espletamento della verifica di conformità della documentazione tecnica depositata sulla piattaforma SIAPS e della campionatura presentata, come da attestazione del protocollo Generale ASL prot. n. 179259/AAGG del 24/07/2023, dagli O.E. concorrenti per la partecipazione alla gara in oggetto;

### TANTO PREMESSO

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza per la presenza di tutti i componenti facenti parte del Seggio di gara nonché del Referente Tecnico, dichiara validamente aperta la seduta.

Il Seggio di gara mostra al Referente Tecnico la documentazione tecnica presentata dagli O.E. concorrenti e gli consegna la campionatura presentata dagli O.E., come da nota prot. n. 179259/AAGG del 24/07/2023, al fine di verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, e se siano tra di loro equivalenti.

A questo punto, il Referente Tecnico procede con la compilazione della "TABELLA" (All. 1), nella quale sono riportati ciascuno dei 9 lotti di cui si compone la gara, il numero di offerenti per lotto e, per ciascuno di essi, l'indicazione "CONFORME" e "NON CONFORME", a seconda che il prodotto presentato sia o meno conforme alle caratteristiche suindicate.

Il Referente Tecnico procede quindi con la valutazione a partire dal **LOTTO N. 1**.

Il Referente Tecnico procede con la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura offerta dagli Operatori Economici partecipanti al **LOTTO N. 1**, per il quale sono state presentate n. 3 offerte.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. ICU MEDICAL EUROPE S.r.l., rileva che, *"Dalle schede tecniche presentate per i dispositivi 011-CL-72 e 011-CL-70S si evince che il sistema offerto al lotto 1 è corredato di un semplice filtro idrofobico per l'equalizzazione di pressione, privo di barriera specifica per il blocco dell'emissione di vapori (gas) all'esterno del sistema. Pertanto, il sistema offerto al lotto 1 non risulta conforme alle specifiche di sicurezza richieste"*, pertanto non è conforme a quanto stabilito negli atti di gara; NON CONFORME.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. MEDINAT SRL, riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.



Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. SCOGNAMIGLIO SRL, rileva che *"Dai documenti presentati per il sistema offerto al lotto 1 (costituito dai punti 1, 2 e 3), non si evince il dato relativo al numero di aperture (accessi multipli) per le quali il sistema garantisce la sterilità del contenuto della linea/siringa/flaconcino cui è collegato. Tale specifica risulta espressamente richiesta dall' "Allegato 1 – Elenco fabbisogno" del capitolato di gara (valore minimo richiesto: 10 aperture). Pertanto, in assenza di tale informazione, il sistema offerto al lotto 1 non può essere valutato conforme."*, pertanto non è conforme a quanto stabilito negli atti di gara; NON CONFORME.

Il Referente Tecnico procede con la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura offerta dall'Operatore Economico partecipante al **LOTTO N. 2**, per il quale sono state presentate n. 1 offerte.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. ICU MEDICAL EUROPE S.r.l., riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Referente Tecnico procede con la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura offerta dall'Operatore Economico partecipante al **LOTTO N. 3**, per il quale sono state presentate n. 1 offerte.


Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. ICU MEDICAL EUROPE S.r.l., riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Referente Tecnico procede con la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura offerta dall'Operatore Economico partecipante al **LOTTO N. 4**, per il quale sono state presentate n. 1 offerte.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. ICU MEDICAL EUROPE S.r.l., riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Referente Tecnico procede con la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura offerta dagli Operatori Economici partecipanti al **LOTTO N. 5**, per il quale sono state presentate n. 3 offerte.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. ICU MEDICAL EUROPE S.r.l., riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

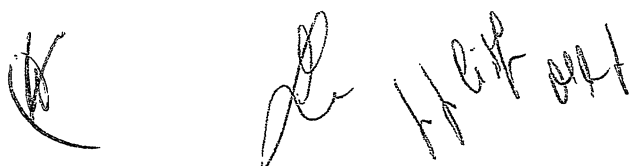

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. A.M.G. MEDICAL SRL, rileva che " *Il dispositivo offerto è privo di tappo di chiusura per il filtro aria con membrana idrofobica da 0.2 micron. La documentazione presentata non riporta il dato relativo al mantenimento della sterilità del farmaco anche dopo prelievi ripetuti (almeno 10 aperture della linea e 72 ore). Pertanto, il dispositivo offerto risulta non conforme alle specifiche richieste.*" pertanto non è conforme a quanto stabilito negli atti di gara; NON CONFORME.

Il Referente Tecnico, constatato il rispetto delle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico - e dall'Allegato A "Elenco Fabbisogno" - per i prodotti offerti dall'O.E. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A, riporta l'esito nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Referente Tecnico sospende i lavori della valutazione delle offerte tecnichee relativa campionatura alle ore 15:00 e decide di aggiornarsi al 31.10.2023 in seduta riservata per il prosieguo dei lavori.


Il Seggio di gara, alla chiusura del presente verbale, prende atto dell'esito della verifica tecnica effettuata per i suindicati Lotti, dal Referente Tecnico

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Il Seggio di Gara

**Il Presidente- RUP**


- Dr.ssa Marisa di Sano



---

**Componente**

- Dr.ssa Gioia Giuseppina Cristofaro

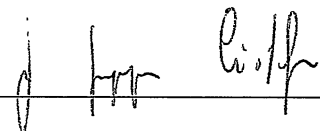

---

**Il Segretario Verbalizzante**

- Dr.ssa Floriana Landolfi



---

**Il Referente Tecnico**

-Dr. Valerio Marotta



---

**VALUTAZIONE TECNICA GARA DISPOSITIVI PER ALLESTIMENTO  
FARMACI ANTIBLASTICI – TABELLA – ALLEGATO 1**

<b>LOTTO 1</b>	
<b>DITTA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Ditta ICU MEDICAL EUROPE</b>	Dalle schede tecniche presentate per i dispositivi 011-CL-72 e 011-CL-70S si evince che il sistema offerto al lotto 1 è corredato di un semplice filtro idrofobico per l'equalizzazione di pressione, privo di barriera specifica per il blocco dell'emissione di vapori (gas) all'esterno del sistema. Pertanto, il sistema offerto al lotto 1 non risulta conforme alle specifiche di sicurezza richieste.
<b>Ditta MEDINAT EUROPE</b>	Il sistema offerto è conforme alle specifiche richieste
<b>Ditta SCOGNAMIGLIO</b>	Dai documenti presentati per il sistema offerto al lotto 1 (costituito dai punti 1, 2 e 3), non si evince il dato relativo al numero di aperture (accessi multipli) per le quali il sistema garantisce la sterilità del contenuto della linea/siringa/flaconcino cui è collegato. Tale specifica risulta espressamente richiesta dall' "Allegato 1 – Elenco fabbisogno" del capitolato di gara (valore minimo richiesto: 10 aperture). Pertanto, in assenza di tale informazione, il sistema offerto al lotto 1 non può essere valutato conforme.

<b>LOTTO 2</b>	
<b>DITTA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Ditta ICU MEDICAL EUROPE</b>	Il Dispositivo offerto è conforme alle specifiche richieste.

<b>LOTTO 3</b>	
<b>DITTA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Ditta ICU MEDICAL EUROPE</b>	Il Dispositivo offerto è conforme alle specifiche richieste.

<b>LOTTO 4</b>	
<b>DITTA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Ditta ICU MEDICAL EUROPE</b>	Il Dispositivo offerto è conforme alle specifiche richieste.

<b>LOTTO 5</b>	
<b>DITTA</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
<b>Ditta ICU MEDICAL EUROPE</b>	Il Dispositivo offerto è conforme alle specifiche richieste.

*R*      *R*      *H. C. H.*      *02/6*

<b>Ditta AMG MEDICAL</b>	Il dispositivo offerto è privo di tappo di chiusura per il filtro aria con membrana idrofobica da 0.2 micron. La documentazione presentata non riporta il dato relativo al mantenimento della sterilità del farmaco anche dopo prelievi ripetuti (almeno 10 aperture della linea e 72 ore). Pertanto, il dispositivo offerto risulta non conforme alle specifiche richieste.
<b>Ditta BD</b>	Il Dispositivo offerto è conforme alle specifiche richieste.

*H. C. R.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*