



**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
Scuola Medica Salernitana

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE  
DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA'  
DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.N.  
GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 1**

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di Ottobre , presso questa Azienda Ospedaliero -  
Universitaria si è riunita, in seduta riservata, la Commissione nominata con disposizione del D.G.  
prot. n. 12619 del 07/05/2021

Sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, con deliberazione n. 69 del 03.02.2021, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di durata triennale, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, di protesi per attività delle UU.OO.CC. di Cardiocirurgia d'Urgenza e Cardiocirurgia, suddivisa in n. 81 lotti, per un importo complessivo a base di gara di €. 5.906.118,00= Iva esclusa, interamente gestita tramite piattaforma telematica di negoziazione "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" (SIAPS) in dotazione a So.Re.Sa. Spa;
- che entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero le ore 12,00 del 19.04.2021, hanno presentato offerta gli operatori economici, come di seguito riportati, unitamente ai lotti di partecipazione:

Ragione Sociale	Lotti Offerti
FEBAR S.R.L.	27,55,56,58,62,79
MEDTRONIC Italia spa	47,59,60,71,36,38,75,39,41,42,43
Serom Medical Technology Srl	15,16,64,65,8,10,11,13,14
Medi Corp S.r.l.	45,60,61,66,2,9,12,17
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	36,43,52,60,17,25,32,61,73,81
EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA	34,35,37,46,48,49,53
LEMAITRE VASCULAR SRL	2,9,17,26
TEKNEMARIS SRL	67,3,4,6,7,2

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

GADA ITALIA SPA	68,77,20,28,29,30
FS MEDICAL	80
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	18,19,20
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.	43,44,51,54,60,33,41,61,75,76
B.BRAUN MILANO S.p.A.	2,9,10

- che nessuna offerta è stata presentata per i lotti n.1,5,21,22,23,24,31,50,57,63,69,70,72,74 e 78;

### CIO' PREMESSO

Il Presidente acquisisce agli atti il predetto documento di "Riepilogo delle attività di verifica amministrativa", ne dà lettura in modo che tutti i presenti ne possano prendere atto anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni di inesistenza di cause di compatibilità.

Quindi richiama gli atti presupposti della procedura in questione ed, in particolare, ne ricorda l'oggetto e le modalità di affidamento; quindi chiarisce i punti più rilevanti del Disciplinare di gara, e da' lettura dell'art. 6 di esso, rubricato "Procedura di aggiudicazione", facendo presente che la Commissione, in una o più sedute riservate, deve procedere alla valutazione tecnico – comparativa delle offerte presentate ed alla conseguente attribuzione dei punteggi di cui all'art. 6.1 "Modalità di attribuzione dei punteggi" del predetto medesimo disciplinare.

A questo punto il Presidente conferma, per il solo fatto della firma apposta in calce al presente verbale, l'accettazione dell'incarico di cui alla disposizione del D.G. prot. n. 13398/2021 e rende la dichiarazione - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di inesistenza a suo carico di cause di incompatibilità ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che consegna al segretario perché, allegata al presente verbale, venga tenuta agli atti del procedimento.

Successivamente il Presidente acquisisce anche gli atti di accettazione di incarico e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che i componenti della Commissione hanno sottoscritto singolarmente, circa l'inesistenza a loro carico delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.

Completate le attività preliminari, il Presidente prende atto di aver ricevuto dal RUP la documentazione contenuta all'interno della busta tecnica di ciascuno degli operatori offerenti, e ne trasferisce copia su supporti informatici, uno per ciascuno dei membri della Commissione, che ne accusano ricevuta per il solo fatto della firma del presente verbale.

Nella occasione concorda con gli altri componenti della Commissione, che le valutazioni tecniche delle offerte inizieranno dai lotti che hanno un unico offerente per poi proseguire con i lotti per i quali partecipano più Operatori economici.

Il medesimo Presidente, dichiara, infine, che per i lotti per i quali è presente un'unica offerta, la Commissione procederà alla mera valutazione di conformità alle specifiche tecniche capitolari non potendosi effettuare alcuna valutazione comparativa.

A questo punto, la Commissione si aggiorna a data da destinarsi, per proseguire l'esame istruttorio degli atti. La seduta termina alle ore 10:30, del che è verbale che viene, come di seguito, letto, confermato e sottoscritto.


Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)

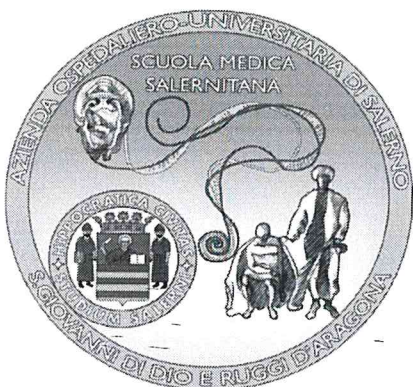

**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE  
DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA'  
DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.N.  
GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2**

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero -  
Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette:

- che, nella precedente seduta riservata del 04/10/2021, giusta verbale di pari data, la Commissione ha preso cognizione delle offerte presentate e stabilito che le valutazioni tecniche delle offerte iniziassero dai lotti che hanno un unico offerente per poi proseguire con i lotti per i quali partecipano più Operatori economici;
- che, per i lotti per i quali è presente un'unica offerta, si procederà alla mera valutazione di conformità alle specifiche tecniche capitolari non potendosi effettuare alcuna valutazione comparativa.

Ciò detto il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione che la Commissione svolge collegialmente, e le cui risultanze vengono di seguito riportate:

<b>Lotto 1</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita in collagene con trattamento antimicrobico a base di acetato di argento, lunghezza cm. 30, diametro 28, 30, 32 mm	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
<b>Lotto 3</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, con ampolla preformata di 3 cm non pieghettata, in un unico pezzo, di dimensione costante dopo l'impianto, diametri vari.	<b>Operatore partecipante : Teknemarkis Srl</b>

L'Operatore economico Teknemarkis Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 4</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, con branca per perfusione anterograda, lunghezza cm 35x cm 40, diametri vari.	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
---	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 5</b> Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita di collagene, lunghezza cm 50 con quattro branche ciascuna lunga cm 3, diametri vari.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
---	--

<b>Lotto 6</b> Protesi vascolare in dacron woven, doppio velour, impregnata di collagene, lunghezza cm. 50, con quattro branche angolate di diametro 12,10,8 mm, diametri vari	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
---	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 7</b> Protesi vascolare retta piccolo calibro, a due strati: strato interno in politetrafluoroetilene estruso espanso, strato esterno in tessuto poliestere, fusi in policarbonato-uretan eparinizzata, diametro 8mm., lunghezza 80cm rinforzata	<b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b>
--	--

L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 8</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili con estremità sagomata secondo la fisiologia dei seni di Valsalva per chirurgia aortica, disponibili con collare e senza collare misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 11</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili dotate di branca laterale pe perfusione anterograda per chirurgia aortica, misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---





L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 12</b> Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili per chirurgia aortica	<b>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</b>
--	--

L'Operatore economico **Medi Corp S.r.l.** risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 13</b> Protesi tubolari precurvate di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili per chirurgia aortica	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  


<b>Lotto 14</b> Protesi tubolari precurve di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza e calibro variabili dotate di branca laterale per perfusione anterograda per chirurgia aortica, misure varie	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---

L'Operatore economico Serom Medical Technology Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 15</b> Protesi in poliestere (woven) retta, porosità zero, con collare impregnate con gelatina e trattabili con rifampicina. Varie misure.	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
--	---

L'Operatore economico Serom Medical Technology Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 16</b> Protesi in poliestere (woven) porosità zero impregnata di gelatina e trattabile con rifampicina con tre branche. Varie misure.	<b>Operatore partecipante : Serom Medical</b>
---	---

L'Operatore economico Serom Medical Technology Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 18</b> Protesi retta in PTFE espanso, rivestita da una pellicola esterna dello stesso materiale che aumenta la resistenza della sutura. Spessore 0,39 mm, lunghezza 10 cm, vari diametri	<b>Operatore partecipante : W.L. GORE &amp; ASSOCIATI SRL</b>
--	---

L'Operatore economico W.L. GORE & ASSOCIATI SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 19</b> Protesi retta in gore-tex (PTFE espanso) a parete sottile 0,39 mm, STRETCH (estensibilità longitudinale superiore al 30%), varie misure.	<b>Operatore partecipante : W.L. GORE &amp; ASSOCIATI SRL</b>
---	---

L'Operatore economico W.L. GORE & ASSOCIATI SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 21</b> Patches in PTFE 15x15 cm. Con spessore 0,6 mm	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 22</b> Patches in teflon felts cm 15x15, spessore 1,65 mm, porosità 1700 cc	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
---	--

<b>Lotto 23</b> Patches Savage di Dacron filamentoso sterile con segni di riferimento spessore 0,6 mm - porosità media 1600 cc., filamentoso da entrambi i lati e con un lato leggermente più pesante dell'altro.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 24</b> Patch in PTFE con elastomero. Misure varie.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 25</b> Patch in pericardio. Possibilità di utilizzo immediato senza necessità di risciacquo. Misure 2x5 cm	<b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b>
--	--

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side of the page.  
 - A signature below it.  
 - Initials "RM" and "M" at the bottom.

<p><b>Lotto 26</b> Patch in pericardio bovino fissato in gluteraldeide monomerica sottoposto a trattamento in grado di eliminare tutti i residui cellulari e di eliminare tutti i residui di aldeide liberi. Conservato in soluzione non tossica di glicol propilene pronto per l'utilizzo immediato.</p>	<p><b>Operatore partecipante : LEMAITRE VASCULAR SRL</b></p>
---	--

L'Operatore economico LEMAITRE VASCULAR SRL risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 27</b> Patch di pericardio porcino dotato di trattamento detossificante NO REACT che minimizzi la reazione infiammatoria. Conservato in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico, pronto all'uso, non deve richiedere risciacquo. 8x14.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 28</b> Patch cardiovascolare in Gore-tex (PTFE espanso) per ricostruzione di difetti cardiaci, grossi vasi e arterie periferiche con spessore 0,4 mm circa, con caratteristiche di microporosità e resistenza multidirezionale, varie misure.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 29</b> Patch cardiovascolare in Gore-tex (PTFE espanso) per ricostruzioni cardiache, con fluoropolimero elastico, spessore 0,5 mm, risterilizzabile, elevata resistenza meccanica, microporosità e resistenza multidirezionale, varie misure.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 30</b> Membrana per la sostituzione del pericardio in Gore-tex (PTFE espanso), per la prevenzione di aderenze, porosità non superiore ad 1 micron, spessore 0,1 mm, varie misure. Confezione singola, sterile, monouso.</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 31</b> Pericardio bovino reticolato con gluteraldeide composto da fibre multidirezionali di collagene.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 32</b> Anello rigido a forma di "sella" per anuloplastica mitrale. Rigidità tridimensionale. Costituito in materiale di poliestere con anima interna rigida in titanio. Indicatori delle commissure per la misura ed il posizionamento. Conformazione a "sella" che mima la naturale</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 33</b> Anello semirigido completo con anima metallica in Nitinol opportunamente sagomata, chiusa ad anello e avvolta in silicone radiopaco. Tessuto in poliestere rivestito in carbonio turbostratico. Sistema di riferimento sull'anello per il corretto dimensionamento delle corde tendinee.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico **SORIN GROUP ITALIA s.r.l.** risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 34</b> Anello mitralico con anima in metallo chiuso e con flessibilità della curvatura posteriore. Doppia sella. La forma dell'anello varia a seconda della misura. L'anello di sutura deve avere una porzione morbida, priva delle bande metalliche interne, per consentire l'agio nella sutura. Misure da 24 a 40 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA** risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 35</b> Anello mitralico con anima in metallo e rigido. Forma tridimensionale e asimmetrica con riduzione della curvatura in P2-P3 e del diametro anteroposteriore, per la correzione dell'insufficienza mitralica. Misure da 24 a 34 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA** risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 37</b> Anello tricupidale con anima in lega di titanio. Forma tridimensionale anatomica ad onda e flessibilità progressiva. L'anello di sutura deve presentare una porzione morbida, per consentire agio nella sutura. Misure da 26 a 36 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA** risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 38</b> Anello semirigido per plastica mitralica con anima metallica fra i trigoni in tessuto poliestere ed anima in lega metallica radiopaca (MP35) con occhielli in corrispondenza dei trigoni, Diametro 26-38 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico **MEDTRONIC Italia spa** risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 39</b> Anello per plastica anulare mitralica semirigido nella parte posteriore e flessibile nella parte anteriore, pre-montato su holder in tessuto di poliestere ed anima di lega metallica radiopaca (MP35), con occhielli in corrispondenza dei trigoni. Diametro 26-38 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico **MEDTRONIC Italia spa** risulta conforme alle richieste capitolari.

*ASBE*

*B*

*M*

*he*

*Ja*

<p><b>Lotto 40</b> Anello tridimensionale asimmetrico a sella rigido per il rimodellamento della valvola mitrale, con nucleo in titanio sovrastampato con silicone e ricoperto di tessuto in poliestere con marker in corrispondenza dei trigoni e della parte centrale posteriore. Diametro 24-40 mm.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 42</b> Emianello semirigido per anuloplastica mitralica in poliestere con anima metallica radiopaca e con occhielli in corrispondenza dei trigoni. Misure dalla 26 alla 38</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 44</b> Protesi valvolare cardiaca aortica e mitralica a due emidischi curvi in carbonio pirolitico per impianto in posizione intranulare. Gabbietta in lega di titanio rivestita in carbonio turbostratico e anello di sutura morbido costituito da materiale polimerico rivestito di carbonio turbostratico. Struttura valvolare completamente ruotabile. Misure varie a partire dalla 16mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
--	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 45</b> Valvola cardiaca al carbonio Pirolitico privo di silicio, corpo valvolato allungato con rapporto tra l'altezza dell'housing ed il diametro compreso tra 0,6 e 0,7 mm. Apertura dei Leaflet (lambi) a 90°, escursione dei lembi di solo 50°, svasatura all'imbocco valvolare con riparo dei Leaflet (lambi) da eventuali interferenze. Misura unica per l'intera gamma delle valvole mitraliche. Misura Aortica: 19 a 29 mm. In posizione aortica è licenziata per basso tenore di INR in associazione ad ASA.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</b></p>
--	---

L'Operatore economico Medi Corp S.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 46</b> Bioprotesi aortica con impianto sovranulare, assemblate con tre lembi di pericardio bavino, con innovata tecnologia con preservazione del pericardio tramite neutralizzazione completa delle aldeide libere, conservazione senza liquido (a secco), predisposizione dello stent all'impianto TAVI con tecnica Valve-in-valve</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.








<p><b>Lotto 47</b>          Protesi biologica aortica sterile in tessuto pericardio bovino tagliato a laser per impianti sovra ed intra anulari, sottoposta a trattamenti specifici per rimuovere le aldeidi presenti nel tessuto pericardico, e così ridurre il rischio di calcificazione e degenerazione dei lembi della protesi. lo stent a basso profilo in PEEK rivestito in materiale biocompatibili, riduce il rischio di ostruzione coronarica e permette il suo utilizzo in anulus aortici di piccole dimensioni. i lembi della protesi sono montati all'interno dello stent polimerico, che grazie alla sua flessibilità consente una naturale coaptazione dei lembi con conseguenza assenza di rigurgito centrale residuo.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
---	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 48</b>          Protesi valvolari biologiche aortiche stented in pericardio bovino aventi le seguenti caratteristiche: impianto sopraannulare; stent in lega metallica elastica; anello anatomico; bassa protusione aortica; altezza minima dello stent in prossimità degli ostii coronarici; trattate con agenti mitiganti la calcificazione; elevato follow-up; superiore 15 anni misure 19-29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 49</b>          Protesi valvolari biologiche mitraliche stented in pericardio bovino aventi le seguenti caratteristiche: stent in lega metallica elastica; bassa protrusione ventricolare; trattata con agenti mitiganti la calcificazione; elevato follow-up; superiore 15 anni misure: 25-33 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 50</b>          Valvola biologica aortica in pericardio bovino con stent in resina acetica rivestito in dacron e costituita da un solo foglio di pericardio avvolto all'esterno dello stent. Possibilità di impianto sia intra che sovranulare. Follow-up pubblicato superiore a 20 anni. trattamento mitigante della calcificazione del pericardio. Anello radiopaco e riferimenti radiopachi alle commissure.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

<p><b>Lotto 51</b>          Valvola biologica con trattamento demineralizzante senza alcun supporto e priva di materiale sintetico. Impianto sub coronarico e totalmente sovranulare. Impiantabile con una linea di sutura. che non necessiti di lavaggi, conservata in soluzione priva di aldeidi.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 52</b> Valvola cardiaca in pericardio bovino, con stent in titanio rivestito in tessuto biologico tale da assicurare un contatto solo tra elementi biologici e sottoposta a trattamento anticalcificante. Massima Area Utile (EOA) della protesi e configurazione della cuffia adatta all'impianto sopranulare.</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 53</b> Sistema valvolare a rilascio rapido, con valvola in pericardio, sopranulare a basso profilo con stent in lega metallica e costituita da tre foglietti pericardici. Telaio intra-sottoanulare in acciaio rivestito in dacron e velour espandibile con palloncino. Misure da 19 a 27 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</b></p>
---	--

L'Operatore economico EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 54</b> Valvola aortica biologica in pericardio bovino con ancoraggio senza suture in sede di impianto, con trattamento di neutralizzazione dei gruppi aldeidi per un impianto senza lavaggio. Stent auto espandibile e auto fissante in lega di Ni-Ti, rivestito di carbonio tirbostratico.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 55</b> Bioprotesi aortica porcina semi-stented completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Provvista di tre flange da suturare nella parete aortica per migliorare l'emodinamica. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: da 21 mm a 27 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 56</b> Bioprotesi mitralica porcina completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: 27mm-33mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 57</b> Valvola aortica porcina trans apicale suturata su uno stent in nitinol auto espandibile, dotata di feelers con marker radiopachi che agevolano il posizionamento e l'ancoraggio della protesi stessa. La protesi deve essere riposizionabile e retraibile nella fase di predislocamento definitivo, con marchio CE per insufficienza aortica e per stenosi. Misure: da 21 a 27 mm.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

*f. bar*      *m*      *hyde*

<p><b>Lotto 58</b>          Protesi monocuspide di pericardio porcino completamente biologica priva di materiale polimerico con trattamento detossificante NO REACT. Conservata in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure: 28mm a 38mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
--	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 59</b>          Protesi valvolare aortica biologica porcina senza stent, fissaggio a "pressione fisiologica" con "pressione differenziale zero" sui lembi e fissaggio a pressione (40 mmHg) dell'aradice. Costruzione: radice aortica porcina non composita. Diametro 19 - 29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
---	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 62</b>          Condotto valvolato completamente biologico, privo di materiale polimerico, in pericardio bovino, provvisto di valvola porcina stentless con trattamento detossificante NO REACT. Conservato in una soluzione sterile atossica di alcool benzilico al 2%, pronto all'uso non deve richiedere risciacquo. Misure da 21 a 29 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 63</b>          Condotto valvolato con protesi biologica tipo stented, varie misure.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 64</b>          Endoprotesi ibrida multiforcata composta da una protesi in poliestere woven, con collare per facilitare l'impianto tra protesichirurgica e stent, presuturata ad una protesistentata lunghezza 100/150mm, entrambe precoagulate con gelatina. La protesi in poliestere woven deve avere 4 branche comprendente anche una branca laterale per consentire la cannulazione arteriosa anterograda. Lunghezze e calibri variabili. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Serom Medical</b></p>
--	--

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 65</b>          Endoprotesi ibrida composta da una protesi poliestere woven con collare per facilitare l'impianto tra protesi chirurgica e stent, presuturata ad una protesi stentata, lunghezza 100 o 150mm, entrambe precoagulate con gelatina. La protesi in poliestere woven deve avere una branca laterale per consentire la cannulazione arteriosa anterograda, lunghezza e calibro variabili. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Serom Medical</b></p>
---	--

L'Operatore economico Serom Medical Technolgy Srl risulta conforme alle richieste capitolari.



<p><b>Lotto 66</b>          Sistema di endoprotesi ibrida, composta da componente chirurgica e endoprotesica. Componente chirurgica con quattro diverse configurazioni: retta, con tre branche, mono branca triforcata, tutte con branca di perfusione, la quarta costituita da uno stent in filamento di nitinolo intrecciato, non rivestito, fissato prossimalmente ad un collare di feltro di PTFE. Varie misure. Componente endoprotesica con lunghezza da 120mm a 180mm e diametro da 20mm a 40mm. Sistema di rilascio pull-back rapido e intuitivo utilizzabile con e senza filo guida. Anche custom-made.</p>	<p><b>Operatore partecipante : Medi Corp S.r.l.</b></p>
--	---

L'Operatore economico Medi Corp S.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 67</b>          Sistema monouso di riparazione dell'allungamento e della rottura delle corde tendinee, mediante un approccio transapicale costituito da uno strumento palmare a introduzione, di una sutura in PTFE, un ago e un LV (visualizzatore di verifica dei lembi)</p>	<p><b>Operatore partecipante : Teknemaris Srl</b></p>
--	---


L'Operatore economico Teknemaris Srl risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 68</b>          Impianto in EPTFE Cv-4 Cv-5 non assorbibile per ricostruzione/sostituzione corde tendinee anche con misura predeterminata mediante pledget premontati . Lunghezza sutura da 35 a 42 cm</p>	<p><b>Operatore partecipante : GADA ITALIA SPA</b></p>
--	--

L'Operatore economico GADA ITALIA SPA risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 69</b>          Endoprotesi ibrida composta da uno stent in nitinol autoespandibile ricoperto in cPTFE, a parete sottile, con legame di eparina lungo 5 o 10 cm, diametri 6, 7, 8, 9 mm, connessa ad una protesi vascolare in cPTFE 6 mm, 50 cm anch'essa con legami di eparina.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 70</b>          Stent aortico struttura in Nitinol e con un disegno a celle chiuse romboidali, con il diametro delle due estremità leggermente maggiore rispetto al corpo centrale. Il corpo centrale deve essere a celle aperte, quello prossimale e distale a celle chiuse. Il diametro tra 18 e 36 mm. La lunghezza deve essere pari a 70 mm, 100 mm o 130 mm. Il componente deve essere fornito precaricato su meccanismo di rilascio puntuale.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

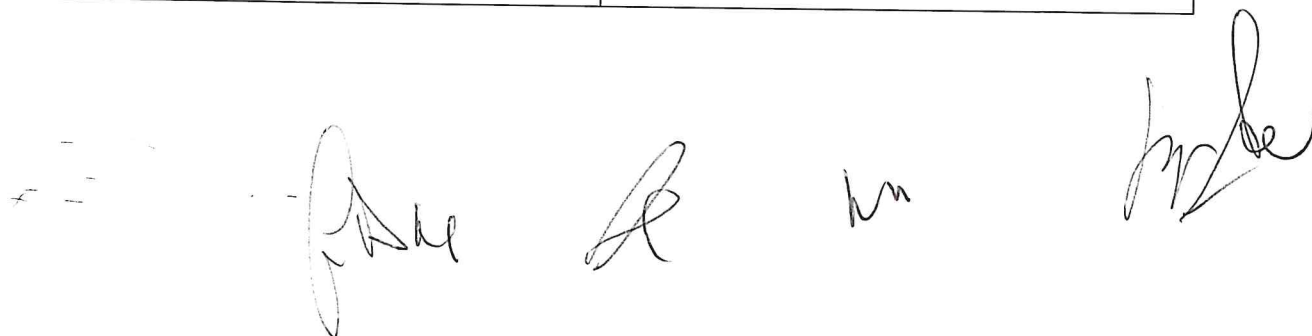

<p><b>Lotto 71</b> Anello mitralico incompleto, flessibile, a forma di "sella" progressiva anteriore e posteriore che mima la naturale forma mitralica nativa. Garantisce il fisiologico movimento dell'annulus mitralico grazie alla sua flessibilità che aumenta progressivamente col'aumento della misura utilizzata. Cuffia con markers commissurali e postero-mediali che facilita la zona di sutura grazie ad un supporto di silizone. Size da 24 a 40 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : MEDTRONIC Italia spa</b></p>
--	---

L'Operatore economico MEDTRONIC Italia spa risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 72</b> Nuovo sistema monouso di impianto di corde tendinee in PTFE pre-caricate ideate su principi noti di plastica valvolare per insufficienza mitralica da rottura, allungamento e/o retrazione delle corde, mediante un approccio a cuore battente, trans-apicale costituito da un device con introduttore emostatico e sistema di rilascio a basso profilo (9 Fr).</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 73</b> Bioprotesi mitralica porcina con assenza del muscolo settale, "triple composite" con stent in materiale polimerico rivestito in dacron e fissate a pressione minima, sottoposta a trattamento anti-calcificazione. Basso profilo con ridotta possibilità ingombro nel tratto di efflusso ventricolare sinistro. presenza di inserti in pericardio a protezione dei lembi durante la fase di apertura. Ottima durabilità a lungo termine. Facilità di impianto durante chirurgia mini-invasiva. misure 25-33 mm</p>	<p><b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b></p>
---	---

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 74</b> Bioprotesi mitralica porcina montata su uno stent flessibile polimerico con marker radiopachi, dotata di un innovativo sistema di impianto "Cinch" che facilita l'impianto in posizione mitralica proteggendo la valvola durante il passaggio dei punti e la loro legatura. Ottima durabilità a lungo termine. Misure 25-33 mm.</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
--	---

<p><b>Lotto 76</b> Anello semi-rigido incompleto in poliestere intrecciato con anima in silicone, per stabilizzazione anulare durante chirurgia riparativa della valvola mitralica o tricuspide. Misure 23-39 mm.</p>	<p><b>Operatore partecipante : SORIN GROUP ITALIA s.r.l.</b></p>
---	--

L'Operatore economico SORIN GROUP ITALIA s.r.l. risulta conforme alle richieste capitolari.

<p><b>Lotto 77</b> Set per realizzare la neocuspidalizzazione della valvola aortica, che può essere effettuata in tutte le patologie della valvola aortica incluse le endocardite infettive. Set completo di disposable</p>	<p><b>Nessun operatore economico partecipante</b></p>
---	---

*RM*

*Le*

*m*

*de*  
*mp*

<b>Lotto 78</b> Micropompa assiale percutanea che fornisce assistenza meccanica al ventricolo dx e supporta il circolo polmonare del paziente generando un flusso di 4,0+L/min.	<b>Nessun operatore economico partecipante</b>
--	--

<b>Lotto 79</b> Protesi per aorta ascendente completamente biologica di pericardio bovino priva di materiale polimerico ,trattamento detossificante che impedisce il rilascio di molecole tossiche di gluteraldeide.Non richiede risciacquo prima dell'impianto.Misure varie	<b>Operatore partecipante : FEBAR S.R.L.</b>
---	--

L'Operatore economico FEBAR S.R.L. risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 80</b> Graft vascolare extra-limunale costituito da unostent a struttura mesh con supporto a doppia elicoide. Il graft vascolare in cromo cobalto ultra flessibile serve da scaffolding rivestimento esterno della vena safena durante CABG. Disponibile in diversi diametri e lunghezze. Da utilizzare con apposita cannula e il misuratore.	<b>Operatore partecipante : FS MEDICAL</b>
---	--

L'Operatore economico FS MEDICAL risulta conforme alle richieste capitolari.

<b>Lotto 81</b> sistema valvolare mitralico di sostituzione transapicale della valvola mitralica con cuscinetto apicale e sistema di introduzione che faciliti il posizionamento della valvola.La valvola deve essere interamente riposizionabile e recuperabile in modalità intraoperatoria.	<b>Operatore partecipante : ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</b>
--	--

L'Operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.risulta conforme alle richieste capitolari.

Il Presidente, in accordo con gli altri componenti della commissione, fissa per il giorno 15 Ottobre alle ore 09:00 circa, il prosieguo delle operazioni di gara. La seduta termina alle ore 10:30.

Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)





**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA' DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.  
N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 3**

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogiovanni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette che, nella precedente seduta riservata del 07/10/202, giusta verbale di pari data, la Commissione ha terminato la valutazione dei lotti per i quali era presente un unico operatore economico concorrente.

Ciò detto il Presidente concorda con la Commissione di iniziare la valutazione comparativa dei lotti per i quali sono presenti n. 2 offerte a partire dal lotto "10", esprimendo i seguenti punteggi tecnico-qualitativi per i seguenti criteri esposti nel disciplinare di gara:

- 1) maneggevolezza, ergonomia e facilità di uso: max 30 punti;
- 2) funzionalità: max 20 punti;
- 3) Caratteristiche migliorative: max 20 punti;

Le risultanze vengono di seguito riportate:

<b>LOTTO 10: Protesi tubolari di dacron woven impregnate di gelatina e trattabili con rifampicina di lunghezza calibro variabili per chirurgia aortica mis. Varie</b>	
B.BRAUN MILANO S.p.A. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 15	Serom Medical Technology Srl 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative – punti 20
<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>

<b>LOTTO 20:</b> Protesi reti in Gore-tex (PTFE Espanso) eparinata stretch, a parete sottile 0,39 mm	
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2)funzionalità – punti 17 3) caratteristiche migliorative – punti 15	GADA ITALIA SPA 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 22 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 12
<b>TOTALE: 57 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 49 PUNTI</b>

<b>LOTTO 36:</b> Anello flessibile regolabile. Disegno completamente flessibile, regolazione simmetrica asimmetrica della circonferenza dell'anello. Possibilità di utilizzo in procedure di chirurgia mininvasiva robotica. Misure da 25 mm a 35 mm	
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative – punti 10	MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 15
<b>TOTALE: 40 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 55 PUNTI</b>

<b>LOTTO 41:</b> Anello aperto tridimensionale rigido per il rimodellamento della valvola tricuspide, con nucleo titanio sovrastampato con silicone e ricoperto di tessuto in poliestere. Diametro 26-36 m	
MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative – punti 20	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 10
<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>

<b>LOTTO 75:</b> Anello incompleto mitralico flessibile, a forma di "C", per stabilizzazione anulare durante chirurgia della valvola mitralica che permette di preservare la naturale flessibilità dell'annulus mitralico. Misure 26-38 mm.	
MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative – punti 20	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative – punti 10
<b>TOTALE: 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE: 45 PUNTI</b>

Il Presidente, in accordo con gli altri componenti della commissione, fissa per il giorno 23 Ottobre alle ore 09:00 circa, il prosieguo delle operazioni di gara. La seduta termina alle ore 10:30. Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)


Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)


Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)



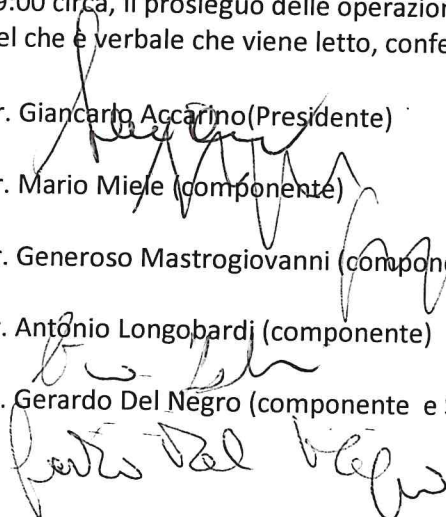

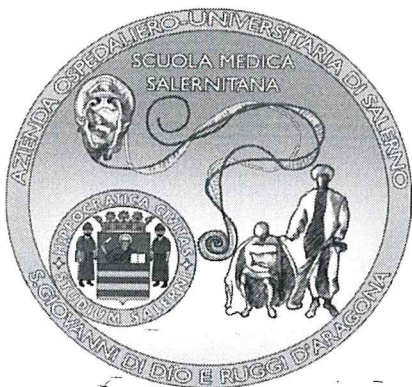

**Azienda Ospedaliero Universitaria  
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**  
*Scuola Medica Salernitana*

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DURATA BIENNALE, CON OPZIONE  
DI RINNOVO PER UNA ULTERIORE ANNUALITA', DI PROTESI PER ATTIVITA'  
DELLE UU.OO.CC. DI CARDIOCHIRURGIA D'URGENZA E CARDIOCHIRURGIA.  
N. GARA 8056889**

**VERBALE DI GARA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 4**

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Ottobre , alle ore 09:00 presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria sono presenti:

- Dr. Giancarlo Accarino in qualità di Presidente;
- Dr. Mario Miele in qualità di Componente;
- Dr. Generoso Mastrogianni in qualità di Componente;
- Dr. Antonio Longobardi in qualità di Componente;
- Dr. Gerardo Del Negro in qualità di Componente e segretario verbalizzante

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Quindi premette che, nella precedente seduta riservata del 15/10/2021, giusta verbale di pari data, la Commissione ha terminato la valutazione dei lotti per i quali erano presenti n. 2 operatori economici concorrenti.

Ciò detto il Presidente concorda con la Commissione di iniziare la valutazione comparativa dei lotti per i quali sono presenti n. 3 e 4 offerte a partire dal lotto "2", esprimendo i seguenti punteggi tecnico-qualitativi per i seguenti criteri esposti nel disciplinare di gara:

- 1) maneggevolezza, ergonomia e facilità di uso: max 30 punti;
- 2) funzionalità: max 20 punti;
- 3) Caratteristiche migliorative: max 20 punti;

Per quanto concordato, il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione che la Commissione svolge collegialmente, e le cui risultanze vengono di seguito riportate:

<b>LOTTO 2: Protesi vascolare in dacron woven, velour solo esterno, rivestita in collagene bovino purificato tipo I, spessore parete 0,38, lunghezza cm. 15 diametri vari (20, 22, 24, 26, 28, 30, 32)</b>			
<b>B.BRAUN MILANO S.p.A.</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3)caratteristiche migliorative – punti 12 <b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>LEMAITREVASCULAR SRL</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3)caratteristiche migliorative – punti 12 <b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>Medi Corp S.r.l.</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3)caratteristiche migliorative – punti 12 <b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TEKNEMARIS SRL</b> 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2)funzionalità – punti 20 3)caratteristiche migliorative – punti 20 <b>TOTALE 65 PUNTI</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>LOTTO 9:</b> Protesi in PTFE a pareti sottili da 15 a 80 cm. Misure varie.		
B.BRAUN MILANO S.p.A. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 25 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20	LEMAITRE VASCULAR SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12	Medi Corp S.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12
<b>TOTALE 65 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

<b>LOTTO 17:</b> Patch di pericardio bovino decellularizzato, stabilizzato con processo di foto-ossidazione, privo di sostanze aldeidiche		
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 2)funzionalità – punti 3) caratteristiche migliorative punti	LEMAITRE VASCULAR SRL 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 2)funzionalità – punti ; 3) caratteristiche migliorative punti	Medi Corp S.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20
<b>Non conforme perché NON privo di sostanze aldeidiche</b>	<b>Non conforme perché non è pericardio bovino</b>	<b>TOTALE PUNTI 70</b>

<b>LOTTO 43:</b> Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche in carbone pirolitico con misure per entrambe le posizioni a partire da 17 mm e follow-up di 30 anni		
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20	MEDTRONIC Italia spa 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 15 2)funzionalità – punti 15 3) caratteristiche migliorative punti 12
<b>TOTALE 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

<b>LOTTO 60:</b> Tubi valvolati composti da valvole cardiache meccaniche in carbonio pirolitico e protesi tubolare dacron			
ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3)caratteristiche migliorative – punti 20	Medi Corp S.r.l. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3)caratteristiche migliorative – punti 12	MEDTRONIC Italia spa 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative – punti 12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1)maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3)caratteristiche migliorative – punti 12
<b>TOTALE 70 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>

**LOTTO 61:** Condotto valvolato costituito da: protesi valvolare cardiaca aortica a due emidischi in carbonio pirolitico, con angolo di apertura di 78°, gabbietta in carbonio pirolitico rinforzata da un anello titanio e anello di sutura morbido costituito da materiale polimerico; struttura valvolare completamente ruotabile; condotto vascolare in tessuto poliestere impregnato di gelatina, con conformazione dei seni di Valsalva

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12	Medi Corp S.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 20 2)funzionalità – punti 10 3) caratteristiche migliorative punti 12	SORIN GROUP ITALIA s.r.l. 1) maneggevolezza ergonomia e facilità d'uso – punti 30 2)funzionalità – punti 20 3) caratteristiche migliorative punti 20
<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 42 PUNTI</b>	<b>TOTALE 70 PUNTI</b>

La seduta termina alle ore 10:30 ed il Presidente incarica altresì il componente Dr. Gerardo Del Negro di trasmettere il presente verbale e quelli delle precedenti sedute riservate al Seggio di gara. La seduta termina alle ore 10:30 circa. Del che è verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Giancarlo Accarino (Presidente)

Dr. Mario Miele (componente)

Dr. Generoso Mastrogiovanni (componente)

Dr. Antonio Longobardi (componente)

Dr. Gerardo Del Negro (componente e Segretario verbalizzante)

