

Y

2/P-13

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE,
DISPOSITIVI PER INCONTINENZA A RACCOLTA E
MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO**

So.Re.Sa. S.p.A.

~

TELEFLEX MEDICAL s.r.l.

**ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, DISPOSITIVI PER INCONTINENZA A RACCOLTA E
MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO**

TRA

So.Re.Sa. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscriz. al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell'Amministratore Delegato Avv. Francesco D'Ercole nato a Misurata (Libia) il 12/07/1946 e dotato dei poteri di rappresentanza giusta verbale del Consiglio di Amministrazione 03 giugno 2013

E

TELEFLEX MEDICAL s.r.l. con sede legale in Varedo (MB), alla Via Torino n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 06324460150, C.F. 06324460150 e P. IVA n. 02804530968, in persona dell' Amministratore Delegato sig. Paolo Carlo Crippa, nato a Paderno Dugnano (MI) il 12/12/1964, C.F.: CRPPCR64T12G220L (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011 successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto con determinazione n. 24 del 27/03/2013, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito.
- c) che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
- **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, stipulare i singoli Contratti di fornitura basati sul presente Accordo Quadro;
 - **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto ordinato dalle Amministrazioni a seguito di Contratti di fornitura;
 - **Capitolato Speciale:** il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro; esso disciplina inoltre le modalità per la stipula dei contratti di fornitura;
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell'Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

- d) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- e) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell'emissione dell'Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- f) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- g) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- i) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e suoi allegati,
- l'Allegato "B" (Catalogo prodotti di ciascun Fornitore),
- l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore),
- l'Allegato "D" (Determina di aggiudicazione n. 85 del 17/09/2013),

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle altre norme vigenti in materia di contratti pubblici;

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le

Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, a seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito aventi le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dall'Accordo, la So.Re.Sa. si riserva la facoltà di incrementare i suddetti quantitativi fino al 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.

In tal caso il Fornitore si impegna a fornire i quantitativi aggiuntivi dei prodotti individuati da appositi nuovi Atti di Adesione comunicati da Amministrazioni Contraenti alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

1. **Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula**, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
2. La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite gli Atti di Adesione.
4. **I Contratti di Fornitura, durante i quali le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini di fornitura hanno durata triennale a decorrere dal rispettivo Atto di adesione.**

Articolo 4 – Adesione delle Amministrazioni

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite nell'articolo 4 del Capitolato Speciale.
2. Per poter acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie, preventivamente autorizzate da So.Re.Sa. Spa, devono adottare **l'Atto/i di adesione**, a mezzo del/i quale/i si individua il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e si potrà nominare il Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a So.Re.Sa. Spa.

Dopo 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

Le singole Amministrazioni potranno inoltre, nel corso dell'esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell'Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

3. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'Amministrazione:

- consentirà il subappalto, previa verifica da parte di So.Re.Sa. della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2 e dall' art.118 comma 2 punto 1) del D.Lgs. n. 163/2006;
- assicurerà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;

Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dei Contratti di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale, nei Contratti di Fornitura e nei singoli Ordini di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

- e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
 8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
 9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.
 10. Le forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, anche ad altri operatori economici aggiudicatari all'interno dell' Accordo Quadro.
 11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti rispetto alla documentazione amministrativa presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

Articolo 8 – Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall'art. 8 "penali" del Capitolato Speciale;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa..
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro.
5. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad € 439.552,19 (euro quattrocentotrentanove milacinquecentocinquanta due mila/19 centesimi).
2. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A.

Articolo 10 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro So.Re.Sa avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre il termine previsto all'art. 8 del Capitolato, Il cpv, le singole Amministrazioni avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato, ultimo cpv.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. 8 del presente Accordo Quadro;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.
 5. Dalla data di risoluzione dell'Accordo Quadro, si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
 6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
 7. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.
 8. So.Re.Sa. S.p.A. procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.
 9. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 11 – Recesso


1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. 3.

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA



2. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 14 - Referenti dell' Accordo Quadro

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'adempimento del presente Accordo Quadro e

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.

2. Il Fornitore avrà altresì l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Atto di Adesione, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti di ciascuna Amministrazione per l'adempimento dei singoli Contratti di Fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell'Accordo Quadro o dei Contratti di Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta rispettivamente a So.Re.Sa. S.p.A e/o all'Amministrazione interessata.
4. La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell'Accordo Quadro l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a marlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 17 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo dell'Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, (oppure, in alternativa)
- b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.

Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 18 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna a comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo dispositivo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21 Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.ufnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto

TELEFLEX MEDICAL SRL
Legale Rappresentante
PAOLO CARLO CRIPPA

scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Napoli, li 21/11/2013

SO.RE.SA. S.p.A.
Avv. Francesco D'Ercole



TELEFLEX MEDICAL s.r.l.
Paolo Carlo Crippa




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Napoli, li 21/11/2013

TELEFLEX MEDICAL s.r.l.
Paolo Carlo Crippa

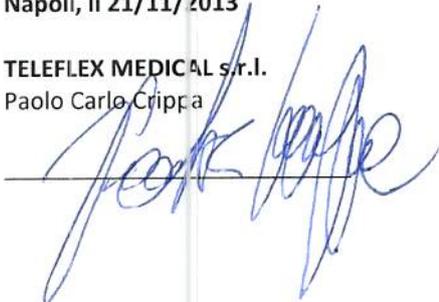

**PROCEDURA APERTA LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI
ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER STOMIE, DISPOSITIVI PER
INCONTINENZA A RACCOLTA E MEDICAZIONI PER PIAGHE DA DECUBITO**

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito, per gli assistiti aventi diritto dalle AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania.

Per la peculiarità dei presidi in questione che riguardano il processo riabilitativo dei pazienti, si ritiene necessario che la fornitura venga assegnata ad una pluralità di offerte tecnicamente idonee ed a condizioni economicamente convenienti in quanto deve essere garantita ai prescrittori l'esercizio della discrezionalità tecnica nella scelta degli "Ausili".

La presente procedura non è pertanto finalizzata ad identificare un unico assegnatario per ciascuno lotto, ma ad individuare le ditte idonee a fornire prodotti conformi alle esigenze del paziente così come ritenuto dal prescrittore.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di presidi per incontinenti con sistema a raccolta (sacche e placche per colo/ileo/urostomizzati, cateteri vescicali ed esterni, sacche raccogli urina e medicazioni per il trattamento e la prevenzione delle piaghe da decubito), previsti dal Nomenclatore Tariffario, elenco 2, per un importo pari ad € 45.499.624,68 oltre IVA.

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti oggetto della gara sono quelli di cui all' "Allegato B2 – Scheda offerta".

Si precisa che per le ASL la fornitura riguarda sia la fornitura agli aventi diritto sia il consumo interno, mentre per le AA.OO. si riferisce al solo consumo interno. Il materiale per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee compreso nell'elenco (codice ISO 9211XXXX) è riferibile alla sola distribuzione delle ASL agli aventi diritto.

I quantitativi riportati sono puramente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull'effettivo utilizzo dei singoli prodotti.

Ogni aggiudicatario dovrà fornire fino all'importo massimo previsto per tutto il lotto, mentre le Aziende sanitarie non risponderanno nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori costituendo i quantitativi preventivati solo un limite massimo di accettazione obbligatoria degli ordinativi da parte dei singoli fornitori.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non aggiudicare alcuni lotti o l'intera gara in caso di offerte considerate non conformi alle prescrizioni del presente capitolato o per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura.

Pertanto So.Fle.Sa. si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e commercializzazione.

In particolare i prodotti offerti dovranno essere ricompresi nel Nomenclatore tariffario nazionale di cui al Decreto Ministero Sanità n° 332 del 27 agosto 1999 .

Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, le Ditte Aggiudicatrici saranno tenute a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende.

Fermo restando le condizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, può proporre alla So.Re.Sa. la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare con caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, ma comunque secondo la normativa vigente.

In particolare, tutti i prodotti sterili dovranno essere in confezioni singole e riportare su ciascuna di esse

(compresa la busta del singolo articolo) l'etichetta in lingua italiana con tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa ed il metodo di sterilizzazione usato; la confezione dovrà garantire la conservazione della sterilità del prodotto dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

Tutti i prodotti, in funzione della loro scadenza, dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 della loro validità.

Le Etichette e le Istruzioni per l'uso devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A seguito della individuazione degli operatori economici facenti parte dell'Accordo Quadro, le aziende sanitarie e ospedaliere provvederanno ad emettere singoli atti di adesione che saranno conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro.

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall'ASL/ AO e avverrà presso i magazzini e nelle località espressamente indicate nell'ordinazione.

Per ogni singolo lotto, nell'ambito degli operatori economici risultati idonei e facenti parte dell'Accordo quadro, le Aziende potranno ordinare i prodotti in base al criterio della appropriatezza terapeutico-assistenziale; specificatamente potrà essere fornito il prodotto risultato avere il miglior prezzo in gara (1° classificato) e comunque, per garantire al paziente il prodotto con le caratteristiche di miglior adattamento all'anatomia dello stomaco e alle sue modifiche fisiologiche nel tempo (sventramenti, affossamenti, fistolizzazioni) o nei casi di riscontro di manifestazioni allergiche cutanee, presenza di ridotta capacità di cooperazione dello stomaco o di specifiche esigenze ricompresa la necessità di assicurare la continuità terapeutica, si potrà fornire il prodotto che meglio si adatta alle singole situazioni clinico/terapeutiche/gestionali, scegliendo tra quelli offerti per il lotto in questione dagli altri operatori economici in graduatoria.

Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente presso i luoghi indicati negli ordinativi dalle Aziende Sanitarie, devono essere effettuate dal personale utilizzato dalla Ditta per la fornitura.

La fornitura dei prodotti dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, **ENTRO 5** giorni lavorativi (e in casi di urgenza **ENTRO 48 ORE**) dalla data di ricevimento dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:

- Luogo di consegna;
- Numero e data dell'ordine;

- Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- Codice prodotto e quantità.

Il fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza di modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti secondo anche quanto specificato all'art 3 del presente capitolato.

ART. 5 - CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.

Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all'immediata sostituzione **ENTRO 5** giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione (e in casi di urgenza **ENTRO 48 ORE**).

ART. 6 - RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Ogni Azienda provvederà alla nomina del Responsabile di Procedimento della fase di esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 274 D.P.R. 207/2010, che in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione, qualora nominato dalla stessa Azienda per lo svolgimento dei compiti al medesimo attribuiti dallo stesso Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti, fornirà alla ditta/RTI aggiudicataria le informazioni e le modalità organizzative necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto.

Il Responsabile ha inoltre la funzione di interfaccia tra la ditta/RTI aggiudicataria e le esigenze dei reparti/servizi utilizzatori, tra cui la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti, dal relativo regolamento attuativo e dall'Accordo Quadro.

ART. 7 - MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software quali Ms Excel, Access, etc.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Nel dettaglio, il Fornitore dovrà inviare il file che dovrà contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice ISO;
- Codice prodotto fornitore;
- Codice prodotto So.Re.Sa./ASL-AO
- Quantitativo ordinato;
- Valore economico;
- Data ricevimento ordine;
- Data consegna ordine (se evaso).

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_codice fornitore assegnato da Soresa (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al fornitore cod. 2457 assume come nome file 2013_07_2457).

ART. 8 PENALI

In caso di mancata fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne o nelle sostituzioni, qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini stabiliti, l'Azienda applicherà una penale a carico del fornitore inadempiente pari al 5% dell'importo della merce non consegnata o non sostituita e per ogni giorno di ritardo.

Oltre il 10° giorno solare di ritardo non dovuta a causa di forza maggiore, l'amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto.

La So.Re.Sa. Spa inoltre applicherà una penale pari a 250 euro per ogni ritardo nell'invio del flusso dei dati di monitoraggio superiore a 10 giorni rispetto al termine mensile stabilito all'art. 7 del presente capitolato.

Inoltre per ogni settimana ulteriore di ritardo sarà applicata una penale pari a 50 €.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti di fornitura, ciascun aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia fideiussoria in favore della So.Re.Sa S.p.A e delle Amministrazioni contraenti.

Tale cauzione dovrà avere durata quadriennale e sarà calcolata, per ogni Fornitore dell'Accordo Quadro, secondo la formula di seguito definita:

$$\text{Entità Cauzione definitiva} = \frac{\text{Fabbisogno triennale per lotto} \times \text{Prezzo unitario offerto}}{\text{Num. Aggiudicatari dell'Accordo Quadro} \times 10}$$

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'importo complessivo della cauzione sarà calcolato sommando il valore della garanzia, ottenuto secondo la formula sopra riportata, di ciascun lotto.

La cauzione sarà svincolata progressivamente, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso di esaurimento dei contratti di fornitura prima del termine di validità della garanzia, si procederà allo svincolo definitivo della stessa.

In caso di risoluzione di un singolo contratto di fornitura potrà essere ritenuta la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto medesimo sull'ammontare complessivo dei contratti di fornitura del singolo fornitore.

ALLEGATI

ALLEGATO B/1 - Caratteristiche prodotti

ALLEGATO B/2 - Scheda offerta economica



Care at home

CATALOGO PRODOTTI

Urologia Homecare



teleflex

TELEFLEX - CARE AT HOME

Per quanto concerne la gestione dell'incontinenza e dei disturbi vescicali, uno dei nostri principali settori di specializzazione, disponiamo di una pluriennale esperienza e competenza, nonché di un esteso assortimento di prodotti. I nostri prodotti dimostrano la loro elevata qualità e affidabilità nell'uso quotidiano.

Teleflex produce e distribuisce in tutto il mondo dispositivi medici che contribuiscono a ridurre il tasso di infezioni e ad aumentare notevolmente la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. La nostra azienda è specializzata in prodotti e servizi nei settori urologia, chirurgia, accesso vascolare, vie respiratorie, anestesia, compresa l'anestesia regionale, nonché cardiologia. Teleflex opera inoltre nel settore OEM. Grazie a marchi sicuri ed affidabili, Teleflex si connota come un partner affidabile e conveniente.

IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA COMPETENTE

È noto che l'assistenza completa a persone che dipendono da prestazioni post-acute (post-degenza) e continue in regime ambulatoriale e/o domiciliare è possibile solo grazie a prodotti di alta qualità e servizi di consulenza e cura qualificati. In qualità di produttori, è nostra premura fornire un contributo importante affinché le cure ricevute dai pazienti a domicilio siano esattamente di qualità analoga a quelle ricevute in ospedale. La sicurezza e il benessere degli utilizzatori sono al centro della nostra attività. Il nostro obiettivo è garantire a tutti gli utilizzatori assistenza e consulenza ottimali in qualsiasi situazione. Per questo motivo riteniamo che uno dei nostri compiti principali sia quello di perfezionare continuamente la qualità dei nostri prodotti e servizi.



INDICE

CATERI TELEFLEX PER	
L'AUTOCATERISMO INTERMITTENTE.....	4
Liquick® Base	6
Flocath Quick	8
Mobile	10
Mobile SL	12
Liquick® Plus	14
Libero Plus	16
Libero	18
Flocath Introgel	20
Flocath Hydrogel	22
SafetyCat	24
Eruplast	25
Linea di accessori	26
DRENAGGIO URINARIO ESTERNO PER L'UOMO	28
SilikonKondom	28
Ruecco	30
CATERI VESICALI A PERMANENZA	
ProfiCath Preconnesso	34
ProfiCath Plus AquaFlate	36
Bright Plus AquaFlate	38
Stasil Plus	39
Gold Plus	40
Linea di accessori	41
URETEROCUTANEOSTOMIA.....	42
Cateri/futori per ureterocutaneostomia	43
SISTEMI DI DRENAGGIO URINARIO	
S-Bag	46
Sacche da letto	48
Sacche da gamba a tre camere	50
Sacche da gamba	52
Belly Bag	54
PRODOTTI VARI	
Raccogligoce	56
Pessari	57
Carinula rettale	57

SISTEMI PER L'AUTOCATETERISMO INTERMITTENTE TELEFLEX

MAGGIORE INDIPENDENZA, FLESSIBILITÀ E BENESSERE

L'introduzione dell'autocaterismo intermittente è stato un grande traguardo nell'evoluzione dell'urologia. Teleflex si è proposta di introdurre misure efficaci per facilitare e rendere ancora più sicura la vita di coloro che hanno scelto l'autocaterismo intermittente come tecnica personale per la gestione vescicale.

Il perfezionamento di questa tecnica è sempre stato al centro del nostro interesse, in quanto essa permette di migliorare notevolmente la qualità di vita di numerosi pazienti in termini di mobilità, flessibilità e integrazione sociale.


Siamo sempre in cerca di risultati migliori e, con la seguente selezione di prodotti, siamo lieti di poter mettere a disposizione dei pazienti una gamma di svariate possibilità e, quindi, di soluzioni per le loro esigenze individuali.

Alcune particolarità dei nostri cateteri sono, ad esempio, la punta flessibile Ergothan, i fori dai bordi smussati e quindi atraumatici, la particolare scorrevolezza e la lunga durata di lubrificazione del rivestimento idrofilico. Queste e altre caratteristiche dei prodotti riducono il rischio di lesioni uretrali durante la manovra di cateterismo. Particolari sistemi d'inserimento del catetere, come la guaina di protezione di Liquick Base e Flocath Quick consentono un'applicazione completamente asettica, riducendo il rischio di infezioni alle vie urinarie. Una facilità d'uso ancora superiore completa queste straordinarie proprietà dei nostri prodotti, offrendo quindi al paziente il massimo comfort.

Non importa che la preferenza vada ai cateteri con rivestimento idrofilico (Liquick Base, Liquick Plus o Flocath Quick) oppure ai cateteri lubrificati con gel: i nostri cateteri sono tutti disponibili in diverse lunghezze e con diversi tipi di punte.



PUNTE DEI CATERERI




ERGOTHAN:

La punta Ergothan flessibile ed allo stesso tempo stabile sviluppata e brevettata da Teleflex. Perfettamente conformata secondo l'anatomia dell'uretra, essa si adatta in modo ottimale ad ogni movimento raggiungendo facilmente e in modo traumatico la vescica. La forma conica consente inoltre un facile inserimento, poiché la mucosa uretrale non è esposta direttamente alla pressione del diametro massimo del catetere. In tal modo viene ridotto il rischio di lesioni.




NELATON:

La punta Nelaton, dritta e di forma cilindrica, garantisce un inserimento delicato del catetere in un'uretra anatomicamente normale.



PUNTA OLIVARE:

La morbida punta olivare facilita l'inserimento del catetere sia in uretre normali che anatomicamente difficili e riduce il rischio di irritazioni uretrali.



TIEMANN:

La punta Tiemann, curva e leggermente conica, garantisce il massimo controllo durante il passaggio nell'uretra maschile.


FORI DEI CATERERI

Tutti i catereri dei nostri sistemi per autocaterizzismo intermittente hanno un particolare aspetto in comune, cioè presentano fori particolarmente traumatici per la mucosa uretrale molto sensibile.

Il catetere SafetyCat è il catetere inserito nelle soluzioni Lquick Plus e Base, Mobile e Mobile SL, Libero e Libero Plus, ed è dotato di speciali fori di drenaggio brevettati SCE (SoftCat Eyes).

Il catetere Flocath presenta fori intagliati verticalmente, levigati a caldo e smussati, che rendono la manovra di cateterismo ugualmente traumatica e confortevole.

RIVESTIMENTI



RIVESTIMENTO IDROFILICO: Il nostro rivestimento idrofilico è realizzato con PVP (polivinilpirrolidone) per una rapida ed omogenea attivazione, con straordinarie proprietà di scorrevolezza. Presenta inoltre un'eccezionale attricabilità e resistenza ad usura. Il comfort per il paziente è nettamente superiore e il rischio di lesioni è ridotto al minimo.



CATERERI LUBRIFICATI CON GEL:

I nostri catereri con gel lubrificante solubile in acqua garantiscono un cateterismo sicuro e al tempo stesso confortevole e riducono il rischio di lesioni uretrali. Il gel lubrificante perfettamente biocompatibile è integrato nel kit del catetere, quindi rende il catetere pronto per l'uso.


LIQUICK® BASE

PRATICO, DISCRETO, SICURO

Liquid Base contiene il catetere SafetyCat con rivestimento idrofilico, che si attiva grazie alla soluzione salina sterile presente nella confezione. Il catetere è quindi pronto per l'uso in tempi brevissimi.

La guaina di protezione blu consente un'applicazione asettica, poiché permette di inserire il catetere nell'uretra senza mai toccarlo direttamente con le mani.

Per avere le mani completamente libere durante la preparazione della manovra, il paziente può appendere la confezione utilizzando il pratico foro tondo oppure fissarla ad una superficie adatta con l'ausilio del punto autoadesivo.

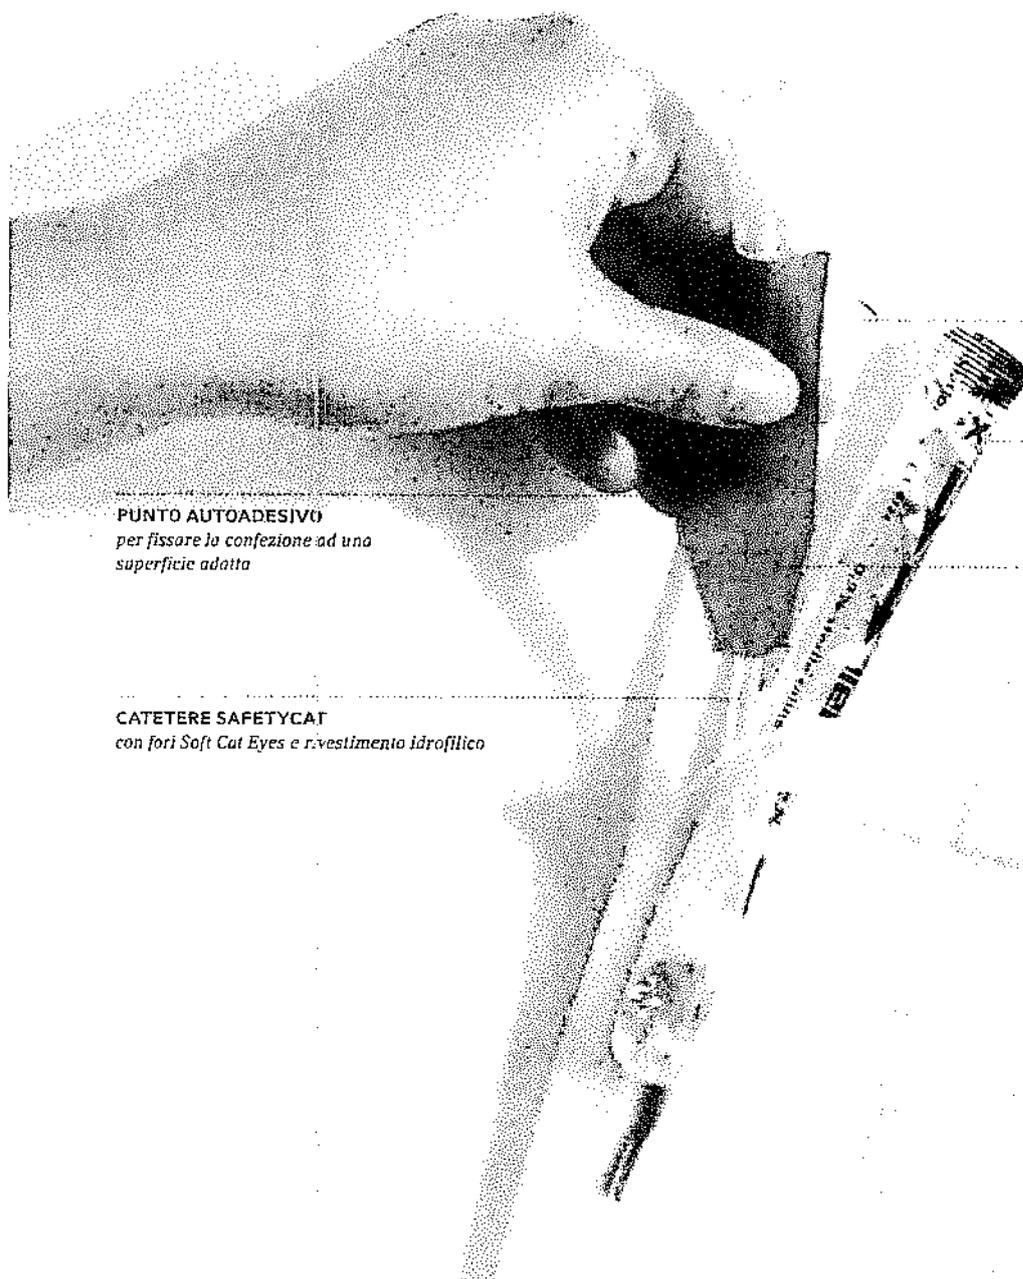

PUNTO AUTOADESIVO
per fissare la confezione ad una
superficie adatta

CATETERE SAFETYCAT
con fori Soft Cat Eyes e rivestimento idrofilico


PRATICO FORO TONDO
facilita l'apertura della confezione e consente
di appendere

**BLISTER CON SOLUZIONE SALINA
STERILE ALLO 0,9%**
per attivare il rivestimento idrofilico

GUAINA DI PROTEZIONE BLU
per un inserimento del catetere
più sicuro ed igienico
(metodica no touch)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE
DI LIQUICK BASE

- ① Comprimerne il blister con la soluzione salina senza aprire la confezione sterile. Appendere la confezione e attendere 30 secondi affinché si attivi il rivestimento idrofilico del catetere.
- ② Aprire la confezione fino ad una lunghezza di circa 10 cm ed estrarre il catetere afferrandolo dalla guaina di protezione blu.
- ③ Tenere fermo il catetere dall'imbuvo e spingere la guaina di protezione blu verso la punta del catetere. A questo punto afferrare il catetere dalla guaina di protezione e inserirlo senza toccarlo con le mani. Spingere di nuovo la guaina di protezione blu verso l'imbuvo. Questa guaina può essere utilizzata come prolunga del catetere.

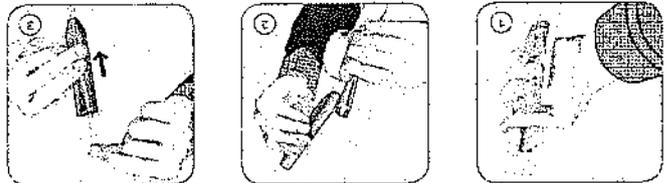

SICUREZZA E COMFORT

- Minima pressione sull'uretra grazie alla punta Ergotman flessibile che si adatta all'anatomia dell'uretra, raggiungendo quindi facilmente e in modo atraumatico la vescica.
- Passaggio atraumatico attraverso la sensibile mucosa uretrale durante la manovra di cateterismo, favorito dagli speciali fori brevettati Soft Cat Eyes, smussati sia internamente che esternamente.
- Attrito* notevolmente ridotto grazie al rivestimento idrofilico scorrevole ed uniforme, che si attiva grazie alla soluzione salina presente nel blister integrato.
- Manipolazione pratica ed igienica grazie alla guaina di protezione, che contribuisce a ridurre il rischio di infezioni alle vie urinarie (metodica no touch).
- Breve tempo di preparazione e rapida applicazione.
- Confezione compatta e maneggevole.

(*La misurazione dell'attrito si basa sul metodo descritto dall'Istituto tecnico di ricerca SP Swedish National Testing and Research Institute.)

40 CM I PUNTA ERGOTMAN - 2 FORI SFALSATI		
6	●	630106 CH 06 912182375
8	●	630108 CH 08 912182387
10	●	630110 CH 10 912182399
12	●	630112 CH 12 912182401
14	●	630114 CH 14 912182540

40 CM I PUNTA ERGOTMAN - 2 FORI SFALSATI		
8	●	630208 CH 08 912182553
10	●	630210 CH 10 912182565

40 CM I PUNTA TIEMANN - 2 FORI SFALSATI		
10	●	630010 CH 10 912182577
12	●	630012 CH 12 912182589
14	●	630014 CH 14 912182591
16	●	630016 CH 16 912182603

40 CM I PUNTA TIEMANN - 2 FORI SFALSATI		
12	●	631012 CH 12 912182615
14	●	631014 CH 14 912182627
16	●	631016 CH 16 912182639

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.009 - Rimborso mensile massimo 180 pezzi per neonati fino ad un anno

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.010 - Rimborso mensile massimo 150 pezzi per bambini fino a 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.011 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi per donna e bambino oltre 6 anni


Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.012 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi per uomo

FLOCATH QUICK*

EFFICIENTE E SICURO

Come Liquick Base, anche Flocath Quick è un sistema per l'autocatereterismo pronto per l'uso. Contiene un catetere con rivestimento idrofilico della serie Flocath con straordinarie caratteristiche di scorrevolezza e un sacchetto con soluzione salina sterile per l'attivazione del rivestimento.

La guaina di protezione blu consente un'applicazione asettica senza toccare direttamente il catetere con le mani, riducendo pertanto il rischio di infezioni alle vie urinarie. Per avere le mani completamente libere durante la preparazione della manovra, è possibile appendere la confezione utilizzando il pratico foro tondo oppure fissarla ad una superficie adatta con l'ausilio del punto autoadesivo.

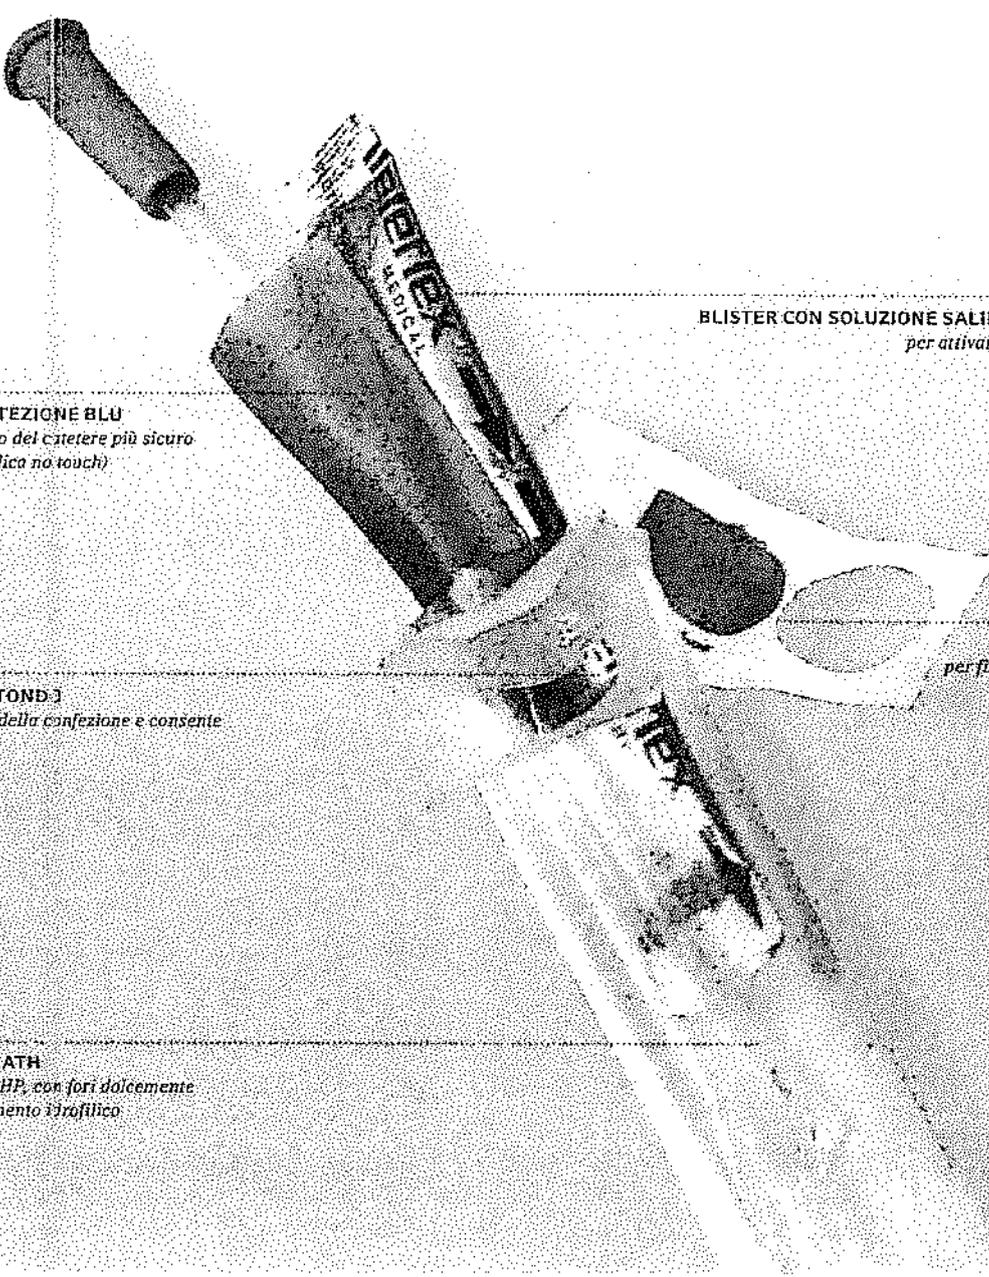

GUAINA DI PROTEZIONE BLU
per un inserimento del catetere più sicuro ed igienico (meta-touch)


PRATICO FORO TONDO
facilita l'apertura della confezione e consente di appenderla

CATERERE FLOCATH
in PVC privo di DEHP, con fori dolcemente smussati e rivestimento idrofilico

BLISTER CON SOLUZIONE SALINA STERILE ALLO 0,9%
per attivare il rivestimento idrofilico

PUNTO AUTOADESIVO
per fissare la confezione ad una superficie adatta

- 1) Premere il blister contenente la soluzione salina senza aprire la confezione sterile. Appendere la confezione e attendere 30 secondi affinché si attivi il rivestimento idrofilico del catetere.
- 2) Aprire la confezione fino ad una lunghezza di circa 10 cm ed estrarre il catetere afferrandolo dalla guaina di protezione blu.
- 3) Tenere fermo il catetere dall'imbuto e spingere la guaina di protezione blu verso la punta del catetere. A questo punto afferrare il catetere dalla guaina di protezione e inserirlo senza toccarlo con le mani. Successivamente, spingere di nuovo la guaina di protezione blu verso l'imbuto. Questa guaina può essere utilizzata come prolunga del catetere.

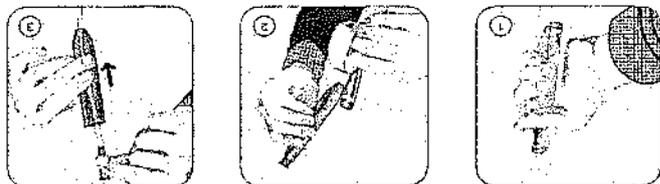

IL MASSIMO COMFORT POSSIBILE

- Inserimento delicato nell'uretra grazie alla punta del catetere dolcemente arrotondata

- Manovra di cateterismo traumatica per la mucosa uretrale sensibile, favorita dai fori del catetere intagliati verticalmente e smussati

- Attrito* notevolmente ridotto grazie al rivestimento idrofilico scorrevole ed uniforme, che si attiva grazie alla soluzione salina presente nel sacchetto integrato

- Elevato comfort grazie alla lunga durata della lubrificazione del rivestimento (10-15 minuti, in funzione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria), che permette una lubrificazione sicura

- Manipolazione pratica ed igienica grazie alla guaina di protezione, che contribuisce a ridurre il rischio di infezioni alle vie urinarie (metodica no touch)

- Breve tempo di preparazione e rapida applicazione

- Confezione compatta e maneggevole

(*La misurazione dell'attrito si basa sul metodo descritto dall'istituto tecnico di ricerca SP Swedish National Testing and Research Institute)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH QUICK

20 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

30	8	851221-000080	90:980008
30	10	851221-000100	90:980022
30	12	851221-000120	90:980034
30	14	851221-000140	90:980046
30	16	851221-000160	92:020275
30	18	851221-000180	92:020287
30	20	851221-000200	92:020299

40 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

30	8	851241-000080	90:533165
30	10	851241-000100	90:533239
30	12	851241-000120	90:533241
30	14	851241-000140	90:533254
30	16	851241-000160	92:020301
30	18	851241-000180	92:020325
30	20	851241-000200	92:020337

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.009 - Rimborso a ensile massimo 180 pezzi per neonati fino a 1 anno

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.09.010 - Rimborso mensile massimo 150 pezzi per bambini fino a 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.09.011 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi per donna e bambini oltre i 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.09.012 - Rimborso mensile massimo 120 pezzi per uomo

* FloCath Quick non è destinato alla vendita in Germania

MOBILE

MOBILITÀ E SICUREZZA IN UN'UNICA SOLUZIONE

Mobile è un sistema di cateteri lubrificati con gel, composto da un catetere di sicurezza SafetyCat con guaina di protezione ed astuccio di dosaggio del gel lubrificante ed un tubetto di gel idrosolubile. La speciale guaina di protezione

evita il contatto mano-catetere mentre l'astuccio di dosaggio consente di applicare il gel in modo particolarmente uniforme, rendendo atraumatica la manovra di cateterismo.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI MOBILE

20 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART	PARAF	QTA
8 ●	560108G CH 08	901841748	60
10 ●	560110G CH 10	901841775	60
12 ●	560112G CH 12	901841787	60
14 ●	560114G CH 14	901841799	60

30 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART	PARAF	QTA
8 ●	560208G CH 08	901841813	60
10 ●	560210G CH 10	901841825	60

40 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART	PARAF	QTA
10 ●	560010G CH 10	901841837	60
12 ●	560012G CH 12	901841849	60
14 ●	560014G CH 14	901841876	60
16 ●	560016G CH 16	901841888	60

40 CM | PUNTA THEMANN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART	PARAF	QTA
14 ●	561014G CH 14	901841940	60
16 ●	561016G CH 16	901841977	60

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.009 - Rimborso mensile massimo
180 pezzi per neonati fino ad un anno

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.010 - Rimborso mensile massimo
150 pezzi per bambini fino a 6 anni




Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.011 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per donna e bambino oltre 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.012 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per uomo

SISTEMA COMPATTO E GESTIONE SICURA

- Tempo di preparazione più breve e semplicità d'uso grazie al tubetto di gel lubrificante fornito in dotazione nella confezione del catetere
- La manovra di cateterismo avviene senza toccare il catetere direttamente con le mani grazie alla guaina di protezione sterile in cui è inserito il catetere SafetyCat
- Applicazione uniforme del gel lubrificante grazie all'astuccio di dosaggio del catetere

- ① Aprire il tubetto del gel lubrificante svitando il cappuccio.
- ② Inserire il tubetto nell'astuccio di dosaggio e applicare il gel lubrificante.
- ③ Inserire il catetere nell'uretra senza toccarlo con le mani e farlo avanzare fino a fare defluire l'urina.




GUAINA DI PROTEZIONE STERILE
per l'inserimento senza contatto diretto
del catetere

TUBETTO CON GE. LUBRIFICANTE STERILE
idrosolubile e ed incluso nella confezione

**ASTUCCIO DI DOSAGGIO DEL GEL
LUBRIFICANTE**
per un'applicazione uniforme del gel

CATERE SAFETYCAT
con fori SCE (Soft Catheter) e
punta Eigothan

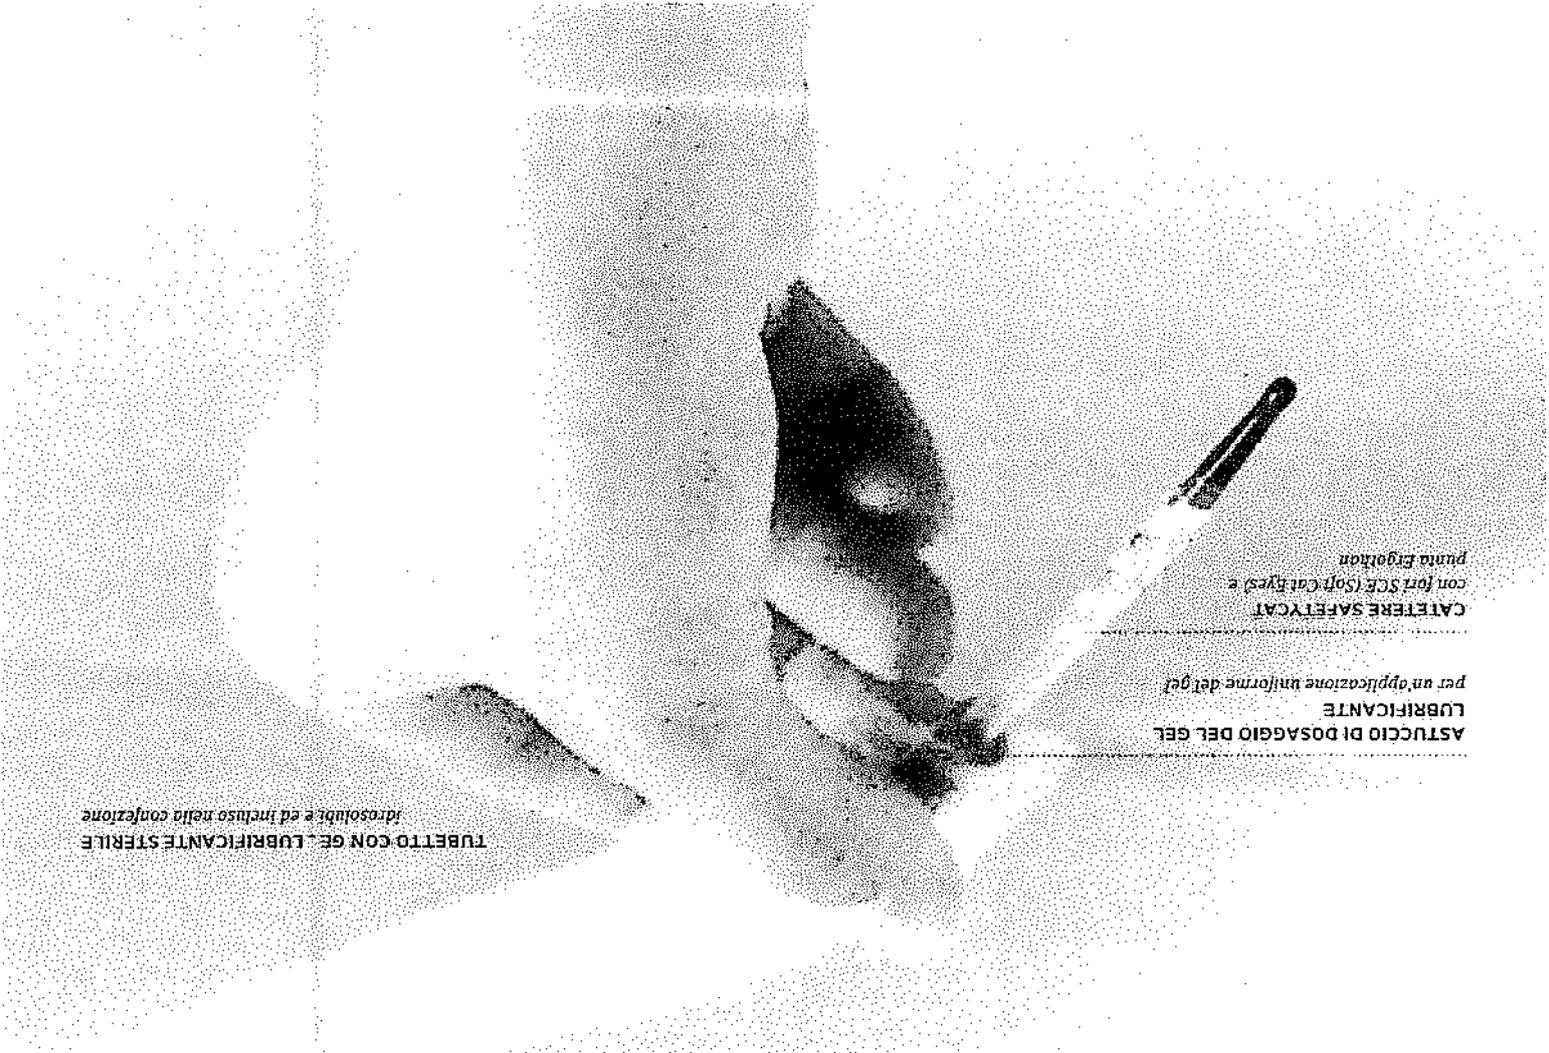

MOBILE SL

IL SISTEMA CON SACCHETTO LUBRIFICANTE IDROSOLUBILE STERILE

Il nostro sistema di cateteri lubrificati con gel Mobile SL si distingue per la semplicità d'uso e per il particolare comfort, nonché per la confezione ecologica. Grazie al serbatoio di gel integrato nella confezione, il catetere viene facilmente lubrificato ed è pronto per l'uso in tempi brevissimi. La confezione robusta e compatta non richiede nessuna

confezione esterna supplementare. Un vantaggio per i pazienti e per l'ambiente. La confezione consente inoltre di introdurre il catetere senza toccarlo con le mani e può essere utilizzata come prolunga per il deflusso diretto dell'urina nella toilette.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI MOBILE SL

20 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	PAZ.	Q.T.
10 ●	580110G CH 10	906999242	60
12 ●	580112G CH 12	906999255	60
14 ●	580114G CH 14	906999267	60

30 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	PAZ.	Q.T.
8 ●	580208G CH 08	906999281	60
10 ●	580210G CH 10	906999293	60

40 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	PAZ.	Q.T.
10 ●	580010G CH 10	906999180	60
12 ●	580012G CH 12	906999216	60
14 ●	580014G CH 14	906999230	60

Rif. Cod. Min. ISO 09.24 06.009 - Rimborso mensile massimo
180 pezzi per neonati fino ad un anno


Rif. Cod. Min. ISO 09.24 06.010 - Rimborso mensile massimo
150 pezzi per bambini fino a 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24 06.011 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per donna e bambino oltre 6 anni


Rif. Cod. Min. ISO 09.24 06.012 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per uomo

RAPIDITÀ DI APPLICAZIONE E DESIGN ECOLOGICO

- Rapida lubrificazione del catetere grazie alla presenza del serbatoio che contiene il gel a base d'acqua idrosolubile gel
- Manovra di cateterismo senza contatto grazie al robusto involucro del catetere
- Facile apertura della confezione grazie alla presenza di una pratica perforazione presente sulla confezione
- Maggiore rispetto dell'ambiente grazie alla confezione del catetere senza confezione esterna supplementare

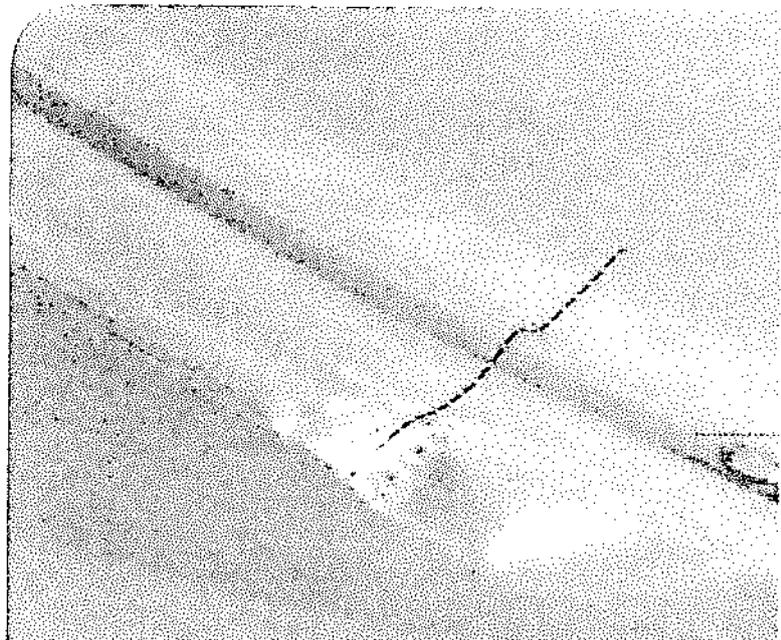

- ① Attivare il serbatoio del gel lubrificante premendo leggermente e distribuire successivamente il gel lungo il catetere.
- ② Strappare la confezione nella zona dell'imbuto del catetere in corrispondenza della perforazione inferiore.
- ③ Strappare il serbatoio del gel lubrificante in corrispondenza della perforazione superiore ed estrarre dal suo involucro il catetere lubrificato, senza toccarlo con le dita.

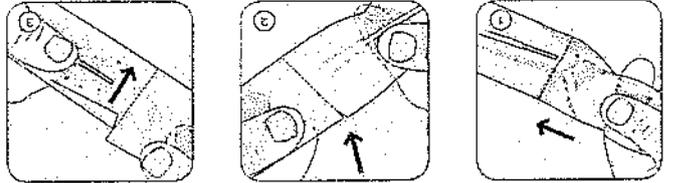

CATERE SAFETYCAT
con fori SCE (Soft Car Eyes) e punta ErgoTip

LINEA DI PERFORAZIONE
per il distacco del serbatoio di gel lubrificante

SERBATOIO DI GEL LUBRIFICANTE
per lubrificare il catetere rapidamente e senza toccarlo con le mani

Drücken
Push
Presser
Premere

LIQUICK® PLUS

ANCORA PIÙ FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Proprio per chi è spesso fuori casa è stato concepito un sistema completo e compatto per l'autocatereterismo, al tempo stesso facile da maneggiare e da smaltire.


Liquick Plus contiene, oltre al catetere SafetyCat con rivestimento idrofilico e sacchetto con soluzione salina sterile, una sacca integrata per la raccolta dell'urina con capacità 1000 ml.

Liquick Plus rende il paziente assolutamente indipendente. La sacca può essere sigillata con un apposito cappuccio e, alla giusta occasione, svuotata e smaltita.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI LIQUICK PLUS

30 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CF	ART.	PARAF.	Q.T.
10 ●	620210 CH 10	921202711	30



40 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

CF	ART.	PARAF.	Q.T.
12 ●	620012 CH 12	921202685	30
14 ●	620014 CH 14	921202697	30
16 ●	620016 CH 16	921202709	30



Rif. Cod. Min. ISO 09.24 09.075 - Rimborso mensile massimo 60 pezzi

LEGGEREZZA E PRATICITÀ DA PORTARE CON SÉ

- Ancora più flessibilità grazie alla sacca di raccolta urina integrata
- Facile attivazione del rivestimento idrofilico del catetere grazie alla soluzione salina sterile contenuta nel sacchetto integrato nella sacca di raccolta urina
- Massima discrezione: una volta utilizzato e risigillato, Liquick Plus può essere svuotato e smaltito in modo discreto
- Migliore qualità di vita e maggiore libertà e indipendenza

CAPPUCCIO
per chiudere l'intero sistema
in tutta sicurezza




CATERERE SAFETYCAT
con fori Soft Cat Eyes, rivestimento idrofilico e
stopper antisfilamento che assicura una chiusura
ermetica ed evita il reflusso di urina

PRATICO FORO TONDO
per appendere facilmente il catetere

① Premere il blister contenente la soluzione fisiologica per attivare il lubrificante idrofilo.

② Rimuovere l'adesivo posizionato sopra il telino di protezione.

③ Estirare il catetere.




SACCA DI RACCOLTA URINA

con capacità 1000 ml e blister integrato con soluzione salina sterile allo 0,9% per attivare il rivestimento idrofilo.

PUNTO DI PRESA BLU

Facilita ed agevola la fuoriscia del catetere SafetyCat dalla sacca di raccolta urina.

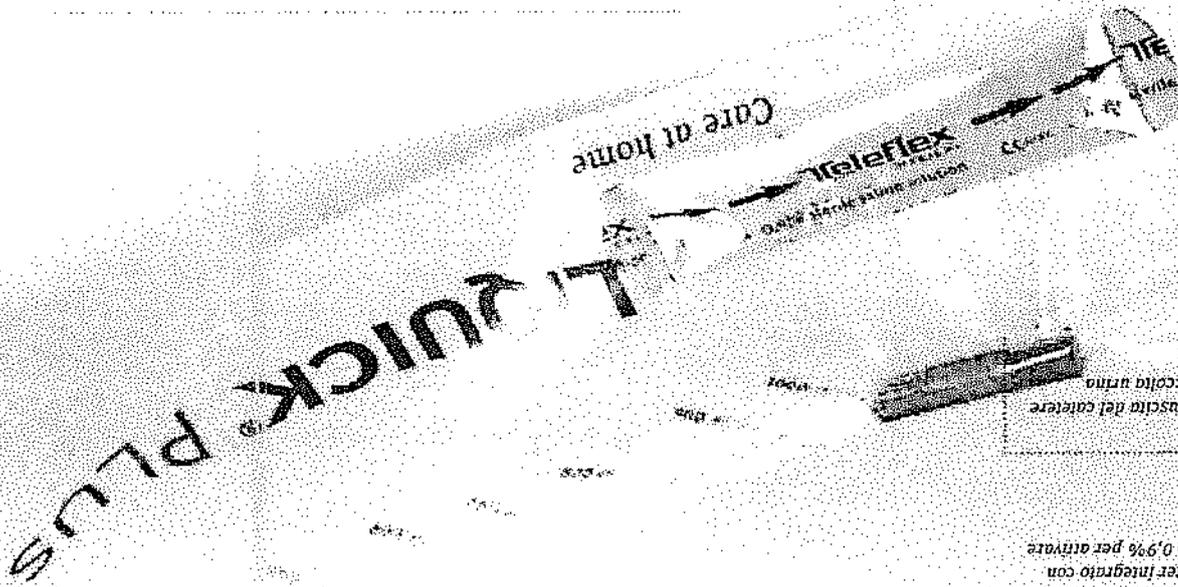

PERFORAZIONE SULLA SACCA
per svuotare l'urina raccolta

LIBERO PLUS

LIBERTÀ ED INDIPENDENZA IN UNA COMODA CONFEZIONE

Abbiamo sviluppato Libero Plus unendo l'ottimo sistema di lubrificazione con gel a un design del prodotto in grado di garantire indipendenza e flessibilità ancora superiori. Libero Plus presenta infatti tutti i vantaggi del nostro catetere di sicurezza SafetyCat e del sacchetto di gel

integrato, combinati alla praticità della sacca di raccolta urina integrata, da portare con sé anche fuori casa. Dopo l'uso, la sacca può essere sigillata con un apposito cappuccio e, alla giusta occasione, svuotata o smaltita.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI LIBERO PLUS


30 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

GR.	AL.	VALORI	PK
10 ●	500210G CH 10	912342387	40

40 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI

GR.	AL.	VALORI	PK
12	500012G CH 12	912642351	40
14 ●	500014G CH 14	912342363	40
16 ●	500016G CH 16	912342375	40

Rif. Cod. Min. ISO 09.24 09.015 - Rimborso mensile massimo 60 pezzi

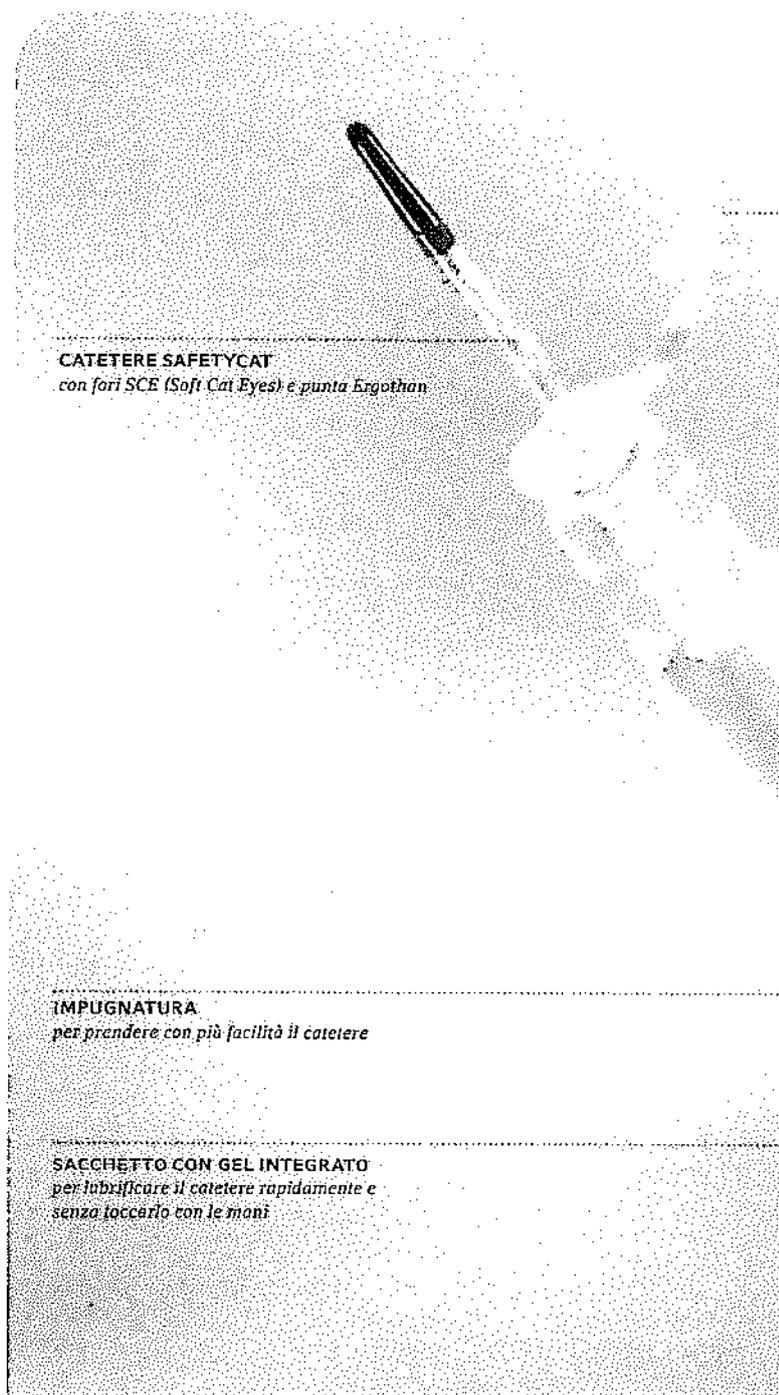

CATETERE SAFETYCAT


con fori SCE (Soft Cat Eyes) e punta Ergothan

IMPUGNATURA

per prendere con più facilità il catetere

SACCHETTO CON GEL INTEGRATO

per lubrificare il catetere rapidamente e senza toccarlo con le mani



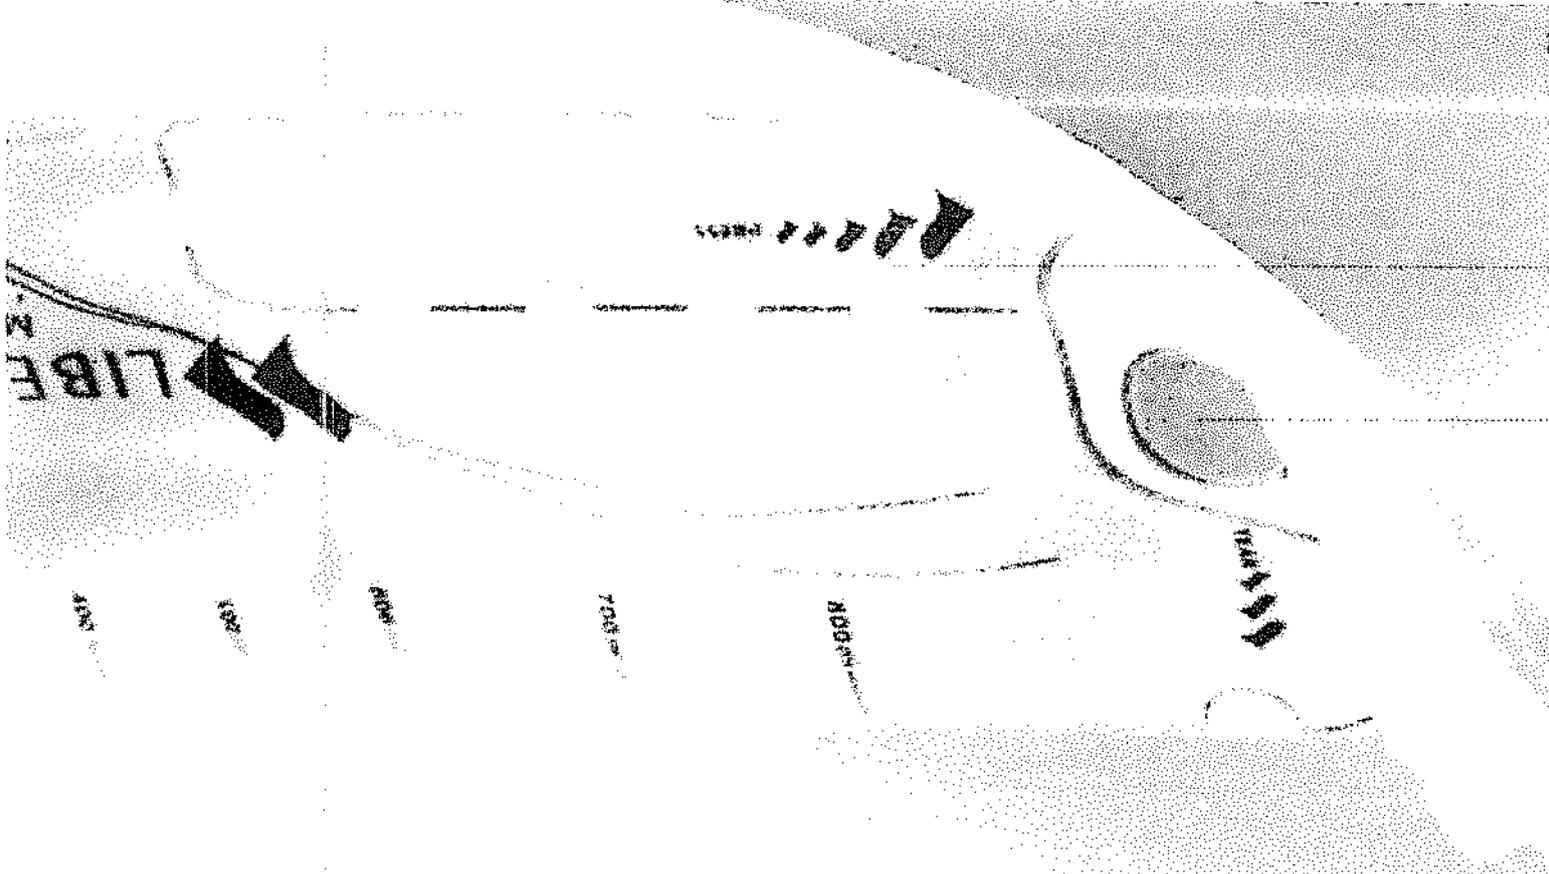


ASTUCCIO DI DOSAGGIO INCLUSIVO DI TAPPO DI CHIUSURA
 per consentire una lubrificazione uniforme del catetere e permettere la chiusura dopo l'uso

- Rapida lubrificazione del catetere con gel grazie all'apposito sacchetto integrato apribile esercitando una leggera pressione
- Manovra di cateterismo senza contatto grazie allo speciale design del prodotto
- Indipendenza e flessibilità grazie alla sacca di raccolta urina integrata, che può essere sigillata con un apposito cappuccio

DESIGN COMPATTO E MANEGGEVOLE

- 1 Attivare il sacchetto premendo leggermente, in modo che il gel in esso contenuto possa lubrificare il catetere.
- 2 Estrarre il catetere lubrificato dalla sacca di raccolta urina senza toccarlo con le dita.
- 3 Tendere la sacca e inserire il catetere nell'uretra.



LIBERO

IL NOSTRO SISTEMA COMPATTO

Libero è un sistema compatto di cateteri lubrificati con gel da utilizzare sia a casa che fuori casa. Il sistema è composto dal catetere di sicurezza SafetyCat, una sacca di raccolta urina integrata e dotata di uno speciale astuccio di dosaggio del gel lubrificante, e un tubetto di gel lubrificante. Grazie all'astuccio di dosaggio presente sulla sacca di raccolta, il

gel lubrificante può essere applicato in modo uniforme e senza contatto, distribuendosi sulla superficie del catetere mentre lo si estrae dalla confezione.

Ciò rende inoltre possibile una manovra di cateterismo sicura e discreta.


INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI LIBERO

40 CM PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSATI				
REF.	DESCRIZIONE	CODICE	QTA.	
10 ●	540010G CH 10	903189734	50	
12 ●	540012G CH 12	903190155	50	
14 ●	540014G CH 14	903190179	50	

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.99.015 - Rimborso mensile massimo 60 pezzi


COMODO SISTEMA IN QUALSIASI SITUAZIONE

- Tempi di preparazione più brevi e semplicità d'uso grazie al tubetto di gel lubrificante contenuto nella confezione del catetere
- Cateterismo senza contatto diretto grazie allo speciale design del prodotto
- Applicazione uniforme del gel lubrificante già durante l'estrazione del catetere dalla sacca di raccolta, grazie allo speciale astuccio di dosaggio
- Indipendenza e flessibilità grazie alla sacca di raccolta urina integrata, sigillabile con l'apposito cappuccio

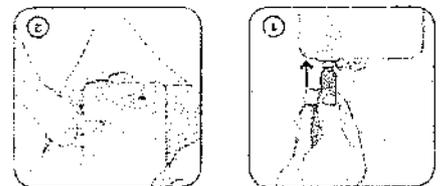

- 1 Inserire il tubetto di gel lubrificante nell'astuccio di dosaggio e applicare il gel.
- 2 Estrarre il catetere lubrificato dalla sacca di raccolta, senza toccarlo con le dita.
Tendere la sacca e inserire il catetere nell'uretra.

CATERERE SAFETYCAT
con fori SCE (Soft Cat Eyes) e punta ErgoMan

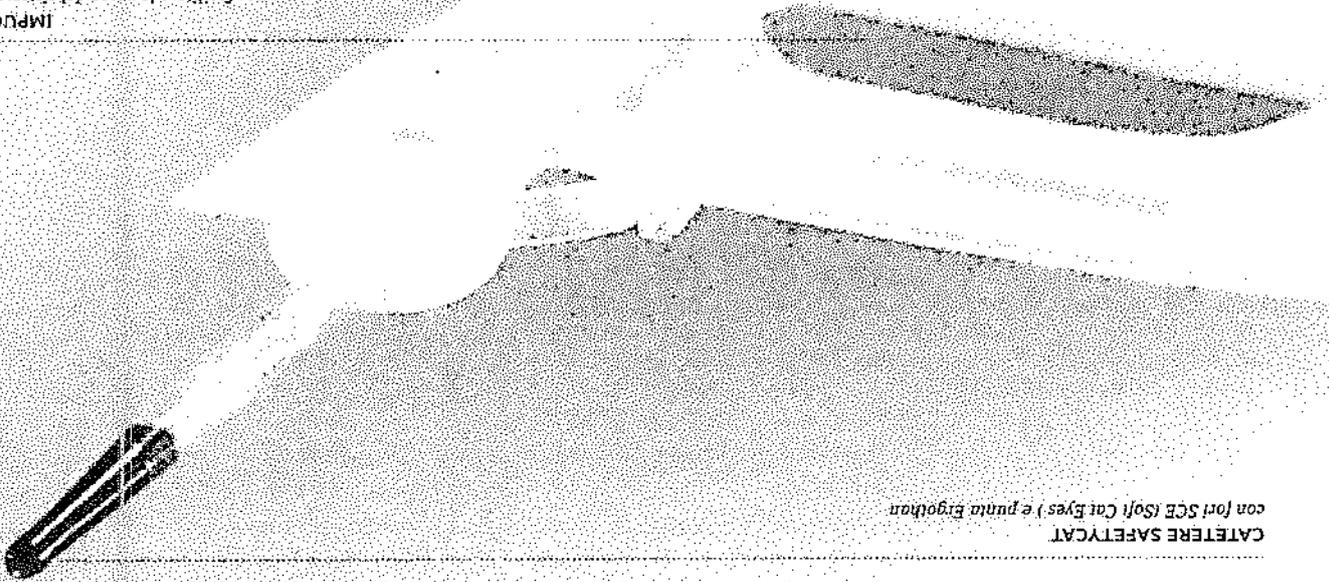

IMPUGNATURA
per facilitare la presa del sistema di cateteri

SACCA DI RACCOLTA URINA INTEGRATA
con cappuccio di chiusura

PERFORAZIONE SULLA SACCA
per lo svuotamento della sacca di raccolta


ASTUCCIO DI DOSAGGIO DEL GEL LUBRIFICANTE
per l'applicazione uniforme del gel lubrificante

FLOCATH INTROGEL

MAGGIORE MOBILITÀ, DISCREZIONE E SICUREZZA

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH INTROGEL

20 CM PUNTA CLIVARE - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851622-000080	907101873	30
	10 ●	851622-000100	907101909	30
	12 ●	851622-000120	907101911	30
	14 ●	851622-000140	907101923	30
	16 ●	851622-000160	907101935	30

30 CM PUNTA CLIVARE - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851632-000080	907101950	30
	10 ●	851632-000100	907101962	30

40 CM PUNTA CLIVARE - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851642-000080	907101974	30
	10 ●	851642-000100	907101998	30
	12 ●	851642-000120	907102002	30
	14 ●	851642-000140	907102014	30
	16 ●	851642-000160	907102026	30

20 CM PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851621-000080	907091944	30
	10 ●	851621-000100	907091957	30
	12 ●	851621-000120	907091969	30
	14 ●	851621-000140	907091971	30
	16 ●	851621-000160	907091983	30

30 CM PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851631-000080	907091995	30
	10 ●	851631-000100	907092009	30

40 CM PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI				
CH	ART.	PARAF.	QTA	
	8 ●	851641-000080	907092011	30
	10 ●	851641-000100	907092023	30
	12 ●	851641-000120	907092035	30
	14 ●	851641-000140	907092047	30
	16 ●	851641-000160	907092050	30




Rif. Cod. Min. ISO 09.24.36.015 - Rimborso mensile massimo 60 pezzi

Flocath Introgel è un catetere lubrificato con gel a base di acqua inserito in una sacca raccolta urina da 1300 ml di capacità. Il catetere è provvisto di un introduttore in silicone lungo 15 mm, che permette di evitare il contatto con la parte dell'uretra dove è maggiore la presenza dei batteri. In tal modo si evita che i batteri penetrino nell'uretra durante l'inserimento del catetere causando infezioni alle vie urinarie. Grazie al suo design, Flocath Introgel può essere applicato in modo asettico, senza toccare direttamente il catetere con le mani.

TUTTO IN UNO, FACILE E RAPIDO

- Elevata mobilità e libertà grazie alla sacca urinaria integrata
- Sicurezza e igiene grazie all'introduttore, che permette di evitare il contatto con la parte dell'uretra dove è maggiore la presenza dei batteri
- Facile inserimento della punta del catetere nell'uretra grazie all'introduttore che apre l'uretra in modo sicuro
- Igienico inserimento del catetere
- Scorrevolezza ottimale grazie al gel lubrificante solubile in acqua integrato nella sacca di raccolta urina (e nel cappuccio)
- Gel lubrificante solubile in acqua, biocompatibile

- 1) Estrarre il sistema dalla confezione sterile e disinfettare.
- 2) Rimuovere il cappuccio contenente gel lubrificante senza toccare l'introduttore del catetere. La punta del catetere si trova ancora nell'introduttore.
- 3) Posizionare l'introduttore nell'orifizio uretrale. Far avanzare il catetere nell'uretra solo quando l'introduttore si trova nell'uretra per evitare il contatto con la parte dove è maggiore la presenza dei batteri.



SACCA DI RACCOLTA URINA

solubile in acqua integrato per un delicato inserimento del catetere

CATERERE FLOCATH

in PVC privo di DEHP, e già lubrificato con gel solubile in acqua, con fori smussati

CAPPUCCIO FACILMENTE RIMOVIBILE

con gel lubrificante solubile in acqua per la massima scorrevolezza fin dalla punta del catetere

AUSILIO PER LA PRESA DEL CATERERE

per un facile inserimento del catetere

INTRODOTTORE

IN SILICONE (15 MM)

per evitare il contatto con la parte dell'uretra dove è maggiore la presenza di batteri

PERFORAZIONE SULLA SACCA

per svuotare l'urina raccolta

RATICO FORO TONDO

per appenere facilmente il catetere

FLOCATH
Intro Gel

EURO

FLOCATH HYDROGEL, LUER-LOCK & INDIANA MAINZ

AMPIA VARIETÀ DI CATETERI CON RIVESTIMENTO IDROFILICO

La nostra gamma Flocath Hydrogel offre un'ampia scelta di cateteri con rivestimento idrofilico in svariate lunghezze e dimensioni, oltre a diversi tipi di punte. A prescindere dal fatto che si tratti di applicazioni standard o applicazioni

speciali, come il cateterismo per tasca continente, il sistema Flocath Hydrogel ha il catetere giusto per ogni situazione. Il paziente potrà inoltre beneficiare del rivestimento idrofilico e delle sue eccellenti proprietà lubrificanti.

LUER-LOCK ADAPTER

per l'instillazione di farmaco in vescica

CATETERE FLOCATH

in PVC privo di DEHP

4 FORI DEL CATETERE

per il drenaggio ottimale dell'urina
anche in presenza di muco

IL CATETERE GIUSTO PER OGNI SITUAZIONE

- Passaggio atraumatico attraverso la sensibile mucosa uretrale durante la manovra di cateterismo, favorito da punte dolcemente arrotondate e fori smussati
- Attrito notevolmente ridotto grazie al rivestimento idrofilico uniforme ed estremamente scorrevole*
(* La misurazione dell'attrito si basa sul metodo descritto dall'istituto tecnico di ricerca SP Swedish National Testing and Research Institute.)
- Elevato comfort grazie alla lunga durata della lubrificazione del rivestimento (10-15 minuti, in funzione della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria), che lascia tempo sufficiente per eseguire la manovra di cateterismo
- Flocath Luer-Lock: l'adattatore Luer-Lock sostituisce l'imbuto, garantendo l'instillazione semplice e sicura dei farmaci in vescica
- Flocath Indiana Mainz: catetere speciale per cateterismo trans-ombelicale per tasca continente, dotato di punta Tiemann e 4 fori, per migliore drenaggio urinario postoperatorio e drenaggio ottimale delle secrezioni mucosali

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH HYDROGEL

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	8	851122-000080	907091805
30	10	851122-000100	907091817
30	12	851122-000120	907091829
30	14	851122-000140	907091831
30	16	851122-000160	907091843

30 CM | PUNTA OLIVARE - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	8	851132-000080	907091856
30	10	851132-000100	907091868

40 CM | PUNTA OLIVARE - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	8	851142-000080	907091870
30	10	851142-000100	907091882
30	12	851142-000120	907091894
30	14	851142-000140	907091906
30	16	851142-000160	907091918
30	18	851142-000180	907091920

20 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	8	851121-000080	907089686
30	10	851121-000100	907089698
30	12	851121-000120	907089700
30	14	851121-000140	907089712
30	16	851121-000160	907089724

30 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	6	851131-000060	907089736
30	8	851131-000080	907089748
30	10	851131-000100	907089751

40 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	8	851141-000080	907090017
30	10	851141-000100	907090029
30	12	851141-000120	907090031
30	14	851141-000140	907090043
30	16	851141-000160	907090056
30	18	851141-000180	907090068
30	20	851141-000200	907090070

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.009 - Rimborso n. esile massimo

180 pezzi per neonati fino ad un anno

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.010 - Rimborso n. esile massimo


150 pezzi per bambini fino a 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.011 - Rimborso n. esile massimo

120 pezzi per donna e bambino oltre 6 anni

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.012 - Rimborso n. esile massimo

120 pezzi per uomo

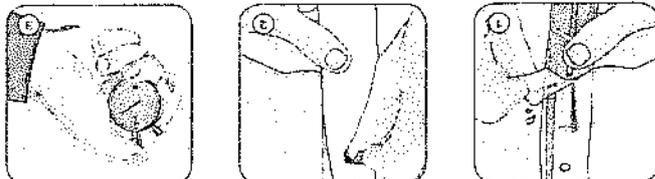

1) Aprire la sacca con apertura a strappo e riempirla con 20-30 ml di acqua sterile o soluzione salina sterile allo 0,9%.

2) Fissare la sacca su una superficie adatta con l'ausilio del punto autoadesivo.

3) Dopo 30 secondi si attiva il rivestimento idrofilico e si può procedere con l'inserimento del catetere.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH HYDROGEL

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	10	851143-000100	907091755
30	12	851143-000120	907091767
30	14	851143-000140	907091779
30	16	851143-000160	907091781
30	18	851143-000180	907091793

40 CM | PUNTA TIEMANN - 2 FORI SFALSATI

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH LUER-LOCK

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	10	850218-000010	902287895
30	12	850218-000012	902287857
30	14	850218-000014	902287871

40 CM | PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI FLOCATH INDIANA MAINZ

CH	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
30	12	850251-000012	906659065
30	14	850251-000014	906659077

40 CM | PUNTA TIEMANN - 4 FORI SFALSATI

SAFETYCAT

IL NOSTRO CATERETERE DI SICUREZZA

Per un cateterismo sicuro, è importante che i prodotti rispondano ad un elevato standard qualitativo. Il catetere SafetyCat è il nostro catetere di sicurezza: i fori smussati sia internamente che esternamente per preservare l'integrità dell'uretra, la punta Ergothan consente grazie alla sua forma conica di diminuire la pressione sull'uretra ed infine la sua superficie consente un'ottimale distribuzione del lubrificante su tutta la superficie.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI SAFETYCAT

40 CM | PUNTA ERGOTHAN - 2 FORI SFALSA TI

SP	AKS	PARAF	CFA
12	220822S/12	901842272	50
14	220822S/14	901842296	50



Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.003 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per donna

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.006 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per uomo

SAFETYCAT
PUNTA ERGOTHAN
2 FORI SFALSA TI
40 CM

0.054

SAFETYCAT



ERUPLAST

IL CATETERE AD UNA VIA NON RIVESTITO

La nostra gamma di cateteri ad una via Eruplast è

disponibile in diverse lunghezze, misure e punte. Eruplast è realizzato in PVC leggermente opaco resistente

alla pressoflessione che mantiene la morbidezza

necessaria ad effettuare un cateterismo atraumatico.

I fori ben rifiniti e le pareti lisce ed uniformi diminuiscono l'attrito.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI ERUPLAST

CH	ART.	PAZ.	Q.T.A.
18 CM I PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI			
60	8 ● 850160/08	901207910	60
60	10 ● 850160/10	901207922	60
60	12 ● 850160/12	901207934	60
60	14 ● 850160/14	901207946	60
60	16 ● 850160/16	901207959	60

CH	ART.	PAZ.	Q.T.A.
40 CM I PUNTA NELATON - 2 FORI SFALSATI			
60	6 ● 850162/06	906658695	60
60	8 ● 850162/08	901207961	60
60	10 ● 850162/10	901207973	60
60	12 ● 850162/12	901207985	60
60	14 ● 850162/14	901207997	60
60	16 ● 850162/16	901208001	60
60	18 ● 850162/18	901208013	60
60	20 ● 850162/20	901208025	60
60	22 ● 850162/22	901208037	60

CH	ART.	PAZ.	Q.T.A.
40 CM I PUNTA TIEMANN - 2 FORI SFALSATI			
60	8 ● 850164/08	901554168	60
60	10 ● 850164/10	901208049	60
60	12 ● 850164/12	901208052	60
60	14 ● 850164/14	901208064	60
60	16 ● 850164/16	901208076	60
60	18 ● 850164/18	901208088	60

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.003 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per donna

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.006 - Rimborso mensile massimo
120 pezzi per uomo

LINEA DI ACCESSORI

PRATICI AUSILI PER FACILITARE OGNI GIORNO L'AUTOCATERISMO

La nostra gamma di prodotti si completa con una linea di accessori dedicati per gestire in modo autonomo l'autocaterismo intermittente.

ABBASSAPANTALONI FREEHAND

Allontana in modo sicuro gli abiti dai genitali, consentendo di avere le mani libere per la manovra di caterismo, senza mai toccare il catetere e gli abiti.

SUPPORTO PER TETRAPLEGIA

ERGOHAND

Consente anche ai pazienti con limitata funzionalità della mano di eseguire autonomamente la manovra di caterismo. Il catetere viene fissato nell'angolazione del supporto, quindi può essere inserito nell'uretra senza essere assolutamente toccato. ErgoHand è disponibile in versione femminile e maschile.

DIVARICATORE FEMMINILE LEGFIX

Tiene ferme le gambe in modo sicuro durante la manovra di caterismo. Il divaricatore femminile può essere ripiegato in modo pratico e compatto e riposto nella sua custodia di trasporto.



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

FREHAND

ABBASSAPANTALONI

Art.	355400
QTA	1

ERGOHAND

SUPPORTO PER TETRAPLEGIA UOMINI

Art.	355420
QTA	1

SUPPORTO PER TETRAPLEGIA DONNE

Art.	355421
QTA	1

LEGFIX

DIVARCATORE FEMMINILE

Art.	355510
QTA	1

OPTILUX

SPECCHETTO PER MANO DESTRA

Art.	355200
QTA	1

SPECCHETTO PER MANO SINISTRA

Art.	355300
QTA	1

SPECCHETTO CON LAMPADA, PER MANO DESTRA




Art.	355210
QTA	1

SPECCHETTO CON LAMPADA, PER MANO SINISTRA

Art.	355310
QTA	1

SPECCHETTO OPTILUX

Consente di individuare più facilmente l'ingresso nell'uretra femminile. Lo specchio è provvisto di un nastro in tessuto flessibile con chiusura in velcro, che permette di fissarlo alla coscia. Optilux è disponibile in versione per destrimani e mancini, sia con che senza lampada.




1 Abbassapantaloni FreeHand

2 Supporto per tetraplegia ErgoHand

3 Divarcatore femminile LegFix

4 Specchietto Optilux, disponibile con o senza lampada

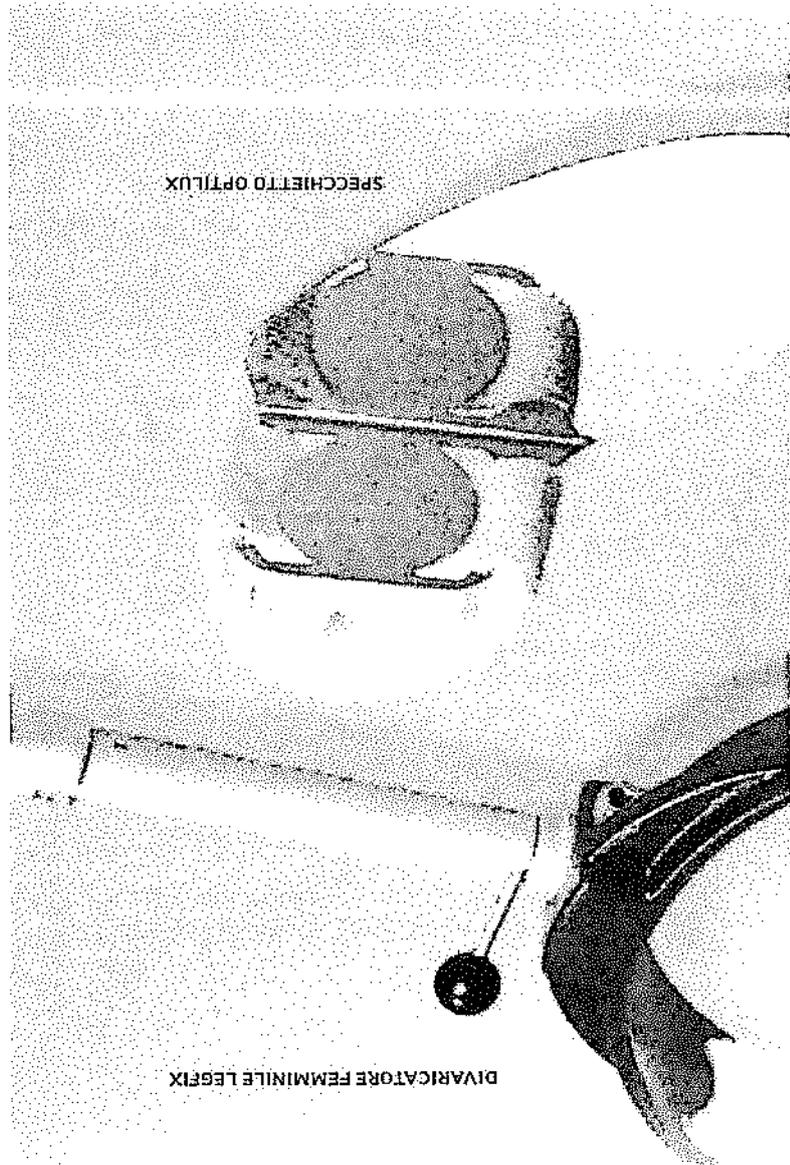

SPECCHETTO OPTILUX

DIVARCATORE FEMMINILE LEGFIX


DRENAGGIO URINARIO ESTERNO PER L'UOMO

Gli uomini che soffrono di incontinenza possono utilizzare guaine in silicone privo di lattice, traspiranti e delicate sulla pelle. Il materiale in silicone sottile e flessibile si adatta perfettamente alle caratteristiche anatomiche, è facilmente posizionabile ed è particolarmente indicato anche per pazienti con allergia al lattice. Grazie al loro rivestimento brevettato, le guaine per incontinenza sono autoadesive, quindi si applicano senza alcun tipo di difficoltà.


A seconda delle proprie esigenze, il paziente può scegliere fra tre diverse forme base con cinque diverse misure ciascuna. La scelta corretta della guaina per incontinenza è fondamentale per un efficace deflusso dell'urina. E' disponibile su richiesta un misuratore per l'identificazione corretta dell'articolo.



① Posizionare la guaina sul glande del pene senza retrainare il prepuzio.



② Srotolare lentamente e uniformemente la guaina, facendo attenzione che rimanga sufficiente spazio fra l'imbuto della guaina e il glande. Evitare la formazione di pieghe nella parte adesiva.



③ Collegare una sacca di raccolta urina alla guaina. Per informazioni sulle sacche di raccolta urina adeguate consultare pagina relativa alle sacche urina da gamba e da letto.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELLE GUAINA PER INCONTINENZA SILKOKONDOM

SILKOKONDOM STANDARD - ULTRAFLEX IN SILICONE

DIAMETRO	ART.	PARAF.	QTA.
25 mm	850327-000025	902288188	30
29 mm	850327-000029	902288214	30
32 mm	850327-000032	902288226	30
36 mm	850327-000036	902288202	30
41 mm	850327-000041	902288238	30

SILKOKONDOM SHORT - POP-ON IN SILICONE

DIAMETRO	ART.	PARAF.	QTA.
25 mm	850328-000025	902288240	30
29 mm	850328-000029	902288253	30
32 mm	850328-000032	902288265	30
36 mm	850328-000036	902288277	30
41 mm	850328-000041	902288289	30

SILKOKONDOM LONG - WIDEBAND IN SILICONE

DIAMETRO	ART.	PARAF.	QTA.
25 mm	850329-000025	902288303	30
29 mm	850329-000029	902288315	30
32 mm	850329-000032	902288327	30
36 mm	850329-000036	902288339	30

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.09.003 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi



GUAINA PER INCONTINENZA PRATICO DRENAGGIO URINARIO PER L'UOMO

Guaine monouso studiate appositamente per il deflusso dell'urina in caso di incontinenza maschile, che si associano in modo ottimale ai nostri sistemi di drenaggio urinario (vedere le pagine relative alle sacche urina da gamba e da letto).
Le guaine per incontinenza sono realizzate in silicone privo di lattice, trasparente, e grazie al loro rivestimento autoadesivo brevettato garantiscono una efficace e sicura tenuta ed un ottimale deflusso dell'urina.

Si consiglia di sostituire la guaina al massimo dopo 24 ore. In base alle esigenze individuali, le nostre guaine per incontinenza sono disponibili in cinque diverse misure e tre diverse forme: Ultraflex (la nostra guaina standard), Short - Pop-On (con una superficie adesiva massima di 8,8 cm indicata per pene retrattile) e Long - Wideband (con una superficie adesiva massima di 7,6 cm).
Per un deflusso dell'urina ottimale e fondamentale che la guaina sia della misura precisa.

FACILI DA USARE, CONFORTEVOLI, DISCRETE

- 3 forme base (Ultraflex, Pop-On* e Wideband) in 5 diverse misure ciascuna
- In silicone privo di lattice, quindi analitigiche Autoadesive
- Traspiranti
- Trasparenti
- Inodore
- Resistenti al kinking
- Durata di permanenza massima consigliata 24 ore

** indicato in particolare per pene retrattile*

RUECCO

GUAINA PER INCONTINENZA SENZA LATTICE

La filosofia Teleflex è quella di rendere la vita più facile e più gestibile per le persone che soffrono di incontinenza. Questo impegno si concretizza nello sviluppo di prodotti con caratteristiche efficaci, fabbricati con materiali gradevoli che minimizzano qualsiasi rischio di reazione allergica. La gamma di guaine per incontinenza Ruecco segue correttamente questa via. La guaina e gli accessori privi di lattice ne rendono l'uso quotidiano sicuro.






INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELLE GUAINE PER INCONTINENZA RUECCO

RUECCO PRIVO DI LATTICE			
DIAMETRO	ART.	PACCH.	Q.TA.
20 mm	854410-000200	907103446	30
25 mm	854410-000250	907103459	30
30 mm	854410-000300	907103497	30
35 mm	854410-000350	907103509	30
40 mm	854410-000400	907103523	30

CATETERE ESTERNO CONDOM CON FASCETTA PRIVO DI LATTICE			
DIAMETRO	ART.	PACCH.	Q.TA.
20 mm	854460-000200	907103636	30
25 mm	854460-000250	907103648	30
30 mm	854460-000300	907103651	30
35 mm	854460-000350	907103687	30

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.39.003 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi





- ① Srotolare uniformemente il catetere esterno.
- ② Fissare il catetere con nastro in tessuto.
- ③ Collegare il catetere alla sacca raccoglii urina.

- ① Applicare sul pene la siringa biadesiva.
- ② Srotolare uniformemente il catetere esterno.
- ③ Collegare il catetere alla sacca raccoglii urina.

CATETERI VESCICALI A PERMANENZA

PER IL MASSIMO DELLA SICUREZZA E DEL COMFORT

Teleflex offre un programma di cateterismo per tutte le esigenze, sia per il drenaggio a breve, media e lunga permanenza.


Per evitare infezioni alle vie urinarie, i cateteri vescicali a permanenza dovrebbero essere inseriti esclusivamente sotto stretta indicazione medica e rimossi quanto prima possibile.

Uno dei principali motivi di attenzione nell'applicazione di un catetere vescicale a permanenza è il fatto che il materiale presenti una ridotta tendenza all'incrostazione, sia perfettamente tollerato dall'organismo e, pertanto, non causi irritazioni alla mucosa uretrale. Il catetere per questo tipo di applicazione deve essere inoltre flessibile e perfettamente adattabile per garantire il massimo comfort d'uso.


I nostri cateteri in silicone scanalato e liscio soddisfano perfettamente questi requisiti.



PUNTE DEI CATETERI



CILINDRICA:
La punta cilindrica e dolcemente arrotondata garantisce un inserimento delicato e atraumatico del catetere nell'uretra.



TIEMANN:
La punta Tiemann, curva e leggermente conica, indicata per il cateterismo maschile garantisce il massimo controllo durante la manovra di cateterismo.



Tutti i nostri cateteri vescicali a permanenza presentano sulla valvola dell'imbuto una codifica cromatica per definire la misura.

MATERIALI

SILICONE
MATERIALE IDEALE PER CATETERI A LUNGA PERMANENZA

I cateteri con palloncino in puro silicone privo di coloranti si caratterizzano per la superficie liscia, sia esternamente che internamente. Il silicone scanalato, che consente il drenaggio delle secrezioni uretrali e riduce il rischio di decubiti uretrali è estremamente biocompatibile ed è il più indicato nella lunga permanenza. Sono per tanto rari i casi di irritazione cutanea e irritazione uretrale, come pure incrostazioni all'esterno e all'interno del catetere. Sono rare reazioni allergiche. Il silicone è quindi il materiale ideale per il cateterismo a lungo termine.

Grazie alle sue caratteristiche di solidità e, al tempo stesso, di estrema flessibilità del materiale, il catetere può essere inserito con facilità e sicurezza. L'elevato comfort d'uso e le prestazioni di drenaggio ottimali sono altre prerogative distintive. I nostri cateteri in silicone sono trasparenti, quindi facilitano la valutazione dello stato interno del catetere, facilitando l'eventuale decisione di una sostituzione.

LATTICE*
VARIANTE PARTICOLARMENTE ECONOMICA PER IL RAPIDO DRENAGGIO DELL'URINA


I cateteri con palloncino RUSCH Gold sono realizzati con una miscela di lattice naturale siliconato.

**I cateteri in lattice non devono essere utilizzati su pazienti sensibili che presentano reazioni allergiche ai componenti di questi prodotti.*

USO PEDIATRICO:
I bambini sono più delicati e reagiscono in modo più sensibile rispetto agli adulti. Si rammenta che tutti i nostri cateteri sono realizzati con estrema cura, applicata fin nei minimi dettagli. Garantiamo pertanto che tutti i nostri cateteri sono provvisti di punte e fori levigati e dolcemente smussati. Soprattutto a livello pediatrico è indicato l'impiego di materiali di massima qualità e, in caso di applicazioni a lungo termine, raccomandiamo l'utilizzo di cateteri vescicali a permanenza in puro silicone.

SISTEMA PRECONNESSO: MASSIMA SICUREZZA ED ECONOMICITÀ

SISTEMA DI DRENAGGIO URINARIO A CIRCUITO CHIUSO CON CATETERE CON PALLONCINO IN SILICONE CON
SCANALATURE LONGITUDINALI PER APPLICAZIONE A LUNGO TERMINE

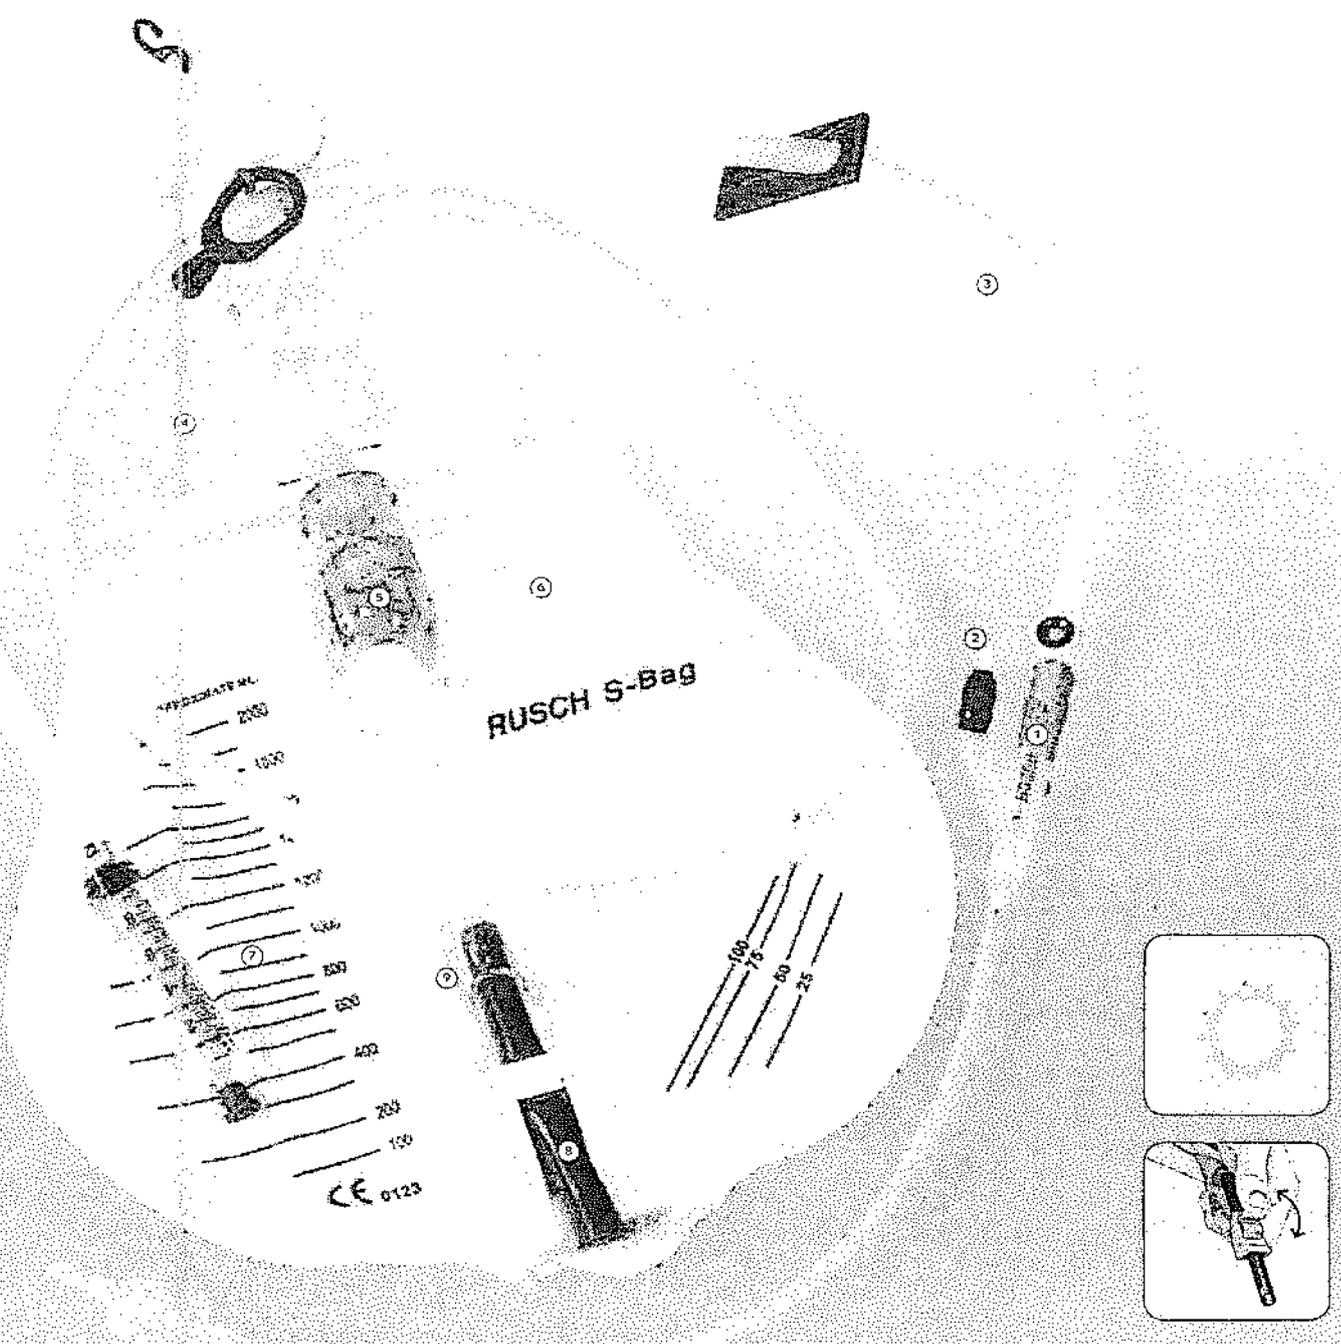

Quali produttori di sistemi per il cateterismo vescicale a permanenza di elevata qualità, riserviamo la massima attenzione alla prevenzione delle contaminazioni batteriche, causa di possibili infezioni alle vie urinarie. Circa il 30% della colonizzazione intraluminale avviene esattamente nel punto di raccordo tra sacca raccolta urina e catetere. Per evitare i rischi associati all'uso dei sistemi di drenaggio dell'urina aperti e il rischio di disconnessione del catetere, abbiamo progettato un sistema innovativo di circuito chiuso denominato ProfilCath Preconnesso.

SISTEMA DI DRENAGGIO DELL'URINA A CIRCUITO CHIUSO, 2000 ML

- ① **RACCORDO UNIVERSALE ANTISFILAMENTO**
punto di connessione tra catetere e sacca
- ② **PUNTO DI PRELIEVO URINARIO SENZA USO DI AGO**
evita le lesioni provocate dalla puntura dell'ago
- ③ **TUBO FLESSIBILE E RESISTENTE ALL'INGOCCHIAMENTO, LUNGO 120 CM**
con morsetto scorrevole e clip per lenzuolo
- ④ **GANCIO DOPPIO RESISTENTE CON CORDINO SUPPLEMENTARE**
per assicurare un fissaggio sicuro del sistema di drenaggio urinario al letto
- ⑤ **GOCCIOLATOIO CON FILTRO DI AERAZIONE E VALVOLA DI NON RITORNO INTEGRATA**
evita il reflusso di urina e la risalita della batteriuria
- ⑥ **ULTERIORE FILTRO DI AERAZIONE ANTIBATTERICO E A TENUTA DI LIQUIDO SULLA SACCA**
per un equilibrio ottimale della pressione con un deflusso sicuro
- ⑦ **GRADUAZIONE CHIARA IN ML**
- ⑧ **SCARICO ANTIGOCCIOLAMENTO SUL FONDO CON MORSETTO PER UTILIZZO CON UNA SOLA MANO**
per lo svuotamento rapido e igienico della sacca
- ⑨ **SITO DI ALLOGGIAMENTO PER IL TUBO DI SCARICO**
evita il contatto costante con le aree del pavimento prevenendo i rischi di contaminazione

PROFILCATH

Catetere con palloncino in silicone trasparente - con scanalature longitudinali - per il drenaggio delle secrezioni uretrali

- Palloncino a 10ml
- Punta piena, cilindrica, asettica
- 2 fori contrapposti
- Punta e fori del catetere atraumatici
- Punta radiopaca e linea radiopaca lungo lo stelo del catetere
- Imbuto con valvola per siringhe con attacco Luer e Luer-Lock
- Elasticità costante e biocompatibilità grazie al materiale silicone
- Grandi fori e ampio lume interno per consentire elevate prestazioni drenanti
- Minima tendenza alla formazione di incrostazioni grazie alle superfici scanalate

PER LUNGA PERMANENZA, SILFLATE

Siringa pre-riempita con 10ml di soluzione di glicerina al 10% sterile per gonfiare il palloncino:

- Minor tempo di preparazione
- Maggiore asepticità della procedura
- Volume di riempimento del palloncino costante (tempo di permanenza oltre i 30 giorni)
- Risparmio di tempo e denaro non essendo necessari controlli regolari e ripetuti gonfiaggi del palloncino

Un catetere in puro silicone dotato di scanalature longitudinali (ProfilCath), preconnesso ad un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso (S-Bag), consente di salvaguardare la "zona critica" mediante una pellicola protettiva, evitando così, la disconnessione accidentale. Qualsiasi manipolazione, intenzionale o accidentale, risulterà immediatamente visibile.

"PRECONNESSO" SIGNIFICA:

- Massima profilassi contro le infezioni grazie alla riduzione del rischio di invasione batterica
- Riduzione delle infezioni alle vie urinarie per via ascendente intraluminale
- Elevata economicità grazie ad una permanenza oltre i 30 giorni (classe IIb)
- Risparmio di tempo
- Maggiore sicurezza durante la manovra di cateterismo

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DEL SISTEMA PROFILCATH PRECONNESSO

SISTEMA DI DRENAGGIO URINARIO PRECONNESSO IN SILICONE SCANALATO

FR	A.P.T.	PAZIF	SPS
14	851086-000140	921305734	1*
16	851086-000160	921305746	1*
18	851086-000180	921305759	1*
20	851086-000200	921305761	1*

* In confezione singola sterile contenente modo d'uso
Rif. Cod. Min. ISO 09.24.03.003 - Rimborso mensile massimo 2 pezzi

PROFILCATH PLUS AQUAFATE


CATERE CON PALLONCINO IN SILICONE, TRASPARENTE, CON SCANALATURE LONGITUDINALI PER DRENARE LE SECREZIONI URETRALI, CON SIRINGA PRE-RIEMPIA PER GONFIARE IL PALLONCINO

catetere può formarsi fra lo stelo del catetere vescicale a permanenza e la mucosa uretrale una membrana mucopurulenta che rappresenta un terreno di coltura ideale per lo sviluppo di infezioni. Affinché le secrezioni uretrali possano defluire regolarmente è necessaria una distanza sufficiente fra lo stelo del catetere e la mucosa uretrale. La geometria dello stelo del catetere ProfilCath con le sue scanalature longitudinali sulla superficie favorisce il drenaggio delle secrezioni dall'uretra. Per questo motivo ProfilCath è indicato soprattutto per i pazienti che necessitano di un catetere a permanenza a lungo termine.

Le infezioni alle vie urinarie sono in aumento e, in molti casi, possono essere associate all'uso di cateteri vescicali. Accanto ai fattori di rischio noti per tutti i pazienti, anche la scelta di cateteri vescicali a permanenza di misura troppo grande può causare ulteriori complicanze nell'uretra maschile. Quando un catetere vescicale a permanenza inserito nell'uretra (transuretrale) blocca il deflusso delle secrezioni dalle ghiandole paraventricolari, può formarsi un'ostruzione da secrezioni nell'uretra, che può favorire lo sviluppo di infezioni. Già poco tempo dopo l'inserimento del

SOLUZIONE DI GLICERINA TESTATA IN LABORATORIO

- Nei cateteri con palloncino gonfiati con acqua sterile e glicerina, la riduzione del volume di riempimento è trascurabile dopo una permanenza di oltre trenta giorni, mentre nei cateteri gonfiati solo con acqua sterile con palloncino bloccato con acqua la dispersione è superiore del 50%. (Fig. 1)
- A differenza dell'acqua sterile, la soluzione di glicerina non si diffonde attraverso le pareti di silicone del palloncino. (Fig. 2)
- Dato l'elevato grado di diffusione dell'acqua sterile rispetto alla soluzione di glicerina, si consiglia di utilizzare sempre soluzione di glicerina al 10% per gonfiare il palloncino.

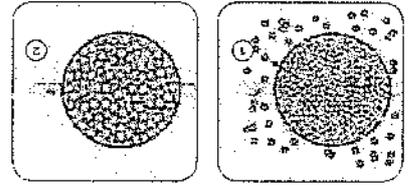

① Acqua sterile
② Soluzione di glicerina

- ### VANTAGGI DELLA SIRINGA PRE-RIEMPIA
- Minor tempo di preparazione e semplice gonfiaggio del palloncino grazie alla siringa pre-riempita
 - Elevata sicurezza per i pazienti grazie al volume di riempimento del palloncino sempre costante
 - Risparmio di tempo e di denaro data la possibilità di evitare controlli regolari e ripetuti gonfiaggi del palloncino
 - Riduzione dei rischi d'infezione grazie alla confezione singola sterile contenente il catetere e la siringa

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

41 CM I PUNTA PIENA CILINDRICA
2 FORI CONTRAPPOSTI - 2 VIE

Q.T.A.	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.	ART.	DESCRIZIONE
1*	850086-000120	901207845	12	10 ml	
1*	850086-000140	901207858	14	10 ml	
1*	850086-000160	901207860	16	10 ml	
1*	850086-000180	901207872	18	10 ml	
1*	850086-000200	901207884	20	10 ml	
1*	850086-000220	901207896	22	10 ml	
1*	850086-000240	901207908	24	10 ml	
1*	850086-000120	901620702	12	10 ml	
10	850088-000140	901620714	14	10 ml	
10	850088-000160	901620738	16	10 ml	
10	850088-000180	901620740	18	10 ml	
10	850088-000200	901620753	20	10 ml	
10	850088-000220	901620777	22	10 ml	
10	850088-000240	901620789	24	10 ml	

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

31 CM I PUNTA PIENA CILINDRICA
2 FORI CONTRAPPOSTI - 2 VIE



Q.T.A.	ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.	ART.	DESCRIZIONE
1*	850086-000100	901207833	10	5 ml	

* In confezione singola sterile contenente modo d'uso

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.03.003 - Rimborso mensile massimo 2 pezzi

VANTAGGI

- Elevata biocompatibilità
- Ridotto rischio di incrostazioni
- Ridotto rischio di infezioni
- Durata di permanenza oltre i 30 giorni (classe IIb)
- Siringa pre-riempita con 10 ml di soluzione di glicerina al 10% sterile, in confezione sterile
- Valvola per siringhe con attacco Luer e Luer-Lock
- Punta del catetere radiopaca e linea radiopaca lungo lo stelo del catetere
- Sterile
- Privo di lattice
- Monouso
- Presenza di scanalature longitudinali
- Riduzione del decubito
- Dreanggio costante delle secrezioni uretrali
- In confezione singola sterile completa di modo d'uso

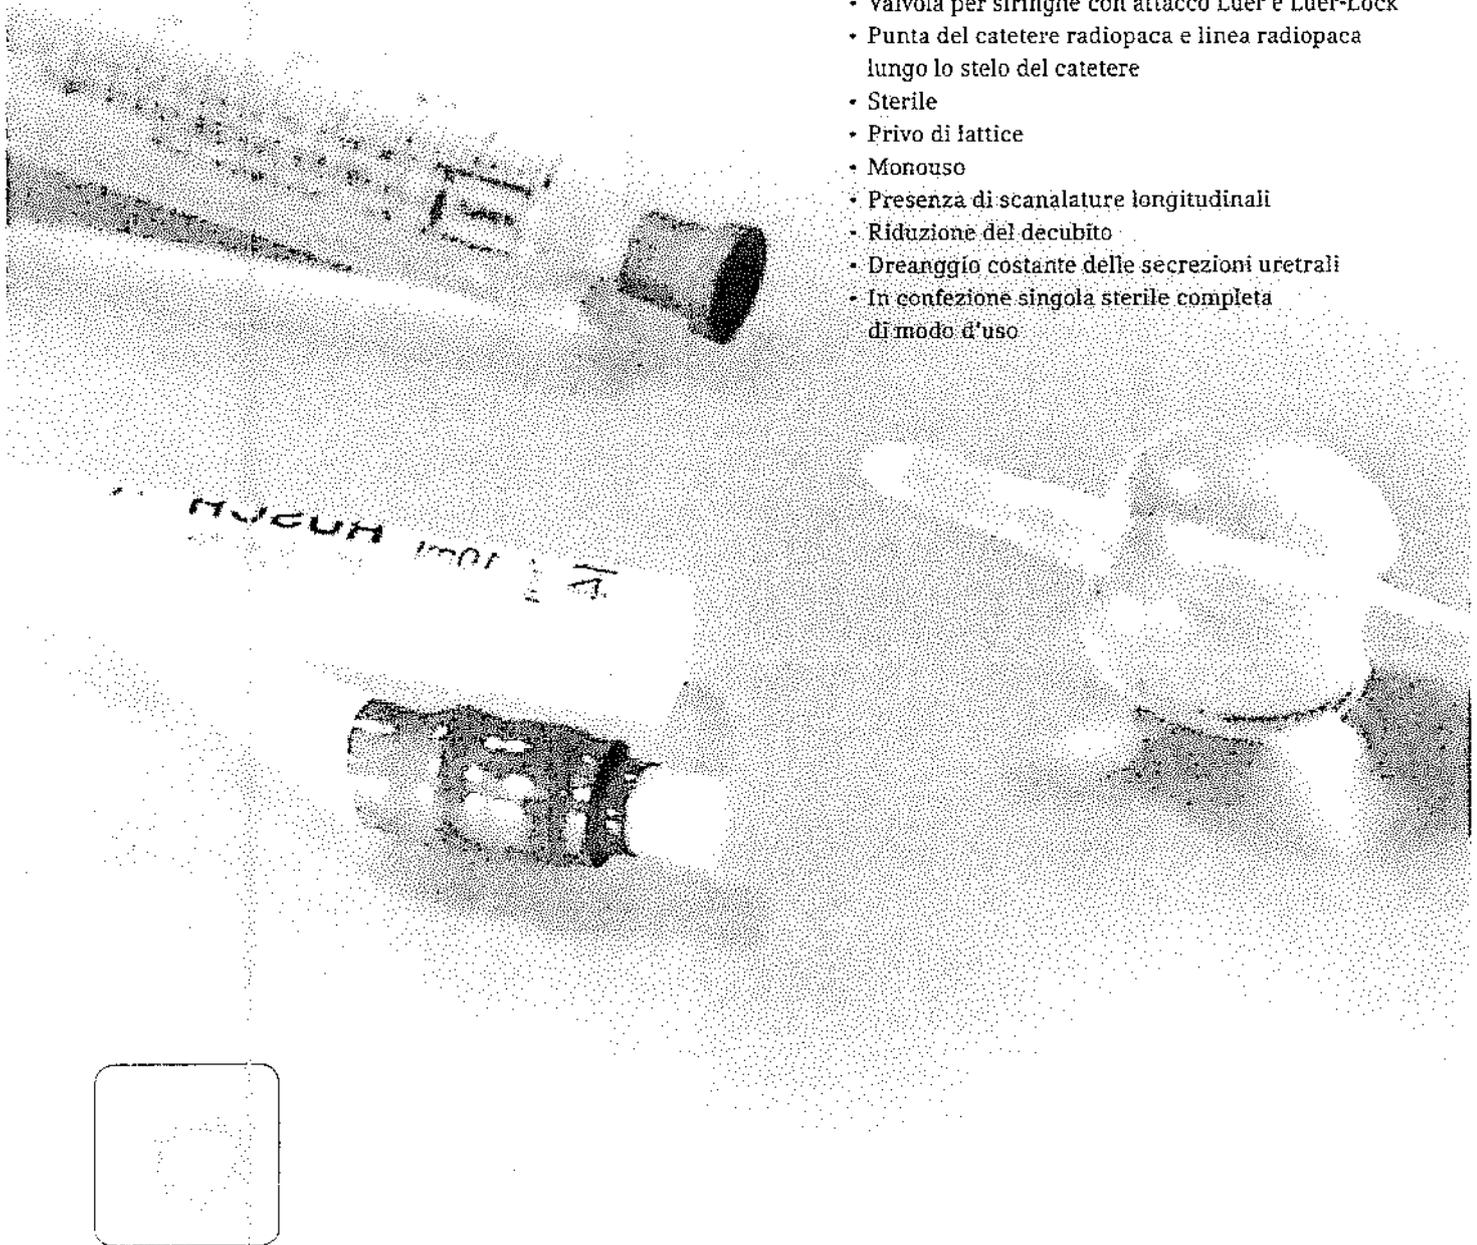

BRILLANT PLUS AQUAFATE

CATERE CON PALLONCINO IN SILICONE, TRASPARENTE
CON SIRINGA PRE-RIEMPITA PER GONFIARE IL PALLONCINO

PER ADULTI:

- Durata di permanenza di oltre trenta giorni
- Siringa pre-riempita con 10 ml di soluzione di glicerina al 10% in confezione sterile
- Valvola per siringhe con attacco Luer e Luer-Lock
- Punta del catetere radiopaca e linee radiopaca
- Lungo lo stelo del catetere
- Sterile
- Privo di lattice
- Monouso

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI BRILLANT PLUS AQUAFATE


41 CM | PUNTA PIENA CILINDRICA 2 FORI CONTRAPPOSTI - 2 VIE

12	10 ml	850081-00120	901207744	1*
14	10 ml	850081-00140	901207769	1*
16	10 ml	850081-00160	901207771	1*
18	10 ml	850081-00180	901207783	1*
20	10 ml	850081-00200	901207795	1*
22	10 ml	850081-00220	901207819	1*
24	10 ml	850081-00240	901207821	1*
12	10 ml	850085-00120	901620854	10
14	10 ml	850085-00140	901620878	10
16	10 ml	850085-00160	901620880	10
18	10 ml	850085-00180	901620928	10
20	10 ml	850085-00200	901620930	10
22	10 ml	850085-00220	901620942	10
24	10 ml	850085-00240	901620955	10

41 CM | PUNTA TIEMANN - 1 FORO - 2 VIE

12	10 ml	850084-00120	901456881	1*
14	10 ml	850084-00140	901456893	1*
16	10 ml	850084-00160	901456905	1*
18	10 ml	850084-00180	901456917	1*
20	10 ml	850084-00200	901456929	1*
22	10 ml	850084-00220	901456931	1*
24	10 ml	850084-00240	901456956	1*

* In confezione singola sterile contenente modo d'uso

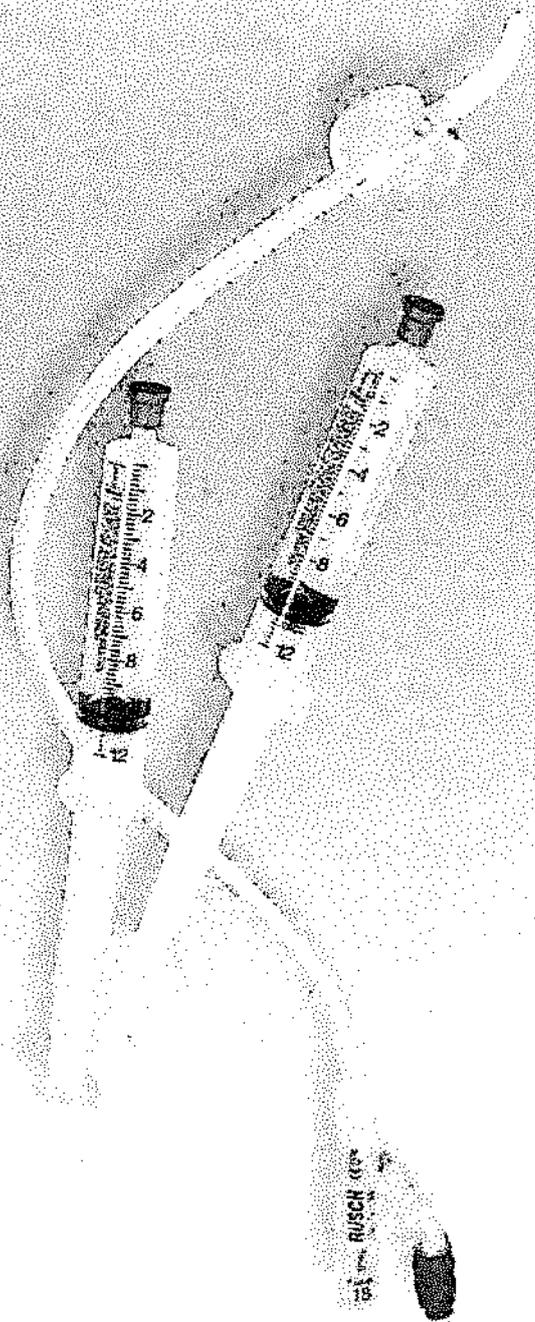

SILASIL PLUS

CATETERE CON PALLONCINO E CON RIVESTIMENTO ESTERNO E INTERNO IN ELASTOMERO DI SILICONE ED ANIMA IN LATTICE

PER ADULTI:

- Superficie esterna ed interna dei cateteri presenta uno strato di silicone ultrasottile
- Indicato per la media permanenza (al massimo 21 giorni)
- Valvola per siringhe con attacco Luer e Luer-Lock
- Sterile
- Monouso

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI SILASIL

**40 CM | PUNTA CILINDRICA 2 FORI
CONTRAPPOSTI - 2 VIE**

CM	PALLONCINO	ART.	PAPAV	VIA
12	10 ml	850241-000120	906811005	1
14	10 ml	850241-000140	906811056	1
16	10 ml	850241-000160	906811082	1
18	10 ml	850241-000180	906811094	1
20	10 ml	850241-000200	906811106	1
22	10 ml	850241-000220	906811132	1
24	10 ml	850241-000240	906811157	1




**40 CM | PUNTA CILINDRICA 2 FORI
CONTRAPPOSTI - 3 VIE**

CM	PALLONCINO	ART.	PAPAV	VIA
18	10 ml	850243-000180	907102622	1
20	10 ml	850243-000200	907102634	1
22	10 ml	850243-000220	907102646	1



In confezione singola sterile contenete modo d'uso

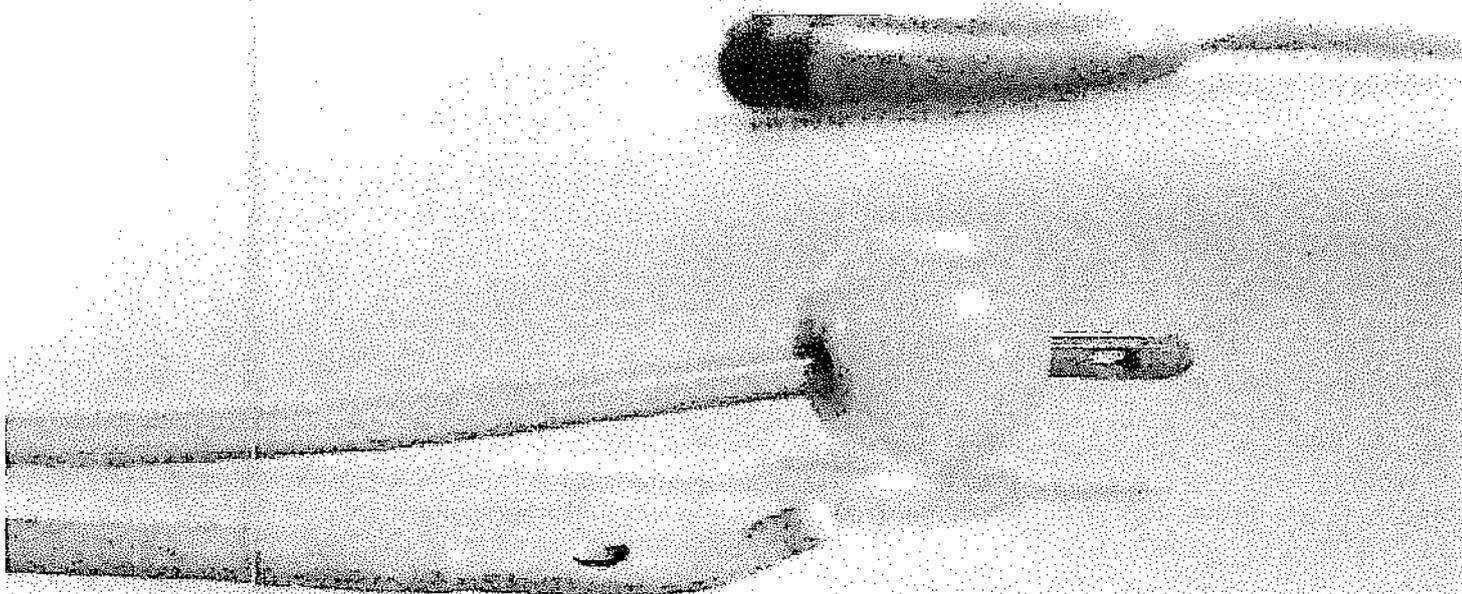

GOLD PLUS CATERE CON PALLONCINO IN LATTICE

Il materiale dei cateteri in lattice Gold Plus è costituito da una miscela di lattice naturale siliconato. Si noti che i cateteri in lattice o contenenti lattice vanno impiegati esclusivamente per il drenaggio a breve termine (al massimo

5 giorni). Non utilizzare i cateteri in lattice o contenenti lattice nei pazienti con allergia al lattice. In questi casi si raccomanda di impiegare esclusivamente cateteri con palloncino in silicone.

PER ADULTI

- Per il drenaggio urinario a breve termine (al massimo 5 giorni)
- Lattice siliconato
- Valvola per siringhe con attacco Luer e Luer-Lock
- Sterile
- Monouso

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI GOLD PLUS

40 CM | PUNTA CILINDRICA 2 FORI CONTRAPPOSTI - 2 VIE


12	5-10 ml	850002-00020	901396034	1*
14	5-10 ml	850002-00040	901396046	1*
16	5-15 ml	850002-00060	901396059	1*
18	5-15 ml	850002-00080	901396073	1*
20	5-15 ml	850002-00000	901396097	1*
22	5-15 ml	850002-00020	901396111	1*
24	5-15 ml	850002-00040	901396123	1*
12	5-10 ml	850010-00020	901621072	30
14	5-10 ml	850010-00040	901620878	30
16	5-10 ml	850010-00060	901621084	30
18	5-10 ml	850010-00080	901621096	30
20	5-10 ml	850010-00000	901621108	30
22	5-10 ml	850010-00020	901621110	30
24	5-10 ml	850010-00040	901621122	30
26	5-10 ml	850010-00060	901621134	30

40 CM | PUNTA TIEMANN 1 FORO - 2 VIE

12	5-10 ml	850004-00020	901554511	1*
14	5-10 ml	850004-00040	901554523	1*
16	5-15 ml	850004-00060	901554353	1*
18	5-15 ml	850004-00080	901554547	1*
20	5-15 ml	850004-00000	901554550	1*
22	5-15 ml	850004-00020	901554562	1*

* In confezione singola sterile contenente modo d'uso

Per i bambini si raccomanda di utilizzare soprattutto cateteri Foley in silicone, poiché il lattice può provocare irritazioni alla mucosa uretrale. Tali irritazioni possono favorire a loro volta la formazione di stenosi uretrali (marcato restringimento dell'uretra).

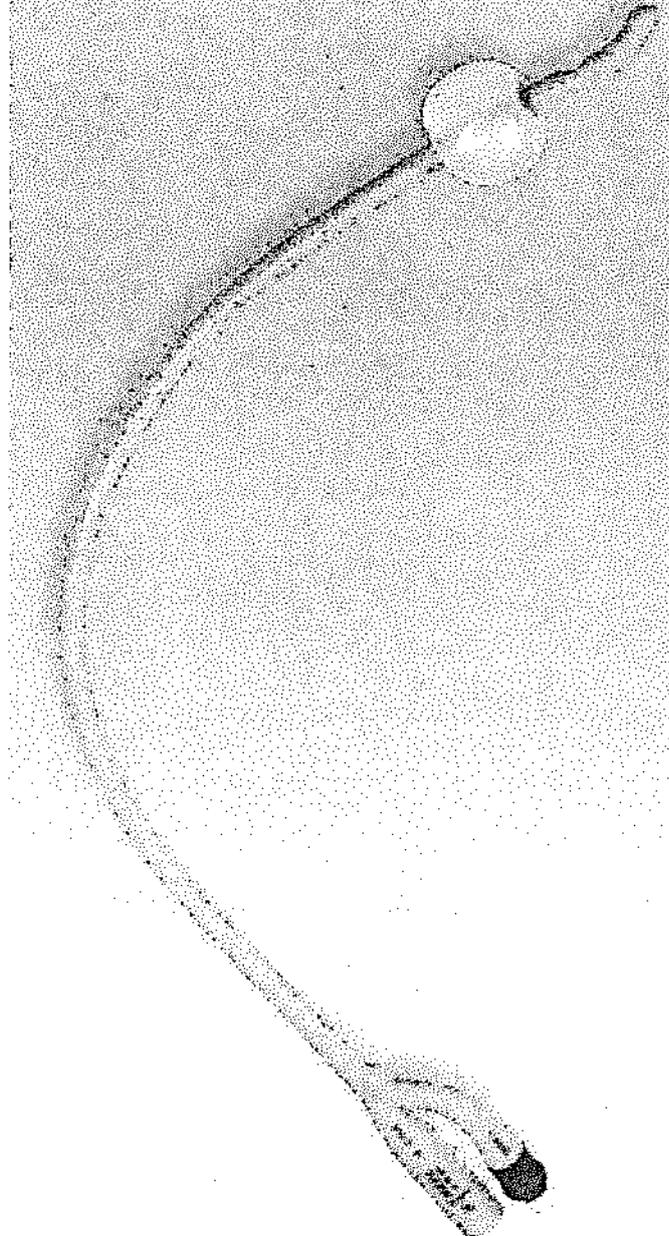

LINEA ACCESSORI

Il cateterismo vescicale a permanenza richiede una serie di prodotti accessori che aiutano il posizionamento e la gestione del catetere stesso.

E' per questo motivo che Teleflex ha sviluppato un pratico kit completo di tutto il necessario per un posizionamento del catetere vescicale a permanenza sicuro.

Il lubrificante Silkospray, in flacone sterile da 500 ml, consente la lubrificazione di tutti i cateteri non in silicone. Le valvole per catetere evitano l'uso di sacche di raccolta

delle urine durante la giornata assicurando discrezione e sicurezza e senza la necessità di essere rimosse mentre il pratico raccordo per la notte consente di mantenere il sistema in uso consentendo comunque l'impiego di una sacca di raccolta urina per la notte.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI ACCESSORI

KIT PER CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
MET850450	900022587	1

SILKOSPRAY | 500 ML

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
850699	908997707	1

TAPPO PER CATETEREE

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
850731-000000	908912482	1

VALVOLE PER CATETERE

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
R051KV 100	902411053	1

VALVOLA PER CATETERE UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
R051KV 100 EH	902411089	1


VALVOLA PER CATETERE UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO E RACCORDO CON SACCA DA LETTO

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
R051KV 200 EH	902411115	1

CONNETTORE PER VALVOLA ALLA SACCA DA LETTO

ART.	DESCRIZIONE	Q.T.A.
R051KP 200	907102786	1

Silkospray - Rif. Cod. Min. ISC 09.21.18.006 - Rimborso mensile massimo
1 pezzo

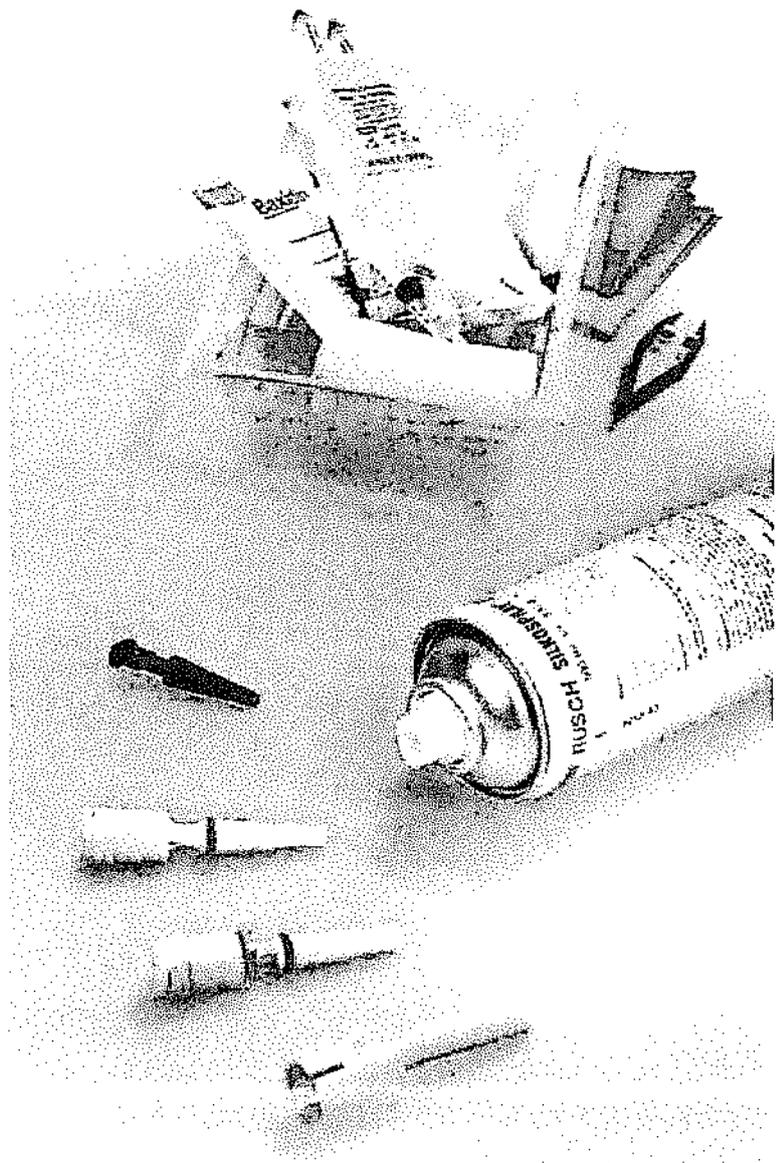

URETERO-CUTANEOSTOMIA

I cateteri/tutori sono realizzati in puro silicone o poliuretano. Questi materiali sono estremamente flessibili e ben tollerati dall'organismo grazie alla loro elevata biocompatibilità. Le superfici di entrata e materiali sono particolarmente lisce e presentano pertanto una ridotta tendenza all'incrostazione. Il silicone e il poliuretano si distinguono inoltre per la lunga durata di permanenza. La trasparenza del materiale impiegata su tutti i cateteri/tutori facilita la decisione di sostituzione.

I cateteri/tutori per ureterocutaneostomia possiedono una punta dolcemente arrotondata con apertura centrale per prevenire le irritazioni dello stomaco. Numerosi fori distribuiti sullo stelo del catetere/tutore garantiscono il drenaggio ottimale. Due piccole alette d'arresto poste sullo stelo (non presenti nell'art. n° 850281) evitano l'involontaria fuoriuscita del catetere/tutore dallo stomaco. Ogni catetere per ureterocutaneostomia è inoltre dotato di un piccolo disco di protezione, che protegge lo stomaco da contaminazione involontaria di urina ed è utilizzato per fissare il catetere.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI CATERI /
TUTORI PER URETEROCUTANEOSTOMIA

25 CM WIRUTHAN CON ALETTE	
3,5 mm	850270-000035 919487340
4,2 mm	850270-000042 919487365
INVERTITO	
30 CM WIRUTHAN CON ALETTE	
3,5 mm	850271-000035 919487353
4,2 mm	850271-000042 919487377
INVERTITO	
25 CM SILICONE CON ALETTE	
3,5 mm	850275-000035 912881782
4,2 mm	850275-000042 912881857
INVERTITO	
30 CM SILICONE CON ALETTE	
3,5 mm	850276-000035 912881869
4,2 mm	850276-000042 912881883
INVERTITO	
40 CM WIRUTHAN SENZA ALETTE	
8	850281-000080 916089139
10	850281-000100 916089141
12	850281-000120 916089154
14	850281-000140 916089166
16	850281-000160 916089178

Rif. Cod. Min. ISO 09.24.06.018 - Rimborso mensile massimo 2 pezzi

CATETERI/TUTORI PER URETEROCUTANEOSTOMIA


COMODITÀ E SICUREZZA

ART. 850270 | 850271 | 850275 | 850276:

- Catetere in poliuretano o silicone con punta ad apertura centrale
- Fori distribuiti a spirale lungo tutto lo stelo del catetere
- Graduazione in cm (art. 850275 e 850276)
- Linea radiopaca lungo lo stelo del catetere
- 2 piccole alette d'arresto
- Disco di protezione saldamente collegato allo stelo

ART. 850281:

- Catetere in poliuretano con punta ad apertura centrale
- 6 fori disposti a spirale
- Graduazione in cm
- Linea radiopaca lungo lo stelo del catetere
- Disco di protezione mobile
- Imbuto in PVC

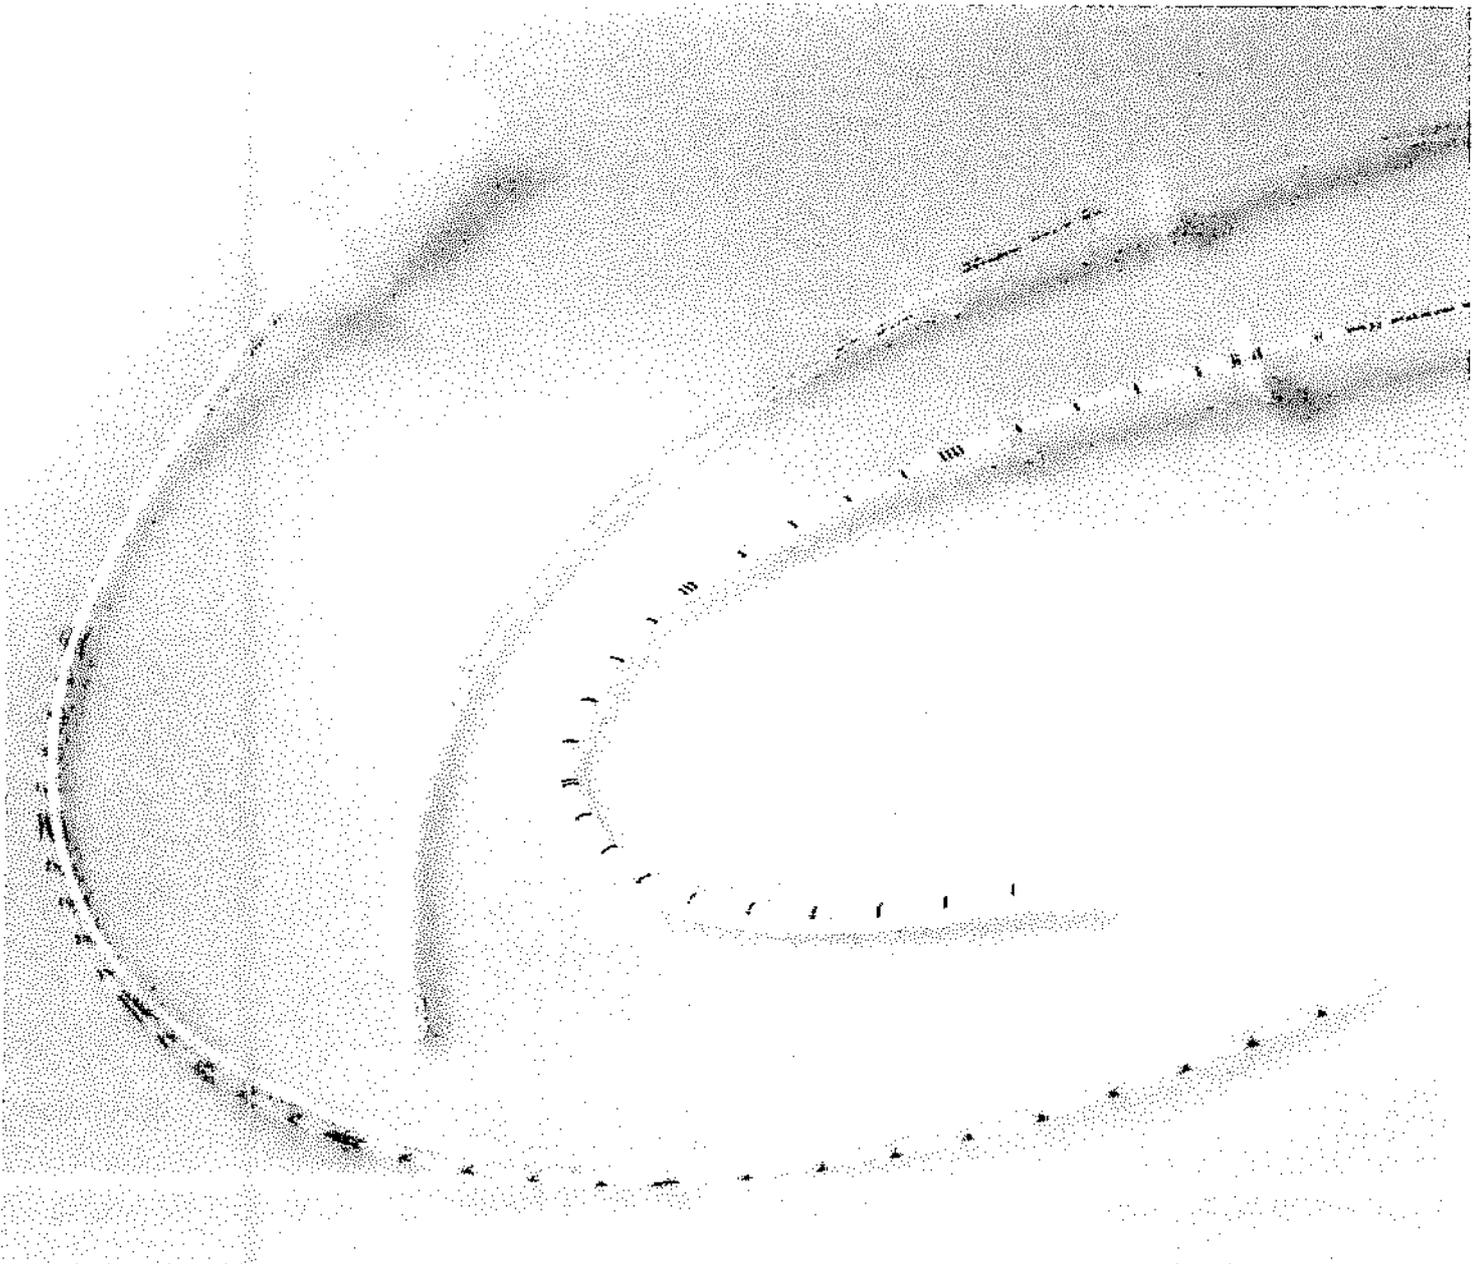


TELEFLEX SISTEMI DI DRENAGGIO URINARIO

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

Il miglioramento della qualità di vita dei pazienti sta al centro del nostro nell'impiego di sistemi di drenaggio urinario. Ogni paziente ha requisiti ed esigenze individuali. Noi offriamo soluzioni altrettanto versatili.

I sistemi di drenaggio urinario a circuito chiuso sono indicati, ad esempio, nei casi in cui l'urina viene drenata per un periodo di tempo prolungato con l'ausilio di un catetere vescicale a permanenza. Soprattutto durante il drenaggio urinario a lungo termine è importante contenere il più possibile il rischio di infezioni alle vie urinarie. Un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso rappresenta la migliore opzione di prevenzione. I nostri prodotti soddisfanno tutte le caratteristiche richieste da un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso per l'assistenza medica a lungo termine.

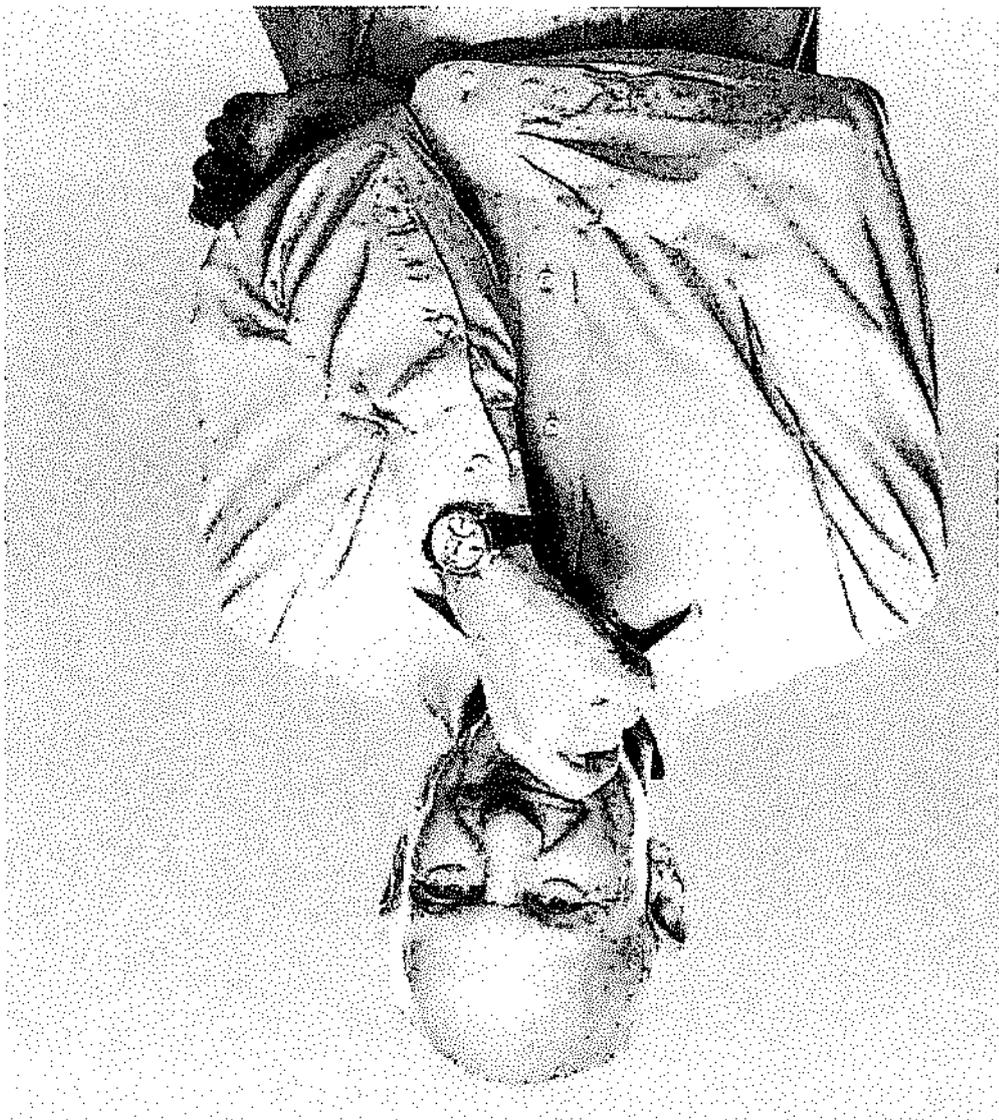


ATTENZIONE:

Si raccomanda di associare i sistemi di drenaggio urinario non sterili esclusivamente a sistemi per il deflusso dell'urina non sterili (ad es. guaine per incontinenza).

I pazienti che fanno uso di sistemi di drenaggio urinario possono contare su discrezione, comfort, sicurezza, ma anche igiene e facilità d'uso elevati al massimo, perfino nel caso in cui abbiano una limitata funzionalità della mano e delle dita.

La nostra offerta include sacche di raccolta urina di alta qualità e facili da utilizzare per il giorno e la notte. Ne sono un esempio le nostre sacche da gamba a tre camere, che sono discrete sotto gli abiti e che si riempiono in modo silenzioso. Il lato gamba della sacca rivestito in tessuto non tessuto delicato sulla pelle garantisce un comfort ancora superiore e contribuisce a prevenire irritazioni cutanee, anche in caso di utilizzo prolungato. Ancora più discreta è la nostra Belly Bag, un sistema di raccolta urina che può essere indossato sotto gli abiti come una sorta di marsupio.


Molti dei nostri sistemi di drenaggio urinario dispongono di un punto per il prelievo di campioni di urina senza ago sul raccordo universale antisfilamento. Tutti i nostri sistemi di drenaggio urinario sono completamente privi di lattice, quindi possono essere utilizzati anche da pazienti con allergia a questo materiale.



RACCORDO UNIVERSALE ANTISFILAMENTO CON PUNTO PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI URINA SENZA AGO

Contribuisce ad evitare lesioni da puntura di ago e a ridurre il rischio di infezioni. Per il prelievo di un campione di urina si raccomanda di disinfettare il punto per il prelievo di campioni e di inserire l'attacco di una siringa Luer senza ago con una leggera rotazione al centro del tappo in gomma del punto per il prelievo. Tutti i sistemi di drenaggio urinario con punto per il prelievo di campioni di urina senza ago dispongono di un raccordo universale antisfilamento appositamente progettato con cappuccio protettivo. Il raccordo è rastremato in direzione opposta alla direzione di estrazione del catetere per evitare lo sfilamento dall'imbuto del catetere.

VALVOLE DI SCARICO




Una sola mano




Flip Flow



Push-Pull



T-Tap



Twist-Turn

S-BAG

SISTEMA PER IL DRENAGGIO URINARIO STANDARD A CIRCUITO CHIUSO CON LUNGA DURATA DI PERMANENZA

Molte infezioni delle vie urinarie sono causate da drenaggio urinario inappropriato. Ci siamo quindi posti l'obiettivo di offrire ai pazienti una serie di prodotti in grado di contribuire a ridurre il rischio di infezioni durante il drenaggio urinario.

Il sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso è quindi una delle più importanti opportunità di profilassi contro le infezioni delle vie urinarie. La nostra S-Bag soddisfa tutti i requisiti di igiene richiesti ad un sistema di drenaggio urinario a circuito chiuso di alta qualità.

CAPACITÀ 2000 ML STERILE,
DISPOSITIVO DI SCARICO T-TAP E ATTACCO PER IL
PRELIEVO DI CAMPIONE
REF. S-BAG 2000
120 cm 850414-000000 921188532 1
Rif. Cod. Min ISO 09.27.07.006 - Rimborso mensile massimo 8 pezzi



- ① **SISTEMA DI DRENAGGIO DELL'URINA / CIRCUITO CHIUSO, 2000 ML RACCORDO UNIVERSALE ANTISIFILAMENTO**
punto di connessione tra catetere e sacca
- ② **PUNTO DI PRELIEVO URINARIO SENZA USO DI AGO**
evita le lesioni provocate dalla puntura dell'ago
- ③ **TUBO FLESSIBILE E RESISTENTE ALL'INGINOCCHIAMENTO, LUNGO 120 CM**
con morsetto scorrevole e clip per lenzuolo
- ④ **GANCIO DOPPIO RESISTENTE CON CORDINO SUPPLEMENTARE**
per assicurare un fissaggio sicuro del sistema di drenaggio urinario al letto
- ⑤ **GOCCIOLATOIO CON FILTRO DI AERAZIONE E VALVOLA DI NON RITORNO INTEGRATA**
evita il reflusso di urina e la risalita della batteriuria
- ⑥ **ULTERIORE FILTRO DI AERAZIONE ANTIBATTERICO E A TENUTA DI LIQUIDO SULLA SACCA**
per un equilibrio ottimale della pressione con un deflusso sicuro
- ⑦ **GRADUAZIONE CHIARA IN ML**
per lo svuotamento rapido e igienico della sacca
- ⑧ **SITO DI ALL'OGGIAMENTO PER IL F-SSAGGIO DEL TUBO DI SCARICO**
per prevenire la contaminazione e annidare ulteriormente la distanza dal pavimento



SACCHE DA LETTO

SICUREZZA E COMFORT ANCHE DURANTE LA NOTTE

- SACCA DA LETTO DA 2000ML
CON DISPOSITIVO DI SCARICO**
- Raccordo universale antiriflusso con punto per il prelievo di campioni di urina senza ago e cappuccio protettivo
 - Tubo flessibile e resistente al kinking
 - Valvola di non ritorno
 - Graduatoria chiara in ml
 - Dispositivo di scarico T-Tap
 - Senza gancio di fissaggio
 - Priva di lattice, sterile, monouso

**CAPACITÀ 2000ML STERILE,
DISPOSITIVO DI SCARICO T-TAP E PUNTO PER IL
PRELIEVO DI CAMPIONE**

100 cm	850412-000000	900454531	75
120 cm	850419-000000	921188532	1

Rif. Cod. Min ISO 09.27.07.006 - Rimborso mensile massimo 6 pezzi

SACCA DA LETTO DA 2000ML

SENZA DISPOSITIVO DI SCARICO

- Raccordo con cappuccio protettivo
- Tubo flessibile e resistente al kinking
- Valvola di non ritorno solo nelle sacche codice 850417 e codice 850346
- Graduatoria chiara in ml
- Senza valvola di scarico
- Con 1 gancio di fissaggio / confezione
- Priva di lattice, non sterile, monouso

**CAPACITÀ 2000ML
NON STERILE, SENZA VALVOLA DI SCARICO**

90 cm	850417-000000	901673525	30
90 cm	850416-000000	901673549	30
90 cm	850400-000000	907103004	250
130 cm	850346-000000	902496571	30
130 cm	850402-000000	907103129	200
130 cm	850415-000000	902020231	30

Rif. Cod. Min ISO 09.27.07.003 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi



SUPPORTO

90 cm	850445-000000	907103257	10
-------	---------------	-----------	----

SACCA DA LETTO DA 2000ML

CON DISPOSITIVO DI SCARICO

- Raccordo con cappuccio protettivo
- Tubo flessibile e resistente al kinking
- Valvola di non ritorno
- Graduatoria chiara in ml
- Dispositivo di scarico T-Tap
- Senza gancio di fissaggio
- Priva di lattice, sterile, monouso

**CAPACITÀ 2000 ML STERILE,
DISPOSITIVO DI SCARICO T-TAP**

90 cm	850407-000000	901204990	75
130 cm	850418-000000	907103220	75

Rif. Cod. Min ISO 09.27.07.003 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi

SACCA DA LETTO DA 2000ML



CON DISPOSITIVO DI SCARICO

- Raccordo con cappuccio protettivo
- Tubo flessibile e resistente al kinking con morsetto
- Valvola di non ritorno
- Graduatoria chiara in ml
- Dispositivo di scarico T-Tap
- Con 1 gancio di fissaggio / confezione
- Priva di lattice, non sterile, monouso

**CAPACITÀ 2000ML
NON STERILE, DISPOSITIVO DI SCARICO T-TAP**

90 cm	850401-000000	902020116	30
90 cm	850408-000000	901204949	200
130 cm	850410-000000	907103206	150

Rif. Cod. Min ISO 09.27.07.003 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi

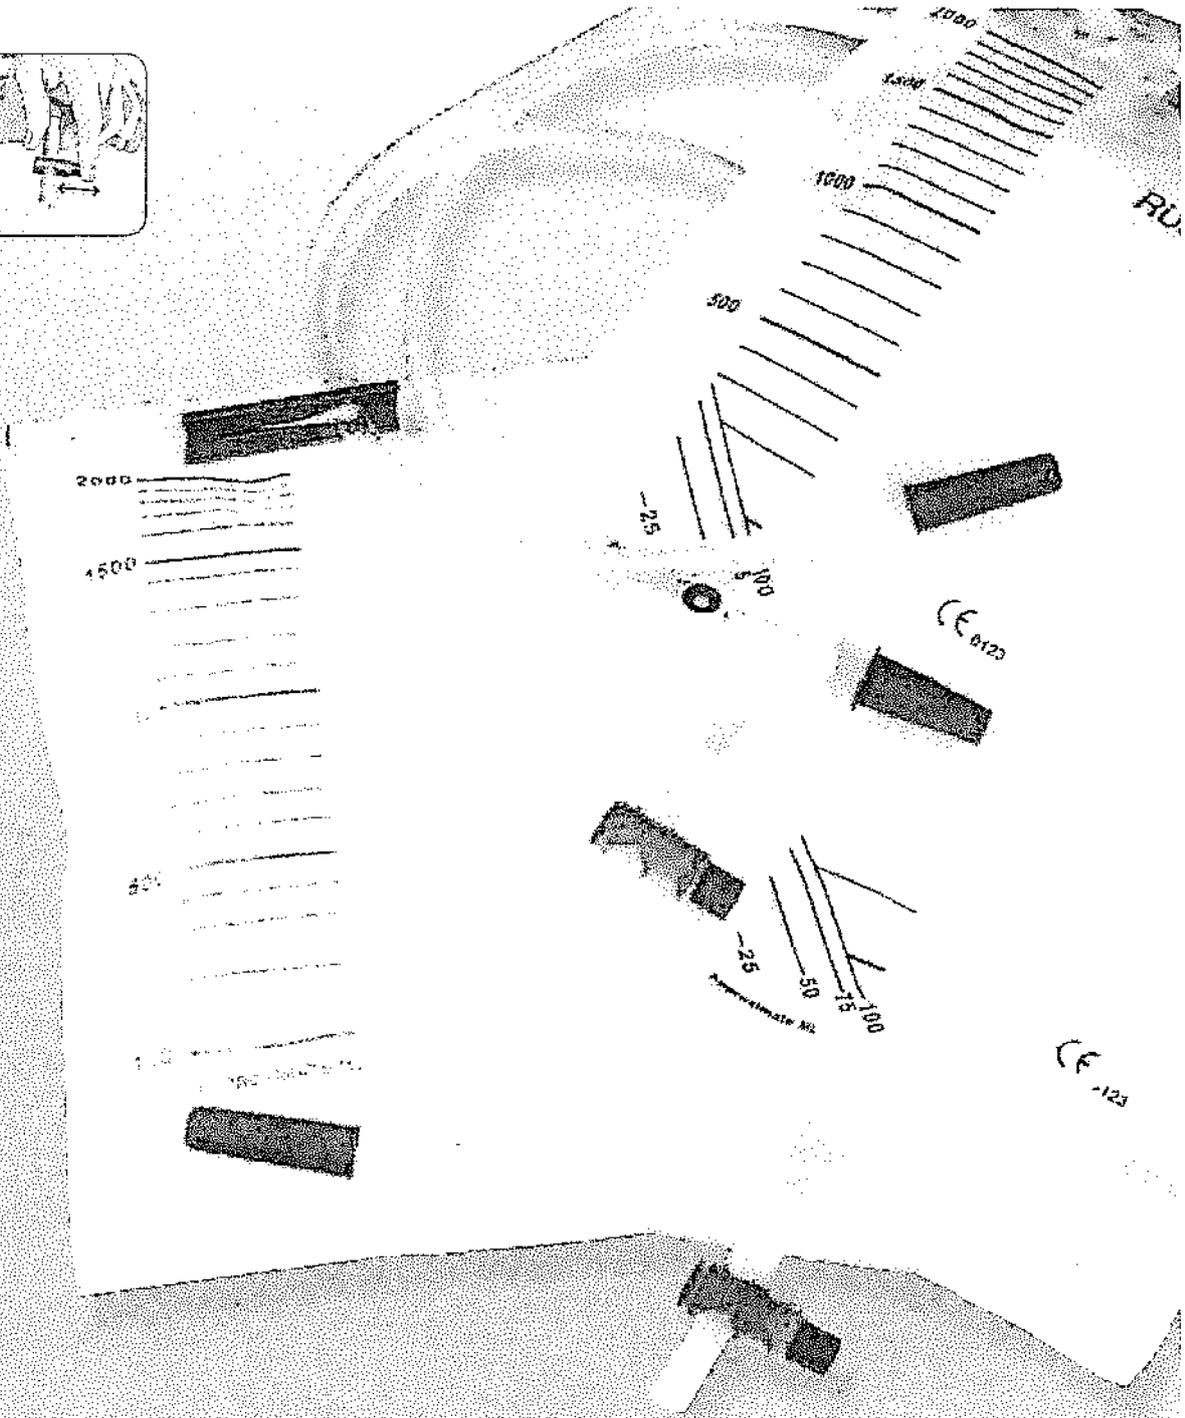

SACCHE DA GAMBIA A TRE CAMERE DISCREZIONE, COMFORT, SICUREZZA E IGIENE

DISPOSITIVO DI SCARICO FLIP FLOW
con tubo racc. ortodiale ad altre sacche urina


RIVESTIMENTO N. TESSUTO NON TESSUTO
DELICATO SULLA PELLE
sul lato gamba della sacca

GRADUAZIONE CHIARA (ML)

RACCORDO UNIVERSALE
ANTISIFILAMENTO
*con cui pacco protettivo e punto per il
prelievo di campioni di urina senza ago
int. 88054 con raccordo standard in
confezione separata (con cappuccio protettivo)*

TUBO FLESSIBILE E RESISTENTE
ALL'INGIACCHIAMENTO

VALVOLE DI NON RITORNO

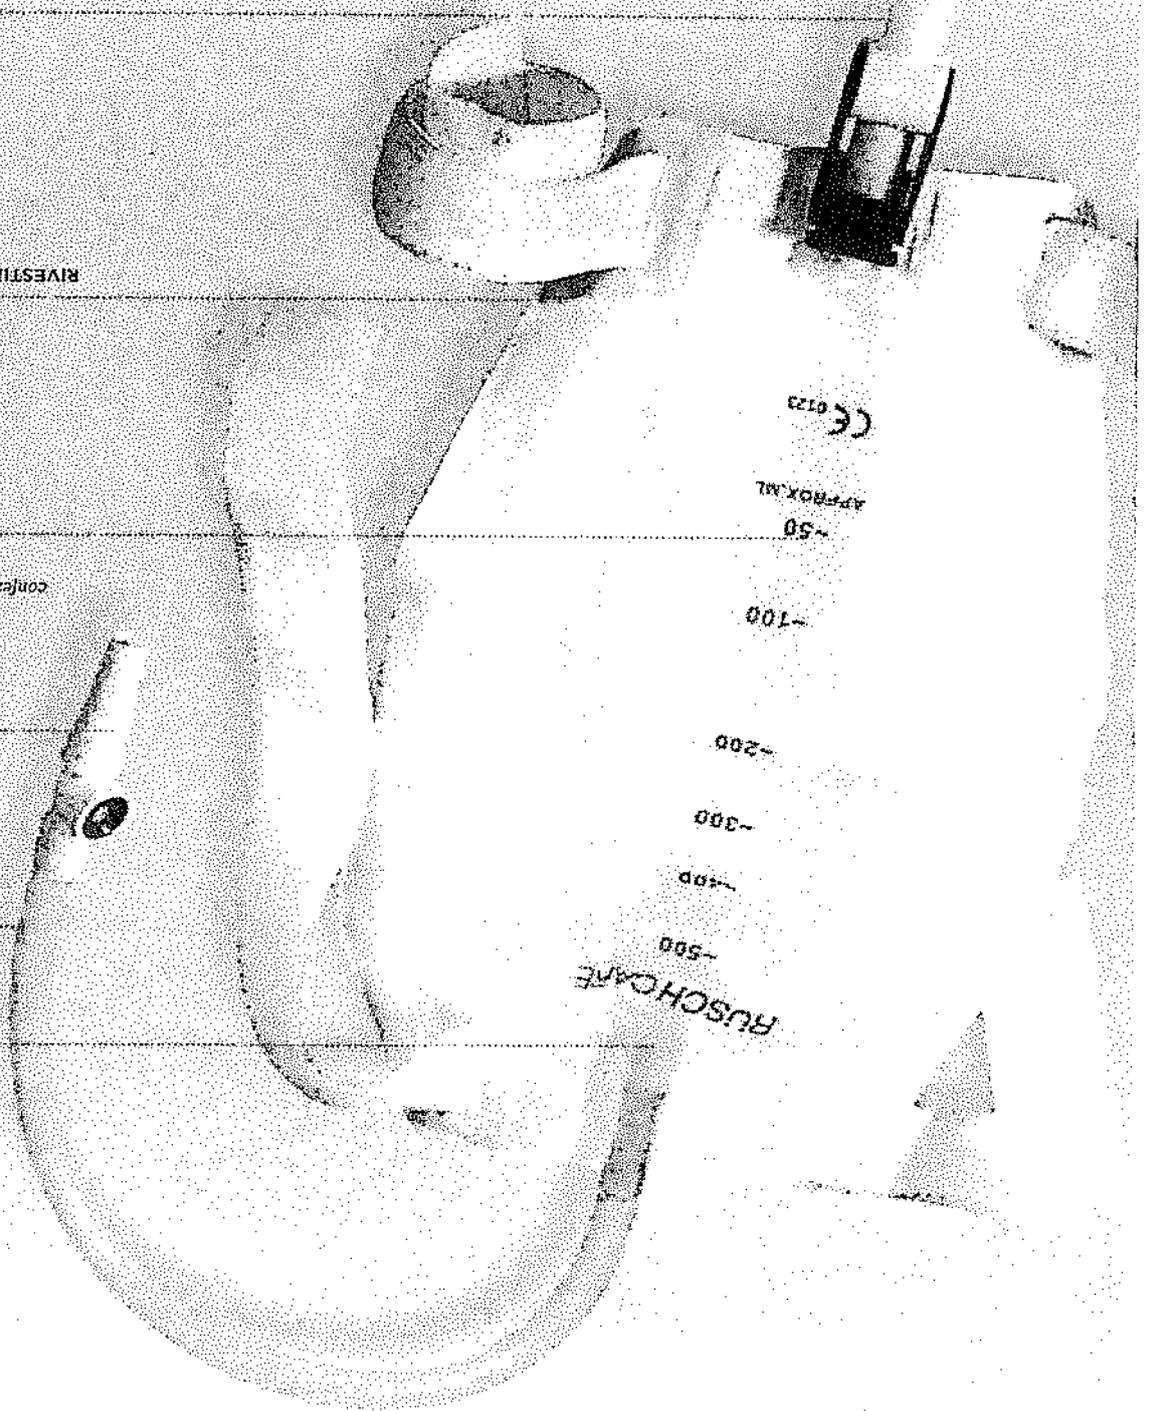

DISCRETA E CONFORTEVOLE

- Discreta sotto gli abiti
- Si adatta alla gamba in modo ottimale ed è piacevole da indossare grazie al rivestimento in tessuto non tessuto.
- Si riempie in modo silenzioso
- Il dispositivo di scarico è azionabile con una sola mano, anche in presenza di limitata funzionalità della mano
- Igienica
- 2 nastri di fissaggio in velcro con rivestimento in silicone/confezione
- Tubo ritagliabile e personalizzabile (solo art. 850354)
- Priva di lattice
- Sterile (art. 850350 e 850351) e non sterile (art. 850352 e 850354)
- Monouso

**DISPOSITIVO DI SCARICO FLIP FLOW**

Il dispositivo di scarico è straordinariamente sicuro e facile da utilizzare. È sufficiente una mano per aprirlo e chiuderlo. All'estremità della valvola si trova un breve tubo di prolunga, che consente di raccogliere senza problemi altre sacche urina.

**NASTRI DI FISSAGGIO IN VELCRO**

Ogni confezione contiene due nastri di fissaggio in velcro rivestiti in silicone, che consentono di fissare in modo sicuro la sacca urina.

La nostra sacca da gamba a tre camere offre il massimo comfort grazie alla sua suddivisione in tre camere fra loro collegate. Grazie al suo design, la sacca si riempie in modo uniforme e soprattutto silenzioso e, inoltre, non ingrossa sotto gli abiti. Il lato gamba della sacca è rivestito con un tessuto non tessuto delicato sulla pelle che, in caso di utilizzo prolungato, protegge la pelle dalle irritazioni. La disponibilità di diverse lunghezze del tubo consente al paziente di scegliere se applicare la sacca alla coscia o alla parte bassa della gamba.

Ogni confezione contiene inoltre due nastri di fissaggio in velcro con rivestimento in silicone che consentono di fissare in modo sicuro la sacca urina.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELLA SACCA DA GAMBA A TRE CAMERE**CAPACITÀ 500 ML, STERILE**

LUNGHEZZA TUBO	ART.	PACCH.	Q.TA
10 cm	850351-000000	912316736	8
30 cm	850350-000000	912316724	8

CAPACITÀ 500 ML, NON STERILE

LUNGHEZZA TUBO	ART.	PACCH.	Q.TA
45 cm	850352-000000	912316712	8
45 cm*	850354-000000	920960376	8

* tubo ritagliabile

Rif. Cod. Min. ISO 09.27.04.006 - Rimborso mensile massimo 8 pezzi

PER SACCA DI RACCOLTA URINA DA GAMBA

ART.	PACCH.	Q.TA
850360-420025	912586219	1



SACCHE DA GAMBIA

MOBILITÀ E SICUREZZA PER L'INTERA GIORNATA

SACCA DA GAMBIA DA 750 ML

CON DISPOSITIVO DI SCARICO

- Raccordo universale antistitamento con punto per il prelievo di campioni di urina senza ago e cappuccio protettivo

- Tubo flessibile e resistente al kinking
- Valvola di non ritorno
- Graduazione chiara in ml
- Rivestimento in tessuto non tessuto delicato sulla pelle

- sul lato gamba della sacca
- Dispositivo di scarico Flip Flow

- con tubo di prolunga per altre sacche urina
- 2 nastri di fissaggio in velcro

- con rivestimento in silicone / confezione

- Privata di lattice
- Sterile, monouso

750 ML STERILE, DISPOSITIVO DI SCARICO FLIP FLOW CON PUNTO PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI

10 cm	850339-000000	901204786	10
30 cm	850341-000000	901204836	10

Rif. Cod. Min. ISO 09.27.04.006 - Rimborso mensile massimo 8 pezzi

CAPACITÀ 750 ML NON STERILE, DISPOSITIVO DI SCARICO PUSH-PULL

10 cm	850342-000000	902020128	30
30 cm	850343-000000	902020167	30

Rif. Cod. Min. ISO 09.27.04.008 - Rimborso mensile massimo 30 pezzi

10 cm	850330-000000	91204255	10
30 cm	850331-000000	92020078	30
10 cm	850332-000000	91204382	10
30 cm	850333-000000	902020092	30


Rif. Cod. Min. ISO 09.27.04.003 - Rimborso mensile massimo 20 pezzi



INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI NASTRI DI FISSAGGIO IN VELCRO (LA CONFEZIONE CONTIENE 2 PEZZI)

PER SACCA DI RACCOLTA URINA DA GAMBIA

ART.	550360-420025	1
ART.	9125862719	1



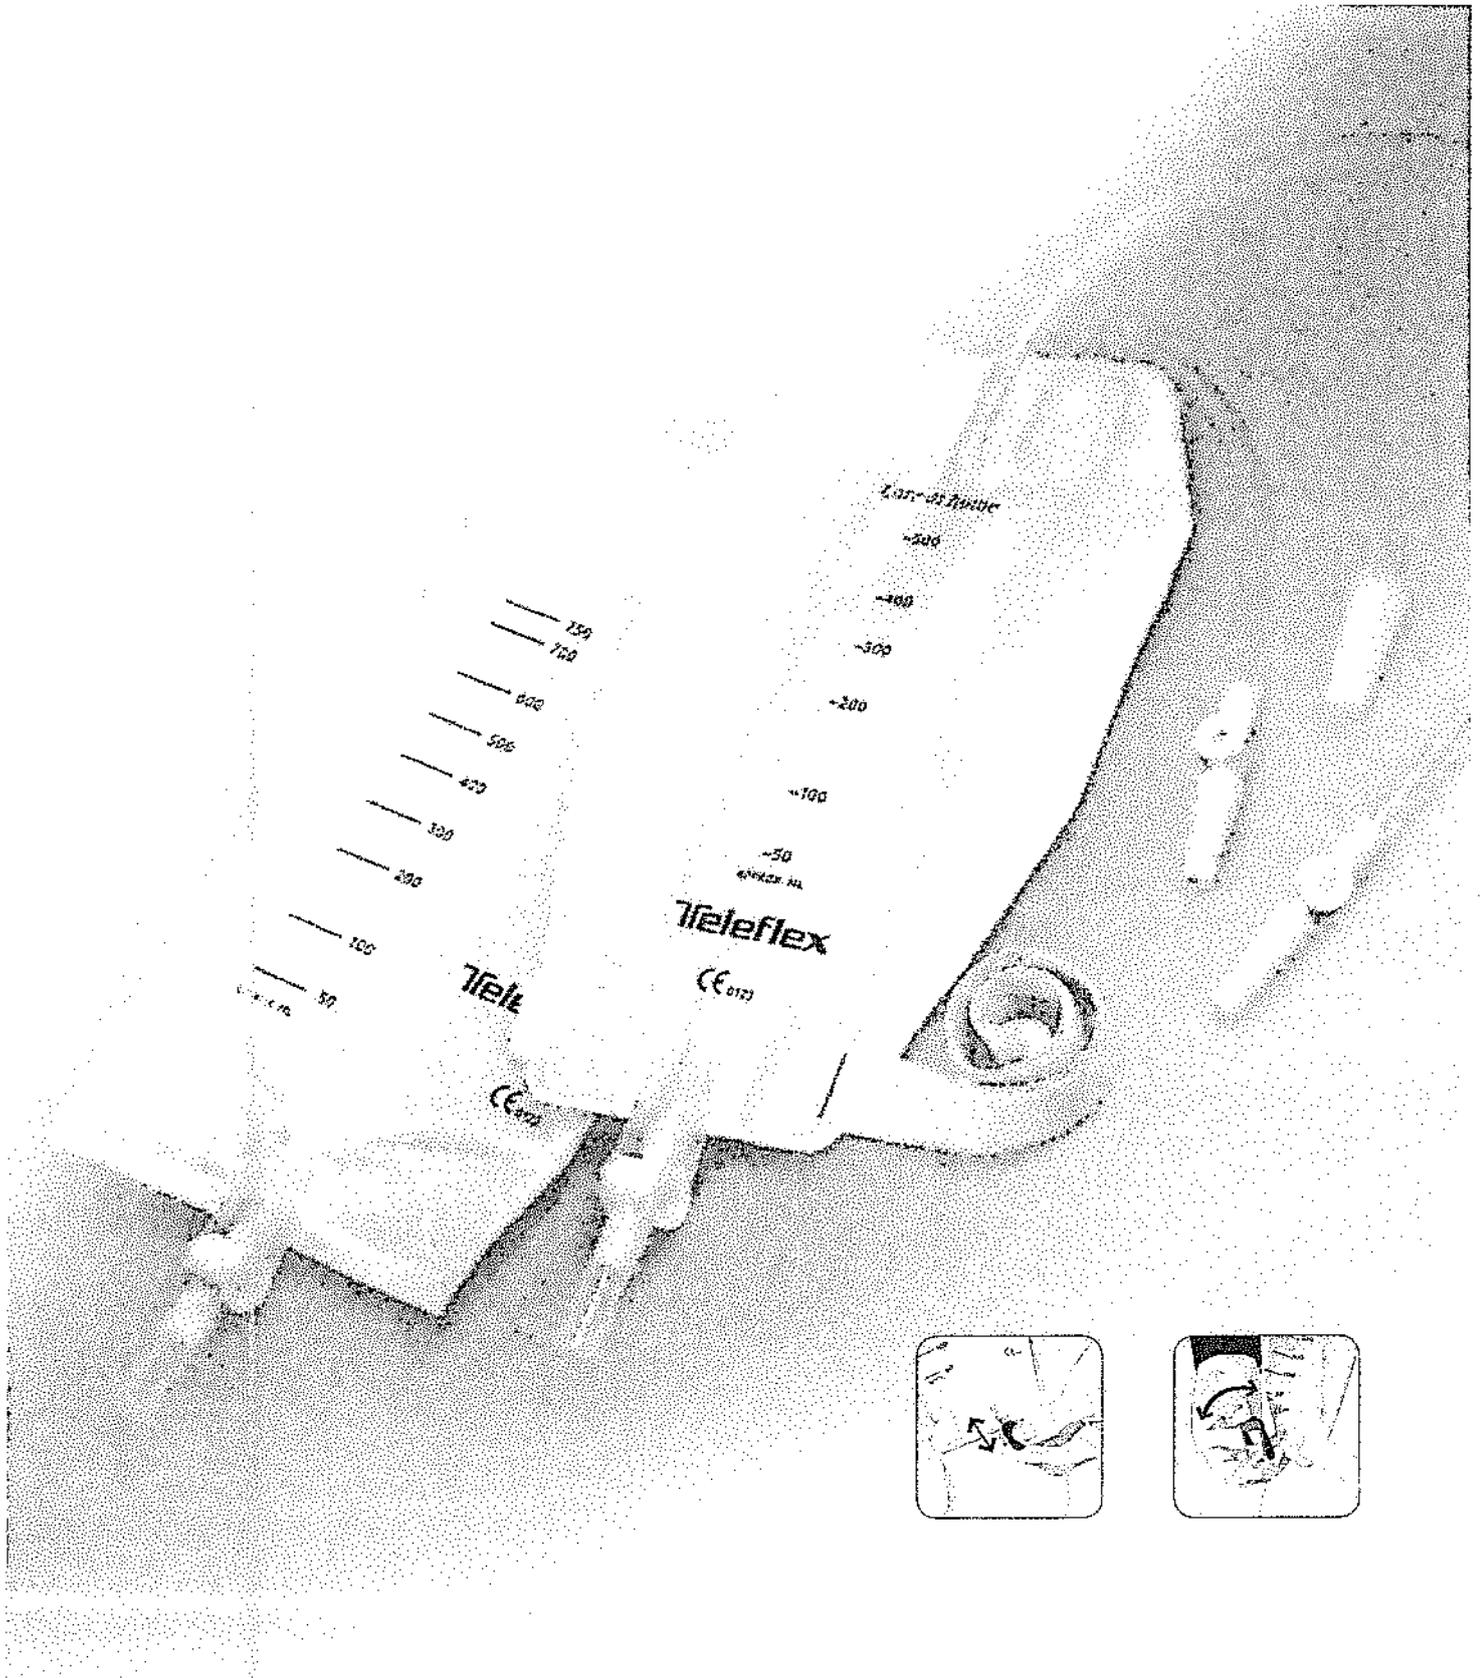

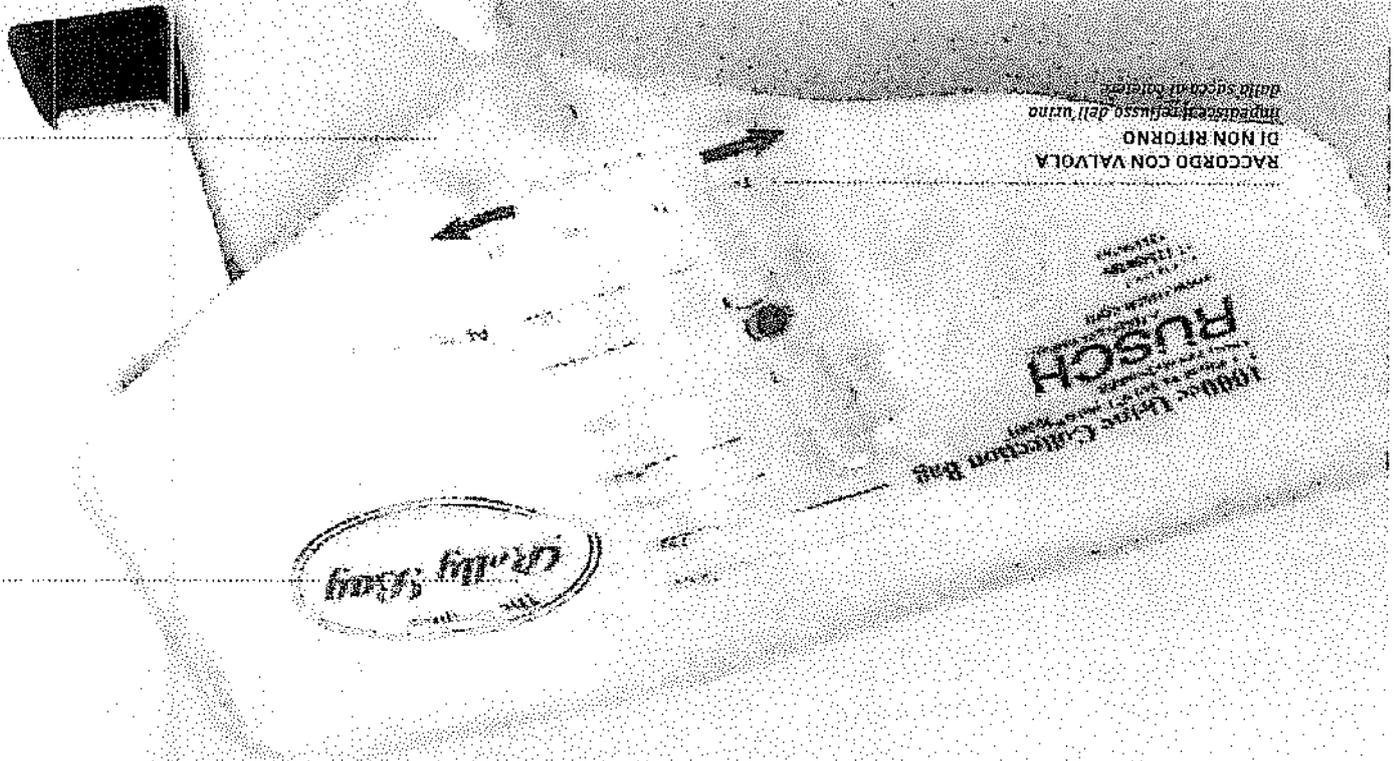

BELLY BAG

LIBERTÀ DI MOVIMENTO, INDIPENDENZA E QUALITÀ DI VITA ANCORA SUPERIORI

Belly Bag è la sacca per la raccolta urina ideale per i pazienti che desiderano condurre una vita attiva e indipendente. È la prima sacca urina che può essere indossata sotto gli abiti in modo confortevole, proprio come un marsupio. Consente quindi un deflusso dell'urina assolutamente discreto sia per uomini che per donne. Una cintura in morbido tessuto, che si allaccia velocemente intorno alla vita, assicura un'ottima tenuta. Grazie alla sua capacità di 1000 ml, la sacca Belly Bag non necessita di frequenti svuotamenti come le tradizionali

sacche di raccolta urina per pazienti mobili, quindi offre maggiore libertà e indipendenza a casa, al lavoro, nel tempo libero e in viaggio.

Grazie alla notevole capacità di Belly Bag, durante la notte non è necessaria una sacca urina supplementare. La sacca Belly Bag può essere indossata fino a 28 giorni. La durata di utilizzo dipende tuttavia dalle urine del paziente e deve essere definita con il medico curante o il competente personale di cura.

COMFORT E MOBILITÀ

- Estrema discrezione e comfort d'uso
- Estesi intervalli di svuotamento
- Sicurezza anche durante la notte
- Priva di lattice
- Sterile, monouso

**RETEO DELLA SACCA MORBIDO E DELICATO
SULLA PELLE**
impedisce irritazioni cutanee e assicura un comfort elevato

CINTURA IN MORBIDO TESSUTO CON CHIUSURA RAPIDA
garantisce un'ottima tenuta sotto gli abiti

**FASCIA DI FISSAGGIO PER
LA VALVOLA DI DRENAGGIO**
per la massima discrezione

CAPACITÀ DI 1000 ML
riduce la frequenza di svuotamento

**DISPOSITIVO DI SCARICO ANTIGOCCIOLAMENTO CON
CHIUSURA GIREVOLE**
permette lo svuotamento rapido e pratico della sacca



L'urina passa in modo sicuro attraverso il catetere dalla vescica nella sacca grazie alla pressione impressa dai muscoli vescicali. La normale pressione residua della vescica varia fra 10 e 25 cm H₂O. Per il passaggio dell'urina dalla vescica alla sacca è sufficiente una pressione di soli 6 cm H₂O. La sacca Belly Bag può essere quindi indossata senza problemi da pazienti con

catetere vescicale a permanenza transuretrale e buona funzionalità dei muscoli vescicali. Non deve tuttavia essere utilizzata con cateteri sovrapubici o cateteri nefrostomici o cateteri esterni.

Per svuotare la sacca Belly Bag è sufficiente aprire il dispositivo di scarico e poi richiuderlo. Essa si chiude a tenuta, quindi impedisce assolutamente all'urina di fuoriuscire. Dopo aver svuotato la sacca, il dispositivo di scarico può essere riposto nell'apposito passante.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI BELLY BAG

CAPACITÀ 1000 ML		
ART.	PARTE	QTA.
B1000	900288655	1

CON ATTACCO PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI URINA CAPACITÀ 1000 ML		
ART.	PARTE	QTA.
B1000P	903183325	1

CON TUBO DI SCARICO DI 60 CM CAPACITÀ 1000 ML		
ART.	PARTE	QTA.
B1000CT	903183275	1

CINTURA DI RICAMBIO PER SACCA BELLY BAG		
ART.	PARTE	QTA.
P0337	902979968	1

*Rif. Cod. Min. ISO 09.27.07.006 - Rimborso mensile massimo 8 pezzi
Non valido per la cintura di ricambio*

PRODOTTI VARI

La nostra gamma di prodotti si completa con Raccogli gocce per la gestione della lieve incontinenza maschile, pessario per la gestione del prolasso dell'utero ed infine la gamma completa di cannule rettail.

Pensato per gli uomini che soffrono di lieve incontinenza urinaria. La sua capacità di assorbire la parte di urina assicura la massima tenuta e discrezione, evitando la presenza di odori grazie al materiale di costruzione impiegato. Di facile applicazione grazie alla presenza di una striscia adesiva.

RACCOGLIGOCCE FACILE E DISCRETO

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DI PRODOTTI VARI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.T.A.
RACCOGLIGOCCE	150 ml R037850600	20
PESSARIO D.M.P. I GOMMA ROSSA	50 mm 627000-000500	1
	55 mm 627000-000550	1
	60 mm 627000-000600	1
	65 mm 627000-000650	1
	70 mm 627000-000700	1
	75 mm 627000-000750	1
	80 mm 627000-000800	1
	85 mm 627000-000850	1
	90 mm 627000-000900	1
	95 mm 627000-000950	1
	100 mm 627000-001000	1
	50 mm 9C8912494	1
	55 mm 9C8912532	1
	60 mm 9C8912544	1
	65 mm 9C8912557	1
	70 mm 9C8912569	1
	75 mm 9C8912571	1
	80 mm 9C8912583	1
	85 mm 9C8912595	1
	90 mm 9C8912645	1
	95 mm 9C8912734	1
	100 mm 9C8912746	1
	6 mm R035851000/06	50
	7 mm R035851000/07	50
	8 mm R035851000/08	50
	9 mm R035851000/09	50
	10 mm R035851000/10	50
	6 mm R035812565	50
	7 mm R035812577	50
	8 mm R035812615	50
	9 mm R035812627	50
	10 mm R035812639	50

30 CM I CANNULA RETTALE IN PVC

PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.T.A.
	6 mm R035851000/06	50
	7 mm R035851000/07	50
	8 mm R035851000/08	50
	9 mm R035851000/09	50
	10 mm R035851000/10	50

40 CM I CANNULA RETTALE IN PVC

PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.T.A.
	6 mm R035851001/06	50
	7 mm R035851001/07	50
	8 mm R035851001/08	50
	9 mm R035851001/09	50
	10 mm R035851001/10	50

PESSARI

Il pessario femminile, in gomma rossa e di forma rotonda ad anello è disponibile in diversi diametri e misure. Il pessario è indicato nei casi di prolasso dell'utero.

CANNULE RETTALI

Le cannule rettali Teleflex sono realizzate in morbido PVC medicale e con la punta arrotondata per facilitarne l'inserimento.

Indicate per la somministrazione di medicinali o per il drenaggio rettale tramite soluzione salina o oleosa.



COME CONTRIBUIRE ALLA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI IN CASO DI DRENAGGIO URINARIO A PERMANENZA

L'aumento dell'assunzione giornaliera di liquidi contribuisce a prevenire le incrostazioni del catetere vescicale a permanenza e della sacca di raccolta urina.

Svuotare regolarmente e tempestivamente il sistema di drenaggio urinario, prima che l'urina giunga a contatto con la valvola di non ritorno.

Verificare che il tubo del sistema di drenaggio urinario non sia mai piegato, affinché l'urina possa defluire uniformemente nella sacca di raccolta.

Si raccomanda di maneggiare il sistema di drenaggio urinario il meno possibile. Prima e dopo ogni manipolazione, ad esempio per svuotare la sacca urina, lavarsi accuratamente le mani ed eventualmente disinfettare.

Il raccordo fra il catetere vescicale a permanenza e la sacca urina non deve essere scollegato senza un motivo valido.

Ne il catetere vescicale a permanenza né la sacca di raccolta urina devono essere sostituiti di routine. Tuttavia, se si verificano incrostazioni o ostruzioni, sostituire sempre sia il catetere vescicale a permanenza che la sacca di raccolta urina.

Se il paziente non è allergico al lattice, è possibile utilizzare un catetere vescicale a permanenza in lattice per una durata massima di 5 giorni. Tuttavia, per il drenaggio urinario a lungo termine si consiglia un catetere privo di lattice realizzato in silicone, ad esempio il catetere con palloncino ProflitCath Plus della serie Aquaflex o il catetere Brilliant Plus Aquaflex.

Per usi pediatrici si dovrebbero utilizzare esclusivamente materiali di massima qualità. In questo caso si consiglia, pertanto, di utilizzare sempre cateteri in puro silicone, anche per il drenaggio urinario a breve termine.

Effettuare l'autocaterismo sempre in modo asettico.

Utilizzare esclusivamente sacche di raccolta urina sterili in associazione a sistemi di drenaggio urinario sterili, ad es. cateteri vescicali a permanenza.

Si raccomanda di associare sacche di raccolta urina non sterili esclusivamente a sistemi di drenaggio urinario non sterili (ad es. guaine per incontinenza).

Accertarsi che il sistema di drenaggio urinario venga sempre posizionato sotto il livello vescicale (eccetto Belly Bag).

Anche un'igiene regolare delle parti intime rappresenta un'importante misura profilattica contro le infezioni.

1
2
3

Teleflex

TELEFLEX RISPONDE
800-382643
numerverde.ht@teleflex.com
Fax Verde 800-144122



TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

Via Torino 5 • 20814 Varedo (MB)

T +39 0362 58 901 • F +39 0362 589 040

info.ital@teleflex.com • www.teleflex.com

Questo materiale informativo è destinato ad operatori sanitari. I prodotti di questo catalogo sono disponibili solo per EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa). Per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale. Tutti i dati sono aggiornati alla data di stampa corrente (07/2012).
Soggetto a modifiche e tecniche senza preavviso.

Flocath Quick non è destinato alla vendita in Germania

940485 - 000004 - REV A - MC / WM - 07 12 03

Teleflex

FLAIR
URO

*L'innovazione
da oggi
si fa in 2 ...*



Innovators in Stomacare

Welland
Medical

Il prodotto è distribuito in Italia da Teleflex s.p.a. - Via ...

PLACCHE PIANE		
	Conf. - Pz	O RT
45 MM	5	PP45 URO RT
55 MM	5	PP55 URO RT

Conf. Iso 09.18.08.003 - 20 placche/mese

SACCHE PER UROSTOMIA		
	Conf. - Pz	OPACA
45 MM	15	SO45 URO
55 MM	15	SO55 URO

Conf. Iso 09.18.08.009 - 30 sacche/mese

DEDICATO AGLI UTENTI FINALI

TELEFLEX RISPONDE
800-382643

www.teleflex.com

Teleflex

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.

Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)

Tel.: 0362.58901 - Fax: 0362. 589040

info.it@teleflex.com

www.ruscicare.com

Ref. 50079-0015 - (B-201)

L'innovazione da oggi si fa in 2...

Flair® 2 Uro, grazie al sistema brevettato "Dual-Security System", garantisce serenità e sicurezza a tutte le persone portatrici di stomia. Il rivestimento estremamente morbido della sacca, completo di tasca per il rubinetto, offre livelli di comfort e discrezione mai ottenuti prima, anche qualora la sacca venga indossata per lunghi periodi.

Flair® 2 Uro rappresenta una combinazione eccellente tra funzionalità, comfort, flessibilità e discrezione.

Gli esclusivi vantaggi di Flair® 2

- Un superiore livello di comfort, grazie al sistema "Tap-Pocket" (tasca per rubinetto).
- Maggiore sicurezza e flessibilità, grazie al nuovo Sistema Dual-Security System.
- Miglioramento delle condizioni della pelle, grazie all'esclusivo idrocolloide "omniscop" Hyperflex®.
- Riduzione e più rapido assorbimento della essudazione, grazie al morbido e confortevole rivestimento in speciale tessuto - non - tessuto.




Una straordinaria morbidezza sul tuo corpo

- L'estrema morbidezza del rivestimento esterno della sacca, garantisce un confort eccezionale su tutti i tipi di pelle, anche dopo parecchie ore di utilizzo.
- Il nuovo tessuto-non-tessuto ha un'alta capacità traspirante, che aiuta a prevenire le irritazioni della pelle.
- Inoltre, dopo un bagno o una doccia, si asciuga molto rapidamente e, quindi, previene l'essudazione evitando così l'irritazione dell'epidermide.
- Maggiore discrezione e assoluta sicurezza, si ottengono grazie all'abbinamento tra il nuovo morbido rivestimento e la sottile e resistente pellicola Welland.


Nuovi livelli di comfort e discrezione col sistema "Tap Pocket" antidecubito

- Grazie all'innovativo sistema "Tap Pocket", è possibile inserire il rubinetto nell'apposita tasca; si rende in questo modo la sacca più discreta e confortevole evitando, inoltre, problematiche di decubito.
- La tasca per il rubinetto è facilmente individuabile, grazie all'ausilio di linee - guchi, presenti sulla sacca.





Semplice monitoraggio dello stomia, grazie al nuovo tessuto non tessuto con dorso sdoppiato

- Questo sistema permette di monitorare in qualunque momento, la condizione dello stomia, senza dover usare necessariamente una sacca trasparente.
- Inoltre il "dorso sdoppiato", permette di vedere la stomia durante l'applicazione della sacca, consentendo l'utilizzo di una sacca opaca anche a coloro che presentano alcune difficoltà visive o di manualità.



FLAIR[®] URO

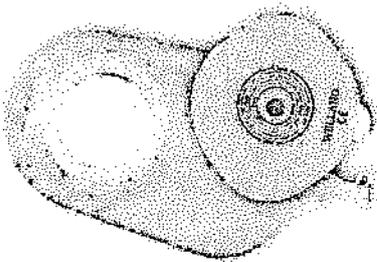


Un morbido rubinetto facile da usare


- Il rubinetto, in morbida plastica elastica e sottile, assicura una vestibilità comoda e discreta. Allo stesso tempo, consente manovre di apertura e di chiusura estremamente semplici. Il rubinetto in plastica elastica permette inoltre la compressione diretta con la sacca da gamba o da notte senza ricorrere all'utilizzo di velenieri addizionali.
- Durante l'operazione di svuotamento della sacca è possibile regolare il flusso dell'urina, applicando una leggera pressione con le mani sulle pareti del rubinetto flessibile.

"Dual-Security System" una doppia sicurezza che garantisce comfort e flessibilità

- È sufficiente la minima pressione per applicare la sacca alla placca, grazie al morbido orlo della sacca che fonde da area di contatto per il posz onamento, permettendo alla sacca di collocarsi facilmente sulla placca.
- Un fissaggio in due tempi è stato appositamente previsto per eventuali riposizionamenti della sacca. E, per questo, la linguetta blu (ben visibile) che protegge la parte adesiva della sacca, si può togliere a posizionamento avvenuto perfettamente.
- Un'apposita linguetta posta sull'orlo del lato della sacca, facilita la rimozione di quest'ultima e può essere utilizzata per far fuoriuscire eventuale urina in eccesso.

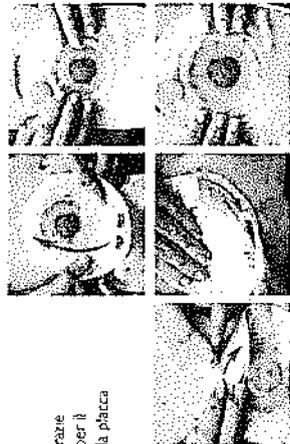

Miglioramento delle condizioni dell'epidermide, grazie alla barriera protettiva "Hyperflex" e al nuovo design della placca



- Un ambiente più idratato e sano per le superfici peristomiali, che presentano escoriazioni e cicatrici, grazie all'esclusivo idrocolloide Hyperflex® che rende la barriera protettiva particolarmente flessibile ed adattabile. Hyperflex® si conforma molto bene ai vari profili paracostomici, anche dove la stomia è mal posizionata e di difficile applicabilità, assicurando una perfetta aderenza. "Hyperflex®" ha un alto potere curativo e protettivo, che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.
- Una maggiore sicurezza unita ad una sensibile riduzione delle perdite, grazie ad un moderno design della linguetta che offre un'adesione mai ottenuta prima, nelle posizioni delle 3 e delle 9.
- Una discrezione ancora superiore è offerta dal bordo sottile e morbido della linguetta.

Teleflex IT

flair[®]
convex

La giusta pressione
solo dove serve ...



Welland
Medical

Innovators in Stomacare

Il prodotto è distribuito in Italia da Welland Medical S.p.A. - Via S. Vittore 10, 20139 Milano, Italia

Descrizione	Colore	Inizio convessità a Ø 25 mm				Ø mm Rk 13-48	Ø mm 35	Ø mm 44	Cont. pi. pz.
		Ø mm Rk 13-35	Ø mm Rk 13-48	Ø mm 35	Ø mm 44				
 Sacca per colite con convex Convex	Opaca	853350	853366	853370	853371	853372	10	09.18.04.009 Rimborso 60 sacche per ogni stomia	
	Trasparente	853356	853373						
 Sacca per ileostomia Convex	Opaca	853380	853374	853375	853376	853377	10	09.18.04.009 Rimborso 60 sacche per ogni stomia	
	Trasparente	853386	853378						

Cintura di supporto			
Misure	Gravità	Infilastopi	Codice
Standard	72 cm - 102 cm	Unisex	853606
Large	100 cm - 160 cm	Unisex per: tagliate comode, ernie peristomiali, ecc ...	853607
			853608
			853609

DEDICATO AGLI UTENTI FINALI

TELEFLEX RISPONDE
800-382643

Per info visitate il sito www.teleflex.com
Fax: 0362.589011

Teleflex

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.

Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)

Tel.: 0362.589011 - Fax: 0362.589040

info.it@teleflex.com

www.ruschcara.com

P.01.10061301 (01/01/01)


Flair[®] Convex - La morbidezza combinata alla convessità

La nuova gamma di sacche che convessa Welland assicura, oltre alla massima sicurezza di sempre, una perfetta convessa e rigida che garantisce la stessa flessibilità e la medesima protezione di una sacca Convex[®] morbida.


La giusta pressione, solo dove serve.

La nuova gamma di sacche mono pezzo Flair[®] Convex, è dotata di una flangia ancora più larga per una sicurezza totale con convessità "a cupola". Con il calore del corpo, il plateau "a cupola" si adatta al profilo della retrazione stomacale: è questo che rende Flair[®] Convex il prodotto ideale per stomi totalmente o parzialmente retratti. Ma non solo: è ideale anche per quelle stomie che, in seguito ad infezioni e suppurazioni, hanno subito introflessioni profonde.


Caratterne la giusta convessità per le diverse situazioni, è stato possibile grazie all'utilizzo dell'imita elastici inestricabile e flessibile: la temprofibra. Questo materiale innovativo permette alla sacca di conformarsi al corpo. La consistenza di questo materiale è morbida, non presenta nessuna rigidità o sporgenza che potrebbero danneggiare la stomia e la cute peristomiale. Fatto che avveniva frequentemente in passato, proprio a causa dell'utilizzo di alcuni prodotti convessi di vecchia concezione.

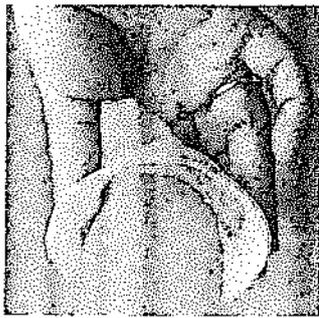

Il plateau "a cupola" sottile e flessibile, assicura quindi una perfetta vestibilità della stomia e della cute peristomiale, senza provocare eccessive distorsioni del peristolio. Cosa difficile da ottenere con sacche convesse più rigide.



La giusta pressione solo dove serve



Prodotti convessi di vecchia concezione

Flair[®] Convex è ideale per pazienti:


- con stomie retratte ed introflesse;
- che presentano pieghe peristomiali profonde;
- con stomie malposizionate e irritate su picche cutanee;
- con stomie introflesse, complicate da cicatrici post-operatorie;
- con stomie mal posizionate, specialmente le ileostomie;
- con stomie asimmetriche;
- che presentano granulomatosi peristomiali;
- con retrazioni stomali causate da perdita o aumento di peso nel post-operatorio;
- con addome fiaccido.

Come selezionare la sacca Welland giusta

PROBLEMATICHE	Sacca standard	Sacca Convex	Sacca Flair Convex
Problemi addominali, stomie malposizionate, lesioni cutanee di varia entità	Profilo della flangia largo piatto	Profilo della flangia convessa con curvatura morbida e flessibile	Profilo della flangia convessa con curvatura compatta, resistente ma modulare
Stomie retratte, complicate da pieghe peristomiali e granulomatosi	Si con l'utilizzo di protettori, paste riempitive	Perfetta per adattarsi alle irregolarità peristomiali dove non è richiesta pressione	Perfetta per adattarsi alle irregolarità peristomiali dove è richiesta pressione
Stomie circolari parzialmente o su tutta la circonferenza	Non indicata	Non indicata	Perfetta per adattarsi alle irregolarità peristomiali dove non è richiesta pressione
Ernia peristomiale	Si utilizzando una barriera ampia ricucita da fibrinoplastici e paste riempitive	Perfetta per adattarsi alle irregolarità peristomiali dove non è richiesta pressione	Perfetta per adattarsi alle irregolarità peristomiali dove è richiesta pressione
			Non indicata

Una possibilità in più: la cintura di supporto

Il sistema di cinture Welland provvede ad assicurare sempre la giusta soluzione per coloro che devono, di norma, indossare una cintura di supporto. Una vasta gamma di misure dell'anello in tessuto anti-scivolo, contribuisce al raggiungimento di una perfetta vestibilità. Il tessuto elastico della cintura con velcro riposizionabile, rende facile e comodo l'utilizzo in qualsiasi circostanza.



Importante nota tecnica

Tutte le sacche Welland sono dotate di un'esclusiva barriera protettiva denominata "Hyperflex[®]". "Hyperflex[®]" è composta da una speciale formula idrocolloide che la rende particolarmente flessibile ed adattabile. Si conforma molto bene ai vari profili paracolostomici anche dove la stomia è mal posiziona e di difficile apparecchiabilità, assicurando una perfetta aderenza.

"Hyperflex[®]" ha un alto potere curativo e protettivo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.

Teleflex 

LIPO
flair
ACTIVE®

*Per darti la libertà
di essere attivo ...*



Innovators in Stomachcare



Il prodotto è distribuito in Italia da Teleflex, un prodotto di WELAND MEDICAL, L.R. 15

FLAIR ACTIVE®							
Colore	Ø KIT	Ø 19 mm	Ø 22 mm	Ø 25 mm	Ø 29 mm	Ø 33 mm	Conf. da pz.
Opaca	853438						
Trasparente	853430	853431	853432	853433	853434	853436	10

Cod. Iso 02-18.07.003 - 30 sacche/mese

DEDICATO AGLI UTENTI FINALI


TELEFLEX RISPONDE
800-382643
su www.teleflex.com
o al numero 02-18.07.003

teleflex

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.
Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)
Tel.: 0362.58901 - Fax: 0362.589040
info.it@teleflex.com
www.tuischcare.com

PER INFORMAZIONI: 02-18.07.003

Per darti la libertà di essere attivo...

Puoi avere la sicurezza di indossare la tua sacca e continuare a svolgere le tue attività quotidiane, con la nuova Flair Active® extra per l'urto.

Gli esclusivi vantaggi di Flair Active®

- Un superiore livello di comfort, grazie al sistema "Tap-Pocket" (sacca per il rubinetto).
- Semplificato monitoraggio dello stomaco, grazie all'innovativo "dorso sdoppiato".
- Miglioramento delle condizioni della pelle, grazie all'esclusivo "Shout-Block" (antimacchia della pelle), Hyperflex™.
- Riduzione e più rapido assorbimento dell'esudazione, grazie al morbido e confortevole rivestimento in speciale tessuto non-tessuto.

Miglioramento delle condizioni dell'epidermide, grazie alla barriera protettiva "Hyperflex®" e al suo nuovo design

- Un ambiente più idratato e sano per la superficie peristomiale che presenta escoriazioni e ri-attrici, grazie all'esclusivo "collante Hyperflex", che rende la barriera protettiva particolarmente flessibile ed adattabile.
- Hyperflex™ è conforma molto bene ai vari profili parastomici, anche dove lo stomaco è mal posizionato e di difficile appiccicabilità, assicurando una perfetta aderenza.
- Hyperflex™ ha un alto potere curativo e protettivo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.
- Una maggiore sicurezza ed una sensibile riduzione delle perdite, grazie ad un moderno design della flangia che offre un'adesione più tenace prima, nelle posizioni delle 3 e delle 9.
- Una discrezione ancora superiore e offerta dal bordo sottile e morbido della flangia.


Un morbido rubinetto, facile da usare

- Il rubinetto in morbida plastica elastica e sottile, assicura una vestibilità comoda e discreta. Allo stesso tempo, consente manovre di apertura e di chiusura, estremamente semplici.
- Il rubinetto in plastica elastica permette inoltre la connessione diretta con la sacca da giorno o da notte, senza ricorrere all'utilizzo di ulteriori adattatori.
- Durante l'operazione di svuotamento della sacca è possibile regolare il flusso delle urine, applicando una leggera pressione con le mani sulle pareti del rubinetto flessibile.




Nuovi livelli di comfort e discrezione col sistema "Tap Pocket" antidecubito

- Grazie all'innovativo sistema "Tap Pocket" è possibile inserire il rubinetto nell'apposita tasca, in questo modo la sacca più discreta e confortevole evitando inoltre problematiche di decubito.
- La tasca per il rubinetto è facilmente individuabile, grazie all'ausilio di linee - guida, presenti sulla sacca.




Semplice monitoraggio dello stomaco, grazie al nuovo tessuto non tessuto con "dorso sdoppiato"

- Questo sistema permette di monitorare in qualunque momento la condizione dello stomaco, senza dover usare necessariamente una sacca trasparente.
- Inoltre, il "dorso sdoppiato" permette di vedere la stomia durante l'applicazione della sacca, consentendo l'utilizzo di una sacca opaca, anche a coloro che presentano alcune difficoltà visive o di manualità.
- Il rischio di infezioni è ridotto al minimo, grazie alla presenza della valvola di non-ritorno, che previene il reflusso delle urine.




Una straordinaria morbidezza, sul tuo corpo

- L'estrema morbidezza del rivestimento esterno della sacca, garantisce un comfort eccezionale su tutti i tipi di pelle, anche dopo parecchie ore di utilizzo.
- Il nuovo tessuto non-tessuto ha un'alta capacità traspirante, che aiuta a prevenire le irritazioni della pelle. Inoltre, dopo un bagno o una doccia, si asciuga molto rapidamente e quindi, previene l'esudazione evitando così, l'irritazione dell'epidermide.
- Maggiore discrezione e assoluta sicurezza si ottengono, grazie all'abbinamento tra il nuovo morbido rivestimento e la sottile e resistente pellicola Welland.



Urostomy

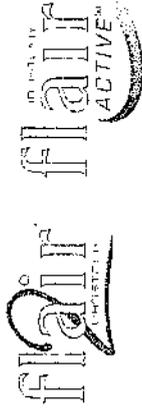

Flair Active® Urostomy

		Starter Hole		Pre-Cut			
	19mm	22mm	25mm	29mm	32mm	36mm	38mm
BEIGE	XPUR513	XPUR519	XPUR522	XPUR525	XPUR529	XPUR532	XPUR535
CLEAR	XPUR713	XPUR719	XPUR722	XPUR725	XPUR729	XPUR732	XPUR735

Flair® 2 Urostomy

		Flat Baseplates Starter Hole		Flat Baseplates Pre-Cut			
	13mm-15mm	13mm-20mm	25mm	29mm	32mm	35mm	38mm
45mm	XP2U514	XP2U714	XP2U713	XP2U712	XP2U715	XP2U712	XP2U713
55mm	XP2U715	XP2U715	XP2U715	XP2U713	XP2U713	XP2U713	XP2U713



Welland Medical Ltd. is a registered company. For more information, please contact us at: 01273 821111. Fax: 01273 821112. Email: info@wellandmedical.com

www.wellandmedical.com



WELLAND MEDICAL STOMACARE

Have the confidence to wear your pouch and continue with daily activities with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches.



the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches offer new and enhanced features that help address everyday issues.

Key benefits

- Easy to use soft tap with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches.
- New levels of comfort and discretion with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Super softness against your body with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Easy monitoring of stoma with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Flair® 2 offers security coupled with flexibility with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.

Improved skin condition with Welland's Hyperflex® hydrocolloid and new flange

- Improved skin condition with Welland's Hyperflex® hydrocolloid and new flange.
- Easy to use soft tap with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches.
- New levels of comfort and discretion with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Super softness against your body with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Easy monitoring of stoma with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.
- Flair® 2 offers security coupled with flexibility with the new split back Flair® 2 Urostomy pouches.

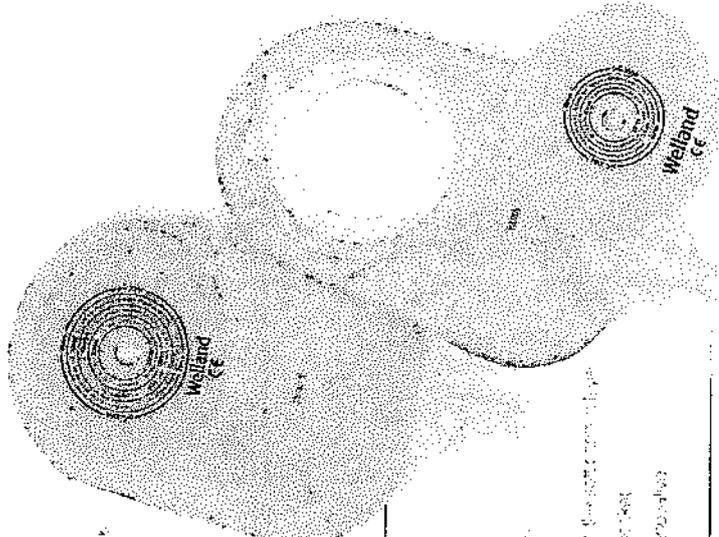

Easy to use soft tap

- Welland's new soft tap with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.
- The new soft tap with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.
- The new soft tap with the new Flair Active® and Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.

New levels of comfort and discretion

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of comfort and discretion.

Super softness against your body

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of softness against your body.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of softness against your body.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of softness against your body.

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of softness against your body.

Easy monitoring of stoma with the new split back

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of easy monitoring of stoma.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of easy monitoring of stoma.

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of easy monitoring of stoma.

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of easy monitoring of stoma.





Flair® 2 offers security coupled with flexibility

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of security coupled with flexibility.
- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of security coupled with flexibility.

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of security coupled with flexibility.

- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of security coupled with flexibility.


- The new split back Flair® 2 Urostomy pouches offers a new level of security coupled with flexibility.

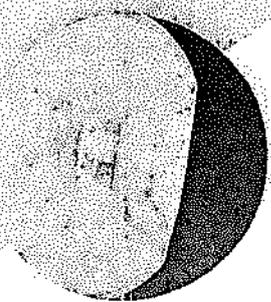

Teleflex IT

Flair[®] ILEO[®] COLO

Sentirsi a proprio agio

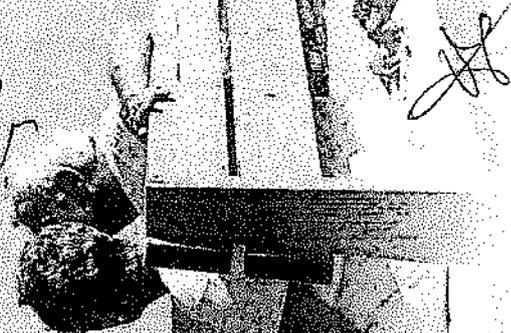

Innovators in Stomacare



Flair e Flair Ileo sono marchi registrati di Teleflex Medical S.p.A. - Via Varedo 5 - 20134 Varese (VA) - Italia

FLAIR [®] COLO - FLAIR [®] ILEO (ANCEL)									
Distribuzione	Colore	Q. min. (g)	Q. min. (g)	Cont. pz.					
Sacca per Coloclear Flair Colo	Opaca	853140	853141	853142	853143	853144	09.18.04.003	30	
	Trasparente	853145	853146	853147	853148	853149	09.18.04.006		
Sacca per Alcestroma Flair Ileo	Opaca	853290	853291	853292	853293	853294	09.18.04.006	30	
	Trasparente	853295	853296	853297	853298	853299	09.18.04.006		

DEDICATO AGLI UTENTI PRIVATI



TELEFLEX RISPONDE
800-382643

Info: info@teleflex.com
Fax: +39 0362 589040

Teleflex

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.

Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)

Tel.: 0362.589011 - Fax: 0362.589040

info@teleflex.com

www.ruschcare.com

101/02002/001/01 - 05/2011

Flair^(R) Colo e Flair^(R) Fleo - Sentirsi a proprio agio


Le sacche Welland Flair^(R) Colo e Flair^(R) Fleo offrono una tecnologia innovativa e garantiscono sicurezza, flessibilità, comfort e protezione.

Sicurezza e comfort

La forma a goccia della barriera protettiva garantisce un'aderenza sicura e confortevole. Grazie alla spessezza particolarmente sottile e flessibile, si adatta facilmente ai vari profili paracolostomici. Nella parte sottostante la stomia, è stata inserita ed angolata per evitare infiltrazioni così pure nelle zone laterali, dove esiste maggiore rischio di distacco, dovuto alla presenza di pieghe cutanee e catarri.


Protezione

L'esclusiva formula idrocolloidale "Hyperflex^(R)" rende la barriera protettiva particolarmente delicata e morbida sulla pelle, e nel contempo, permette la formazione di un ambiente di salato che evita cremini irritazioni. La barriera protettiva "Hyperflex^(R)" ha un alto potere curativo e protettivo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.

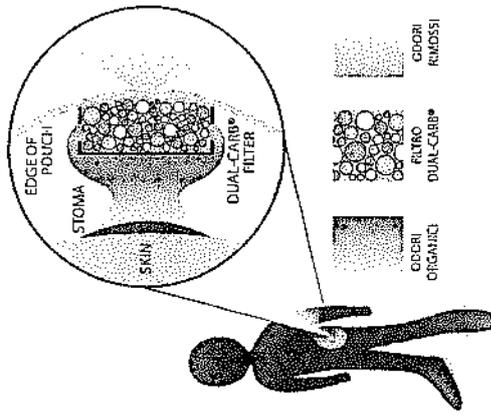

Comfort

Il tessuto non tessuto è un morbido feltro protettivo che consente un particolare comfort alla stomia, e inoltre un'adeguata porosità che consente un'ottima traspirazione ed una buona assorbenza in caso di sudorazione.

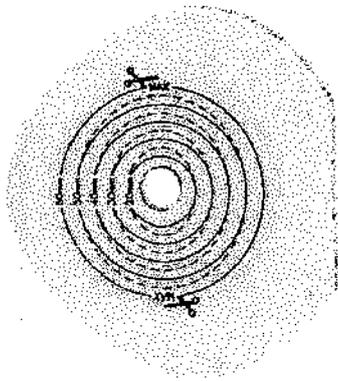


Flair^(R) Colo (Angel Colo)

La lingua idrocolloidale a forma di goccia favorisce una sicura aderenza, mentre simultaneamente, aiuta la guarigione della pelle escoriata ed irritata, inoltre è morbida e delicata sulla pelle.

La sua particolare flessibilità le permette di adattarsi molto bene, qualsiasi sia la posizione assunta dal paziente. E questa sua caratteristica fondamentale al fine di garantire una qualità di vita "normale" ed attiva.


Flair^(R) Colo è stata progettata per adattarsi comodamente all'area inguinale e, nel contempo la sua forma favorisce lo spostamento del contenuto della sacca, verso il fondo.



Flair^(R) Fleo (Angel Fleo)

Flair^(R) Fleo costituisce un importante passo avanti nel sistema di svuotamento della sacca che, ora, avviene in modo veramente facile, comodo e pulito: basta sollevare l'apposita linguetta bianca (facilmente individuabile), opportunamente situata nella parte terminale della sacca. E questa un'operazione molto pratica e veloce, adatta anche a coloro che presentano difficoltà di manualità. C'è permette di aprire la sacca con estrema facilità e senza sporcarsi, sia nella fase di svuotamento che in quella di pulizia.

Flair^(R) Fleo è stata progettata con un'apertura più lunga e più ampia e questo facilita ulteriormente lo svuotamento e la pulizia.




La procedura di chiusura si effettua con quattro ripiegamenti che vengono fissati con un comodo e sicuro sistema in velcro.

Flair^(R) Fleo possiede un avanzato sistema di protezione del filtro, che blocca attivamente i contenuti della sacca, evitando che vadano a contatto con il filtro stesso che potrà quindi eliminare efficacemente l'intera gamma di odori sgradevoli.

Importante nota tecnica

Tutte le Sacche Welland sono dotate di un'esclusiva barriera protettiva denominata "Hyperflex^(R)". "Hyperflex^(R)" è composta da una speciale formula idrocolloidale che la rende particolarmente flessibile ed adattabile. Si conforma molto bene ai vari profili paracolostomici, anche dove la stomia è mal posizionata e di difficile apparecchiabilità, assicurando una perfetta aderenza.

"Hyperflex^(R)" ha un alto potere curativo e protettivo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.



Teleflex IT



Entra in sintonia
con il tuo corpo



Innovators in Stomacare

Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi sono proprietà di TELEFLEX MEDICAL LIMITED

CURVEX® Descrizione	Colore	Inizio compressità a Ø 32 mm		Inizio compressità a Ø 43 mm		Codice ISO	Conti da PK
		Ø mm Ri: 43-32	Ø mm 32	Ø mm Ri: 43-43	Ø mm 38		
 Sacca per colostomia Curvex	Opaca	853066	853067	853069	853070	853071	09.18.04.009 Rimborsato mensile 30 sacche per ogni stomia
	Trasparente	853072		853073			
 Sacca per ileostomia Curvex	Opaca	853074		853075			09.18.04.009 Rimborsato mensile 30 sacche per ogni stomia
	Trasparente	853076		853077			
 Sacca per urostomia Curvex	Opaca	853097		853098			09.18.07.006 Rimborsato mensile 30 sacche per ogni stomia
	Trasparente	853089		853100			
Cintura di supporto							
Misure		Circovita		Indicazioni		Codice	
Standard		72 cm - 102 cm		Unisex		Inizio compressità a Ø 32 mm Inizio compressità a Ø 43 mm 853604 853606	
Large		100 cm - 160 cm		Unisex per: taglie comode, ernie peristomiali, ecc...		853605 853607	

DEDICATO AGLI UTENTI FINALI


TELEFLEX RISPONDE
800-382643
www.teleflex.com
per vendite 800-141122

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.
Via Torino, 5 - 20814 Varedo (MB)
Tel.: 0362.58901 - Fax: 0362.589040
info.it@teleflex.com
www.ruschcare.com

REF. M8000-00811-002011

Entra in sintonia con il tuo corpo...




Curvex® è la soluzione definitiva per uomini leggermente retratti o di poco intorlessati, o per stomie situate in prossimità di pieghe cutanee e gibbi addominali, dove il sistema convesso tradizionale può creare lesioni cutanee. La gamma Curvex® prevede due diversi tipi di convessità: uno a 32 mm ed uno a 43 mm per poter garantire sempre la migliore aderenza possibile, per ogni tipo di irregolarità cutanea che circonda la stomia.

Curvex® ha una lingua tridimensionale che si adatta con naturalezza alla cute, riempendo le rientranze e le irregolarità peristomiali, ed eliminando la necessità di ricorrere a paste e stucchi riempitivi. La morbida lingua flessibile incrosta in modo delicatissimo dove è più necessario senza provocare abrasioni, lacerazioni o ulcerazioni. Questo riduce il disagio e dà una che spesso si accompagnano all'utilizzo di sistemi convessi tradizionali rigidi.




Lingua peristomiale

La lingua indeformabile di Curvex®, riesce a conformarsi molto bene alla forma dell'anima peristomiale. (Come si vede nella fotografia)



Sacma leggermente retratta con epiche cutanee peristomiali



Compilazione stomiale causale 28 su stomia di Curvex®

La lingua tridimensionale di Curvex® riduce al minimo anche l'esigenza di utilizzare scomode cinghie, poiché la tenuta sicura del presidio viene ottenuta grazie ad una eccellente aderenza e adattabilità alla forma dell'addome.



La scelta della sacca Curvex® più adatta deve tener presente sia le dimensioni dello stomia che quelle della zona interessata da eventuali irregolarità o da problemi che circondano la stomia: retrazioni, pieghe cutanee, cicatrici, ernie, affollamenti ed altro. Questo sarà utile per decidere se utilizzare una lingua con arco convessità a 32 o a 43 mm.



Una possibilità in più: la chiusura di supporto

Il sistema di cinghie Weiland prevede ad assicurare sempre la giusta soluzione per coloro che devono indossare una cinghia di supporto. Una vasta gamma di misure dell'anello in tessuto ant-scivolo, contribuisce al raggiungimento di una perfetta vestibilità. Il tessuto elastico della cinghia con velcro riposizionabile, rende facile e comodo l'utilizzo in qualsiasi circostanza.

Curvex® è ideale per pazienti:

- che presentano irregolarità, retrazioni, piccole pieghe, affollamenti, o ricadute nella zona peristomiale;
- con ernia peristomiale;
- con stomie leggermente retratte o poco intorlessate;
- che hanno sperimentato gravi perdite dovute all'utilizzo di sacche con adesivo piano;
- anziani o persone con scarsa manualità, alle quali risulta difficile l'impiego di stucchi o paste protettiva di riempimento;
- con retrazioni stomiali causate da perdita o aumento di peso nel post-operatorio.

ideale da usare laddove gli altri prodotti convessi tradizionali hanno creato problemi!

La gamma Curvex®

Sacca per colostomia:

- nuova tecnologia con filtro Dual-Carb®
- forma a goccia, della sacca, per migliorare il rapporto capacità-ingombro;
- disponibile sia chiara che opaca.

La forma a goccia e la varietà dei colori (dei colori sopra elencati) sono preziosi anche nelle gomme di lino ed urostomia.

Sacca per ileostomia

- nuova tecnologia con filtro Dual-Carb®.
- sistema di chiusura integrata con apertura più larga e più lunga, per uno svuotamento ancora più facile;
- comoda linguetta per favorire una apertura più rapida e garantire una procedura di svuotamento più pratica e igienica.


Sacca per urostomia

- il rubinetto in morbida plastica elastica è poco ingombrante, risulta morbido, maneggevole e sicuro ed offre il massimo comfort;
- durante l'operazione di svuotamento della sacca è possibile regolare il flusso delle urine applicando una leggera pressione sulle pareti del rubinetto flessibile, come viene mostrato nella fotografia;
- il rubinetto permette la connessione diretta, senza adattatori aggiuntivi, ai sistemi di drenaggio da giorno o da notte più diffusi;
- linguette "antattorcigliamento", utili quando la sacca è collegata ad un ulteriore sistema di drenaggio.

Importante nota tecnica

Tutte le sacche Weiland sono dotate di un'esclusiva barriera protettiva denominata "Hyperflex®". "Hyperflex®" è composta da una speciale formula idrocolloidale che la rende particolarmente flessibile ed adattabile. Si conforma molto bene ai vari profili paracolostomici, anche dove la stomia è mal posizionata e di difficile apparecchiabilità, assicurando una perfetta aderenza.

"Hyperflex®" ha un alto potere curativo e protettivo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.



Teleflex IT

flair[®]
COLO e ILEO

*Una coppia
perfetta*



Welland
Medical

Innovators in Stomacare

Il prodotto è distribuito in Italia da Teleflex Medical S.p.A. - Via S. Felice 10 - 20139 Milano - Tel. 02 574911 - Fax 02 574912

PLACCHHE PIANE

	Cont. - Pz.	Ø RRT	Ø 25 mm	Ø 29 mm	Ø 32 mm	Ø 35 mm	Ø 38 mm	Ø 44 mm
45 MM	5	PP45 45RT	PP45 45ZB	PP45 45B2	PP45 45B5	PP45 45B8	PP45 45B8	PP55 5544
55 MM	5	PP55 55RT	-	-	-	-	PP55 55B8	-
70 MM	5	PP70 70RT	-	-	-	-	-	-

Cod. Iso 09.18.05.003 - COLO 10 placche/mese - ILEO 15 placche/mese

PLACCHHE CONVESSE

	Cont. - Pz.	Ø RRT	Ø 25 mm	Ø 29 mm	Ø 32 mm	Ø 35 mm
45 MM	5	PC45 25RT	PC55 35ZB	PC55 35B2B	PC55 35B2	PC55 35B5
55 MM	5	PC55 35RT	-	-	-	-
70 MM	5	PC70 48RT	-	-	-	-

Cod. Iso 09.18.05.006 - COLO 10 placche/mese - ILEO 15 placche/mese

SACCHE PER COLOSTOMIA

	Cont. - Pz.	OPACA MIDIJ	OPACA MIAMI	TRASP. MIDIJ	TRASP. MIAMI
45 MM	30	SO45 COLO	SO45 CMAX	ST45 COLO	-
55 MM	30	SO55 COLO	SO55 CMAX	ST55 COLO	-
70 MM	10	-	-	-	ST70 COLO

Cod. Iso 09.18.05.009 - COLO 60 sacche/mese

SACCHE PER ILEOSTOMIA

	Cont. - Pz.	OPACA MIDIJ	OPACA MIAMI	TRASP. MIDIJ	TRASP. MIAMI
45 MM	30	SO45 ILEO	SO45 IMAX	ST45 ILEO	-
55 MM	30	SO55 ILEO	SO55 IMAX	ST55 ILEO	-
70 MM	10	-	-	-	ST70 ILEO

Cod. Iso 09.18.05.012 - ILEO 90 sacche/mese

DEDICATO AGLI UTENTI RINALI



TELEFLEX RISPONDE
800-382643
numero verde 24 ore al giorno

Teleflex

CONTATTI PER OPERATORI SANITARI

Teleflex Medical S.r.l.
Via Torino, 5 - 20814 Vareto (MB)
Tel.: 0362.58901 - Fax: 0362.589040
info.it@teleflex.com
www.ruschcare.com

RFI 81662/00102 - 08-2011

Flair^(R) 2 ... Sicuro-Semplice-Flessibile

Flair² grazie al sistema brevettato "Dual-Security System", garantisce serenità e sicurezza alla Persona portatrice di Stomia. Abbinato ad un nuovo tessuto - non - tessuto che dona un'estrema morbidezza sulla pelle, rappresenta una combinazione eccellente tra funzionalità, comfort e flessibilità.

Il più innovativo film "Dual-CorkSM" è stato sviluppato. Illeggiadimento, grazie all'utilizzo di un nuovo tipo di microbolle, il nuovo film viene infatti, trattato a laser per assicurare sempre un taglio pulito e preciso. Ciò amplia l'efficacia e la durata del film stesso, riducendo al contempo i gonfiori ed eventuali perdite dal filtro.


Le nuove e moderne placche dal design innovativo, sono dotate di particolari "linee guida" che facilitano l'aggio, garantendo una maggiore sicurezza nei confronti di eventuali irritazioni.

Flair² Colo e Flair² Fleo incontrano i bisogni di tutti i giorni della Persona portatrice di Stomia.

- Nuovo tessuto - non - tessuto, ancora più morbido e confortevole. La porosità del nuovo tessuto - non - tessuto consente un'ottima traspirazione ed un perfetto assorbimento in caso di sudorazione, impedendo eventuali irritazioni della pelle.
- Il rivoluzionario film "Dual-CorkSM" è il risultato di una sinergia tra diversi carboni attivi che intrappolano ed assorbono con grande efficacia tutti gli odori prodotti dall'intestino.
- L'innovativa fodera protettiva del filtro "Tiker Protection Inner" incorporata nella sacca per stomia che, in quella per stomia, protegge il filtro e ne prolunga l'efficacia.
- Un'ampia gamma di misure delle sacche (Mini e Maxi) e delle placche da 45mm, 55mm e 70mm permette un'ottima adattabilità.


L'originale chiusura integrata è veramente semplice e sicura.

- Il sistema di svuotamento della sacca per stomia, ora, avviene in modo veramente facile, comodo e pulito: basta sollevare l'apposita linguetta bianca (facilmente individuabile), opportunamente situata nella parte terminale della sacca. E' questa un'operazione molto pratica e veloce, adatta anche a coloro che presentano difficoltà di manualità. Ciò permette di aprire la sacca con estrema facilità e senza sporcarsi, sia nella fase di svuotamento che in quella di pulizia. La procedura di chiusura è effettuata con quattro impingimenti che vengono fatti con un comodo e sicuro sistema in velcro.
- L'apertura della sacca per stomia è ancora più lunga e più ampia, al fine di facilitare ulteriormente lo svuotamento e la pulizia.

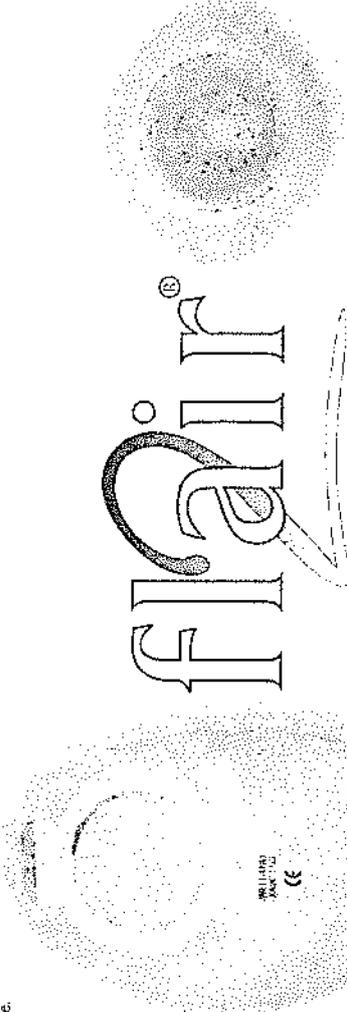


"Dual-Security System" una doppia sicurezza che garantisce comfort e flessibilità.

- E' sufficiente la minima pressione per applicare la sacca alla placca grazie al morbido orlo del filtro della sacca che funge da area di contatto per il posizionamento permettendo alla sacca di collocarsi facilmente sulla placca.
- Un fissaggio in due tempi, è stato appositamente previsto per eventuali riposizionamenti della sacca. E' per questo che la linguetta blu (ben visibile) che protegge la parte attiva della sacca, si può togliere a posizionamento avvenuto perfettamente.
- Un'apposita linguetta posata sull'orlo del foro della sacca, facilita la rimozione di quest'ultima e può essere utilizzata per far fuoriuscire eventuale aria in eccesso.

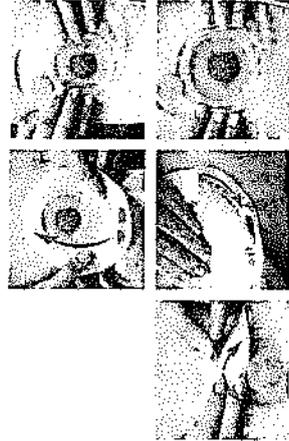

Placche moderne, confortevoli e discrete

- Tutte le placche Welland sono dotate di un'esclusiva barriera protettiva, denominata "HyperflexSM" "HyperflexSM" è composta da una speciale formula idrocolloidale che la rende particolarmente flessibile ed adattabile. Si conforma molto bene ai vari profili paracolostomici, anche dove la stomia è mal posizionata e di difficile apprezzabilità, assicurando una perfetta aderenza. "HyperflexSM" ha un alto potere curativo che favorisce molto bene la guarigione della pelle escoriata ed irritata.
- Il design della placca, è stato studiato per permettere una maggiore attenzione nelle zone in cui, più frequentemente, si possono verificare distacchi. In questo modo è possibile garantirne il massiccio della sicurezza.
- La placca ha un'esiguo spessore che le dona un'elevata flessibilità ed una maggiore discrezione.
- Ampia gamma di placche piane e convesse "Termomodulabili Antidiscobito", molto semplici da pulire.

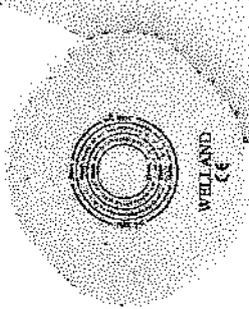

Lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
1	5029992086	Sacca a fondo chiuso con filtro, barriera autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura. UNI EN ISO 8670-2	91804003	3.762.825	1,6	€ 1.597	UNO/597	€ 6.009.231,525	R011853020 R011853022 R011853024 R011853025 R011853026 R011853030 R011853032 R011853033 R011853034 R011853080 R011853090 R011853091 R011853092 R011853093 R011853094 R011853095 R011853140 R011853141 R011853142 R011853143 R011853144 R011853145 R011853146 R011853147 R011853148 R011853149
2	503013243D	Sacca a fondo opario con o senza filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT con o senza cintura (1). UNI EN 8670-2	91804006	763.794	1,8	€ 1.790	UNO/790	€ 1.367.191,260	R011853160 R011853164 R011853170 R011853179 R011853180 R011853200 R011853210 R011853212 R011853213 R011853214 R011853215 R011853260 R011853281 R011853292 R011853293 R011853294 R011853295 R011853296 R011853297 R011853298 R011853299

TELEFLEX MEDICAL s.r.l.

Procuratore


DAVIDE BRAMBILLA

David Brambilla

Lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
3	5030149245	Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza filtro, barriera protettiva integrale per stomi irreflessi, con o senza rivestimento in TNT (2). UNI EN ISO.8670-2	91804009	150.015	4,1	€ 4,090	QUATTRO/090	€ 613.561,350	R011853066 R011853067 R011853068 R011853069 R011853070 R011853071 R011853072 R011853073 R011853074 R011853075 R011853076 R011853077 R011853078 R011853079 R011853080 R011853081 R011853082 R011853083 R011853084 R011853085 R011853086 R011853087 R011853088 R011853089 R011853090 R011853091 R011853092 R011853093 R011853094 R011853095 R011853096 R011853097 R011853098 R011853099 R011853100 R011853101 R011853102 R011853103 R011853104 R011853105 R011853106 R011853107 R011853108 R011853109 R011853110 R011853111 R011853112 R011853113 R011853114 R011853115 R011853116 R011853117 R011853118 R011853119 R011853120 R011853121 R011853122 R011853123 R011853124 R011853125 R011853126 R011853127 R011853128 R011853129 R011853130 R011853131 R011853132 R011853133 R011853134 R011853135 R011853136 R011853137 R011853138 R011853139 R011853140 R011853141 R011853142 R011853143 R011853144 R011853145 R011853146 R011853147 R011853148 R011853149 R011853150 R011853151 R011853152 R011853153 R011853154 R011853155 R011853156 R011853157 R011853158 R011853159 R011853160 R011853161 R011853162 R011853163 R011853164 R011853165 R011853166 R011853167 R011853168 R011853169 R011853170 R011853171 R011853172 R011853173 R011853174 R011853175 R011853176 R011853177 R011853178 R011853179 R011853180 R011853181 R011853182 R011853183 R011853184 R011853185 R011853186 R011853187 R011853188 R011853189 R011853190 R011853191 R011853192 R011853193 R011853194 R011853195 R011853196 R011853197 R011853198 R011853199 R011853200 R011853201 R011853202 R011853203 R011853204 R011853205 R011853206 R011853207 R011853208 R011853209 R011853210 R011853211 R011853212 R011853213 R011853214 R011853215 R011853216 R011853217 R011853218 R011853219 R011853220 R011853221 R011853222 R011853223 R011853224 R011853225 R011853226 R011853227 R011853228 R011853229 R011853230 R011853231 R011853232 R011853233 R011853234 R011853235 R011853236 R011853237 R011853238 R011853239 R011853240 R011853241 R011853242 R011853243 R011853244 R011853245 R011853246 R011853247 R011853248 R011853249 R011853250 R011853251 R011853252 R011853253 R011853254 R011853255 R011853256 R011853257 R011853258 R011853259 R011853260 R011853261 R011853262 R011853263 R011853264 R011853265 R011853266 R011853267 R011853268 R011853269 R011853270 R011853271 R011853272 R011853273 R011853274 R011853275 R011853276 R011853277 R011853278 R011853279 R011853280 R011853281 R011853282 R011853283 R011853284 R011853285 R011853286 R011853287 R011853288 R011853289 R011853290 R011853291 R011853292 R011853293 R011853294 R011853295 R011853296 R011853297 R011853298 R011853299 R011853300 R011853301 R011853302 R011853303 R011853304 R011853305 R011853306 R011853307 R011853308 R011853309 R011853310 R011853311 R011853312 R011853313 R011853314 R011853315 R011853316 R011853317 R011853318 R011853319 R011853320 R011853321 R011853322 R011853323 R011853324 R011853325 R011853326 R011853327 R011853328 R011853329 R011853330 R011853331 R011853332 R011853333 R011853334 R011853335 R011853336 R011853337 R011853338 R011853339 R011853340 R011853341 R011853342 R011853343 R011853344 R011853345 R011853346 R011853347 R011853348 R011853349 R011853350 R011853351 R011853352 R011853353 R011853354 R011853355 R011853356 R011853357 R011853358 R011853359 R011853360 R011853361 R011853362 R011853363 R011853364 R011853365 R011853366 R011853367 R011853368 R011853369 R011853370 R011853371 R011853372 R011853373 R011853374 R011853375 R011853376 R011853377 R011853378 R011853379 R011853380 R011853381 R011853382 R011853383 R011853384 R011853385 R011853386 R011853387 R011853388 R011853389 R011853390 R011853391 R011853392 R011853393 R011853394 R011853395 R011853396 R011853397 R011853398 R011853399 R011853400 R011853401 R011853402 R011853403 R011853404 R011853405 R011853406 R011853407 R011853408 R011853409 R011853410 R011853411 R011853412 R011853413 R011853414 R011853415 R011853416 R011853417 R011853418 R011853419 R011853420 R011853421 R011853422 R011853423 R011853424 R011853425 R011853426 R011853427 R011853428 R011853429 R011853430 R011853431 R011853432 R011853433 R011853434 R011853435 R011853436 R011853437 R011853438 R011853439 R011853440 R011853441 R011853442 R011853443 R011853444 R011853445 R011853446 R011853447 R011853448 R011853449 R011853450 R011853451 R011853452 R011853453 R011853454 R011853455 R011853456 R011853457 R011853458 R011853459 R011853460 R011853461 R011853462 R011853463 R011853464 R011853465 R011853466 R011853467 R011853468 R011853469 R011853470 R011853471 R011853472 R011853473 R011853474 R011853475 R011853476 R011853477 R011853478 R011853479 R011853480 R011853481 R011853482 R011853483 R011853484 R011853485 R011853486 R011853487 R011853488 R011853489 R011853490 R011853491 R011853492 R011853493 R011853494 R011853495 R011853496 R011853497 R011853498 R011853499 R011853500 R011853501 R011853502 R011853503 R011853504 R011853505 R011853506 R011853507 R011853508 R011853509 R011853510 R011853511 R011853512 R011853513 R011853514 R011853515 R011853516 R011853517 R011853518 R011853519 R011853520 R011853521 R011853522 R011853523 R011853524 R011853525 R011853526 R011853527 R011853528 R011853529 R011853530 R011853531 R011853532 R011853533 R011853534 R011853535 R011853536 R011853537 R011853538 R011853539 R011853540 R011853541 R011853542 R011853543 R011853544 R011853545 R011853546 R011853547 R011853548 R011853549 R011853550 R011853551 R011853552 R011853553 R011853554 R011853555 R011853556 R011853557 R011853558 R011853559 R011853560 R011853561 R011853562 R011853563 R011853564 R011853565 R011853566 R011853567 R011853568 R011853569 R011853570 R011853571 R011853572 R011853573 R011853574 R011853575 R011853576 R011853577 R011853578 R011853579 R011853580 R011853581 R011853582 R011853583 R011853584 R011853585 R011853586 R011853587 R011853588 R011853589 R011853590 R011853591 R011853592 R011853593 R011853594 R011853595 R011853596 R011853597 R011853598 R011853599 R011853600 R011853601 R011853602 R011853603 R011853604 R011853605 R011853606 R011853607 R011853608 R011853609 R011853610 R011853611 R011853612 R011853613 R011853614 R011853615 R011853616 R011853617 R011853618 R011853619 R011853620 R011853621 R011853622 R011853623 R011853624 R011853625 R011853626 R011853627 R011853628 R011853629 R011853630 R011853631 R011853632 R011853633 R011853634 R011853635 R011853636 R011853637 R011853638 R011853639 R011853640 R011853641 R011853642 R011853643 R011853644 R011853645 R011853646 R011853647 R011853648 R011853649 R011853650 R011853651 R011853652 R011853653 R011853654 R011853655 R011853656 R011853657 R011853658 R011853659 R011853660 R011853661 R011853662 R011853663 R011853664 R011853665 R011853666 R011853667 R011853668 R011853669 R011853670 R011853671 R011853672 R011853673 R011853674 R011853675 R011853676 R011853677 R011853678 R011853679 R011853680 R011853681 R011853682 R011853683 R011853684 R011853685 R011853686 R011853687 R011853688 R011853689 R011853690 R011853691 R011853692 R011853693 R011853694 R011853695 R011853696 R011853697 R011853698 R011853699 R011853700 R011853701 R011853702 R011853703 R011853704 R011853705 R011853706 R011853707 R011853708 R011853709 R011853710 R011853711 R011853712 R011853713 R011853714 R011853715 R011853716 R011853717 R011853718 R011853719 R011853720 R011853721 R011853722 R011853723 R011853724 R011853725 R011853726 R011853727 R011853728 R011853729 R011853730 R011853731 R011853732 R011853733 R011853734 R011853735 R011853736 R011853737 R011853738 R011853739 R011853740 R011853741 R011853742 R011853743 R011853744 R011853745 R011853746 R011853747 R011853748 R011853749 R011853750 R011853751 R011853752 R011853753 R011853754 R011853755 R011853756 R011853757 R011853758 R011853759 R011853760 R011853761 R011853762 R011853763 R011853764 R011853765 R011853766 R011853767 R011853768 R011853769 R011853770 R011853771 R011853772 R011853773 R011853774 R011853775 R011853776 R011853777 R011853778 R011853779 R011853780 R011853781 R011853782 R011853783 R011853784 R011853785 R011853786 R011853787 R011853788 R011853789 R011853790 R011853791 R011853792 R011853793 R011853794 R011853795 R011853796 R011853797 R011853798 R011853799 R011853800 R011853801 R011853802 R011853803 R011853804 R011853805 R011853806 R011853807 R011853808 R011853809 R011853810 R011853811 R011853812 R011853813 R011853814 R011853815 R011853816 R011853817 R011853818 R011853819 R011853820 R011853821 R011853822 R011853823 R011853824 R011853825 R011853826 R011853827 R011853828 R011853829 R011853830 R011853831 R011853832 R011853833 R011853834 R011853835 R011853836 R011853837 R011853838 R011853839 R011853840 R011853841 R011853842 R011853843 R011853844 R011853845 R011853846 R011853847 R011853848 R011853849 R011853850 R011853851 R011853852 R011853853 R011853854 R011853855 R011853856 R011853857 R011853858 R011853859 R011853860 R011853861 R011853862 R011853863 R011853864 R011853865 R011853866 R011853867 R011853868 R011853869 R011853870 R011853871 R011853872 R011853873 R011853874 R011853875 R011853876 R011853877 R011853878 R011853879 R011853880 R011853881 R011853882 R011853883 R011853884 R011853885 R011853886 R011853887 R011853888 R011853889 R011853890 R011853891 R011853892 R011853893 R011853894 R011853895 R011853896 R011853897 R011853898 R011853899 R011853900 R011853901 R011853902 R011853903 R011853904 R011853905 R011853906 R011853907 R011853908 R011853909 R011853910 R011853911 R011853912 R011853913 R011853914 R011853915 R011853916 R011853917 R011853918 R011853919 R011853920 R011853921 R01185

Lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
6	5030201D2B	Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento anti-aspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2	91805009	3.746.715	0,9	€ 0,899	ZERO/899	€ 3.368.296,785	R011853251 R011853253 R011853254 R011853256 R011853257 R011853258 R011853259 R011853260 R011853261 R011853262 R011853263 R011853264 R011853265 R011853266 R011853267 R011853268 R011853269 R011853270 R011853271 R011853272 R011853273 R011853274 R011853275
7	5030202D9	Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con o senza rivestimento anti-aspirante in TNT. UNI EN ISO 8670-2	91805012	1.573.635	1	€ 0,990	ZERO/990	€ 1.557.898,650	R011853255 R011853256 R011853257 R011853258 R011853259 R011853260 R011853261 R011853262 R011853263 R011853264 R011853265 R011853266 R011853267 R011853268 R011853269 R011853270 R011853271 R011853272 R011853273 R011853274 R011853275
8	50302326C2	Sacca con barriera autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo antiriflusso e sistema di scarico raccordiabile a raccoglitore da gamba o da letto. UNI EN ISO 8670-2	91807003	599.049	3,25	€ 3,240	TRE/240	€ 1.940.918,760	R011853230 R011853231 R011853232 R011853233 R011853234 R011853235 R011853236 R011853237 R011853238 R011853239 R011853240 R011853241 R011853242 R011853243 R011853244 R011853245 R011853246 R011853247 R011853248
9	5030243FD3	sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antiriflusso e sistema di scarico raccordiabile a raccoglitore da gamba o da letto. UNI EN ISO 8669-2	91807006	33.750	3,9	€ 3,890	TRE/890	€ 131.287,500	R011853067 R011853068 R011853069 R011853100
10	50302548E9	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cerniera di sicurezza.	91808003	117.765	2,35				
11	503026954B	Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi.	91808006	11.655	5,5				
12	5030279D89	Sacca di raccolta con flangia con o senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo antiriflusso e sistema di scarico raccordiabile a raccoglitore da gamba o da letto. (Standard ISO 8669)	91808009	1.303.080	1,35	€ 1,340	UNO/340	€ 1.746.127,200	R011853274 R011853275
13	503038335F	Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza placche e sacca di scarico. (Standard Liv. 1)	91824003	2.253	33,2				

Lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
14	5030400167	Irrigatore semplice composto da: borsa graduata per l'acqua, cono e cannula, sistema di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. (Standard Liv. 1) (Alternativo al cod. 09.18.24.003)	91824004	1.353	17,2				
15	5030417F6A	Sacca di scario trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia. (standard Liv. 1)	91824009	185.055	0,98				
16	50304277AD	Saccola a fondo chiuso con filtro, unidirezionale e supportata adesivo microporoso ipoallergenico a barriera autoportante, con o senza rivestimento antiaspirante in TNT, con o senza cittera. (Standard 8670)	91824012	9.345	0,88				
17	5030437FEB	Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente. (Standard 8670)	91824015	44.754	1,15				
18	503044675B	Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. (Standard ISO Liv. 1)	91824018	18.420	2,25				
19	5030456F99	Cono anatomico e cannula da irrigazione.	91824101	1.287	4,4				
20	50304678AF	Pasta protettiva per la pelle peristomiale. (4)	91830003	100.479	6	€ 1.000	UNO/000	€ 100.479,000	R011853700
21	503047601F	Polvere o film protettivo per zone peristomiali (4)	91830006	75.620	9	€ 0,800	ZERO/800	€ 61.296,000	W65-050
22	503048685D	Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo e gelificante, in confezione singola sterile: formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 10x10	92112003	309.159	1,8				
23	5030494EFS	Bendaggio flessibile autoadesivo, idroattivo e gelificante, in confezione singola sterile: formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm. 20X20	92112006	37.590	6,8				
24	503050580B	Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo e gelificante, in confezione singola sterile: formato sgonfiato con una superficie totale flessibile idroattiva con inferiore a 60cm2	92112009	24.579	3,11				
25	503052046D	Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo e gelificante, in confezione singola sterile: formato sgonfiato con una superficie totale flessibile idroattiva non inferiore a 120cm2	92112012	21.048	8,2				
26	5030531D7E	Pasta gel (100 g) o idrogel (50 g) atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con altri ausili di cui al codice 09.21.12	92118003	26.943	3,8				
27	5030561642	Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente a 2 vie con scanalature longitudinali, con imbuto a valvola speciale. (UNE EN 1616)	92403003	445.929	9,5	€ 9,490	NOVE/490	€ 4.231.856,210	850086-000100 850086-000120 850086-000140 850086-000160 850086-000180 850086-000200 850086-000220 850086-000240 851086-000140 851086-000160 851086-000180 851086-000200



TELEFLEX MEDICAL s.r.l.
Procuratore
DAVIDE BRAMBILLA
Davide Brambilla

Lotto	GIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
28	503057302B	Caterete tipo Nelaton, monouso, in PVC, ipodallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616). Per donna e bambino.	92406003	457.551	0,23	€ 0,229	ZERO/229	€ 104.779,179	RO3S850160/08
									RO3S850160/10
									RO3S850160/12
									RO3S850160/14
29	503057844A	Caterete tipo Nelaton, monouso, in PVC, ipodallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616). Per uomo.	92406006	524.454	0,23	€ 0,229	ZERO/229	€ 120.099,966	RO3S850162/06
									RO3S850162/08
									RO3S850162/10
									RO3S850162/12
30	503058493C	Caterete monouso, autolubrificante, in materiale ipodallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per neonati fino a 1 anno.	92406009	48.915	1,51				RO3S850162/16
									RO3S850162/18
									RO3S850162/20
									RO3S850162/22
31	5030591F01	Caterete monouso, autolubrificante, in materiale ipodallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per bambino fino a 6 anni.	92406010	112.200	1,51	€ 1,509	UNO/509	€ 169.309,800	851131-000680
									851131-000680
									851131-000100
									851132-000680
32	50306038EA	Caterete monouso, autolubrificante, in materiale ipodallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per donna e bambino oltre i 6 anni	92406011	1.703.973	1,6	€ 1,599	UNO/599	€ 2.724.652,827	851121-000680
									851121-000100
									851121-000140
									851122-000100
									851122-000170
									851122-000140
									851122-000160
									851121-000680
									851121-000100
									851121-000100
									851121-000140
									851121-000140

TELEFLEX MEDICAL s.r.l.

Procuratore

DAVIDE BRAMBILLA

lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
33	5030611F82	Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipocitergenico, trasparente, a varia lunghezza e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. (UNI EN 1616) Per uomo.	92406012	2.924.643	1,6	€ 1,599	UNO/599	€ 4.676.504,157	850218-000010 850218-000012 850218-000014 851141-000060 851141-000100 851141-000120 851141-000140 851141-000160 851141-000180 851142-000080 851142-000100 851142-000120 851142-000140 851142-000160 851142-000180 851143-000120 851143-000140 851143-000160 851143-000180 851241-000080 851241-000100 851241-000120 851241-000140 851241-000160 851241-000180


TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
 Procuratore
 DAVIDE BRAMBILLA
David Brambilla

Lotto	Q6	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
34		Cateteri monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, non necessitante dell'uso del gel lubrificante, integrato in una sacca graduata, in confezione singola sterile, (UNI EN 1616)	92406015	278.967	4	€ 3,990	TRE/990	€ 1.113.078,330	5000125 CH 12 5000146 CH 14 5000166 CH 16 5002106 CH 10 5400106 CH 10 5400126 CH 12 5400146 CH 14 620012 CH 12 620014 CH 14 670016 CH 16 620210 CH 10 851621-000090 851621-000120 851621-000140 851622-000160 851622-000180 851622-000100 851622-000120 851622-000140 851622-000160 851631-000080 851631-000100 851632-000080 851632-000100 851641-000080 851641-000120 851641-000140 851641-000160 851641-000180 851642-000080 851642-000100 851642-000120 851642-000140 851642-000160 851642-000180
35	50306152D3	Cateteri/funone per ureteroconoscimento in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio, due alince per il bloccaggio del disco di fissaggio. (pr EN 12182)	92406018	72.708	28	€ 27,990	VENTISETTE/990	€ 2.035.096,920	850270-000035 850270-000042 850271-000035 850271-000042 850275-000035 850275-000042 850276-000035 850276-000042 850281-000080 850281-000100 850281-000120 850281-000140 850281-000160
36	50306217C5	Spray lubrificante al silicone per cateterismo (pr EN 12182)	92118006	4.806	6	€ 5,990	CINQUE/990	€ 28.787,940	850699

TELEFLEX MEDICAL s.r.l.
 Procuratore
 DAVIDE BRAMBILLA
David Brambilla

TELEFLEX MEDICAL SRL
 Viao Torino 5
 20814 Varedo (MI)

Lotto	CIG	Descrizione prodotto	Codice ISO	Fabbisogno Triennale	Prezzo unitario a base d'asta	Prezzo unitario offerto (in cifre)	Prezzo unitario offerto (in lettere)	Totale (fabbisogno x prezzo unitario offerto)	Codice prodotto
37	5030640773	Catetere (condom) in gomma naturale e sintetica, ipoallergenica, autocollante o con striscia biadesiva. (Pr-EN 12182)	92409003	1.428.417	0,87	€ 0,868	ZERO/868	€ 1.239.865,956	854410-000100 854410-000250 854410-000300 854410-000350 854410-000400 854460-000300 854460-000350 854460-000400 854460-000450 854460-000500 854460-000550 854460-000600 854460-000650 854460-000700 854460-000750 854460-000800 854460-000850 854460-000900 854460-000950 854460-001000 854460-001050 854460-001100 854460-001150 854460-001200 854460-001250 854460-001300 854460-001350 854460-001400 854460-001450 854460-001500 854460-001550 854460-001600 854460-001650 854460-001700 854460-001750 854460-001800 854460-001850 854460-001900 854460-001950 854460-002000
38	5030649EDE	Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisidabordo, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antiriversione. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo manouso.	92704003	1.501.290	0,32	€ 0,310	ZERO/310	€ 465.399,900	850330-000000 850331-000000 850332-000000 850333-000000 850334-000000 850335-000000 850336-000000 850337-000000 850338-000000 850339-000000 850340-000000 850341-000000 850342-000000 850343-000000 850344-000000 850345-000000 850346-000000 850347-000000 850348-000000 850349-000000 850350-000000 850351-000000 850352-000000 850353-000000 850354-000000 850355-000000 850356-000000 850357-000000 850358-000000 850359-000000 850360-000000
39	50306618C7	Sacca di raccolta per urina da gamba, impermeabile, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antireflusso, con sistema antisidabordo, con o senza rivestimento in TNT, con o senza sistema antiriversione. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo riutilizzabile.	92704006	62.046	1,4	€ 1,390	UNO/390	€ 86.243,940	850352-000000 850354-000000
40	5030666CE6	Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo manouso.	92707003	12.566.475	0,2	€ 0,198	ZERO/198	€ 2.488.162,050	850415-000000 850416-000000
41	503067110A	Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del volume prestampato. (UNI EE ISO 8669-2) Tipo riutilizzabile.	92707006	652.206	2	€ 1,990	UNO/990	€ 1.297.889,940	850401-000000 850407-000000 850412-000000 850414-000000 850418-000000 850419-000000



TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
 Procuratore
 DAVIDE BRAMBILLA
David Brambilla

DETERMINAZIONE n. 85 del 17 settembre 2013

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito – parziale annullamento e nuova aggiudicazione.

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24/12/2003, tra l'altro,

• il comma 13, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";

• il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006";

ATTESO

- che con determinazione n. 24 del 27 marzo 2013 veniva indetta la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro di durata annuale con più operatori economici finalizzato alla fornitura triennale alle AA.SS. della Regione Campania di "dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito" per un importo presunto di €.45.499.625,68 con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.vo 163/2006;
- che con provvedimento n. U008461 del 10/07/2013 la Soresa disponeva l'esclusione della Ditta De Rosa dalla gara per riscontrata irregolarità del Duro;

VISTO

- il successivo ricorso presentato dalla ditta De Rosa nei confronti della Soresa Spa per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del prefato provvedimento;
- il decreto del 25/07/2013 n. 1230/2013 TAR Campania Sezione prima che disponeva l'ammissione con riserva dell'operatore economico De Rosa S.r.l. alla procedura di gara;

RILEVATO

- che il seggio di gara, in esecuzione al suddetto decreto, riammetteva provvisoriamente alla procedura di gara l'operatore economico De Rosa;
- che con determinazione n. 77 del 26 agosto 2013, veniva concluso l'Accordo con gli operatori economici, per i prodotti ed ai prezzi riportati nella "Graduatoria di merito e prospetto prodotti aggiudicati" allegata alla determinazione;
- che a seguito della predetta determinazione anche la ditta De Rosa risultava aggiudicataria della fornitura di taluni dei prodotti oggetto dell' Accordo Quadro;

PRESO ATTO che con ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1370/2013 Reg. prov.cau. dell' 11/09/2013 è stata respinta la domanda cautelare della ditta De Rosa;

RITENUTO, necessario, a seguito del prefato provvedimento:

- escludere la ditta De Rosa, e per effetto, annullare, limitatamente all'aggiudicazione di suddetta ditta, la determinazione n. 77 del 26.09.2013;
- ridefinire di conseguenza la Graduatoria di merito ed i prodotti aggiudicati, come da allegato prospetto.

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2013


DETERMINA

Per i motivi citati in premessa, di:

- prendere atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1370/2013 Reg. prov. cau. dell' 11/09/2013;
- escludere la ditta De Rosa dalla procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro per la fornitura di dispositivi per stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito;
- procedere al parziale annullamento della aggiudicazione disposta con determina n. 77 del 26 agosto 2013;
- procedere a nuova aggiudicazione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs 163/2006 e rideterminare la graduatoria di merito degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro come da prospetto "Nuova Graduatoria di merito e prospetto prodotti aggiudicati", allegato al presente provvedimento.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Avv. Francesco D'Ercole



4

ALLEGATO DETERMINAZIONE n. 85 del 17/09/2013

"Nuova Graduatoria di merito e prospetto prodotti aggiudicati"

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di Stomie, dispositivi per incontinenza a raccolta e medicazioni per piaghe da decubito

(*) posizione determinata a seguito di sorteggio

Lotto	Graduatoria Aggiudicatari	Prezzo Aggiudicazione	Prodotti Aggiudicati
1	1° B. Braun	€ 1,430	ALMARYS PROTECT CHIUSA: F027610F,F027010F,F027625F, F027630F,F027635F,F027640F, F027645F,F027650F,F027660F ALMARYS PREFERENCE CHIUSA: F008310F,F008325F,F008330F,F008335F,F008340F,F008345F,F008350F ALMARYS OPTIMA CHIUSA: F018610F,F008610F,F008625F, F008630F,F008635F,F008640F, F008645, F008650F, F008660F ALMARYS QUIET CHIUSA: F018110F,F008110F,F008125F, F008130F,F008135F,F008140F, F008145F,F008150F,F008160F CRYNALIS CHIUSA: F01815F,F01825F,F01830F, F01835F,F01840F,F01845F, F01850F,F01860F, F12815F, F02825F,F02830F,F02835F,F02840F,F02845F,F02850F,F02860F FLEXIMA: 044015F,044025F,044030F, 044035F, 044040F,044045F,044115F FLEXIMA ACTIVE midi: 4610115F,4610125F,4610130F,4610135F,4610140F,4610145F,4611115F,4610215F, FLEXIMA ACTIVE Maxi: 4610380F,4611380F, FLEXIMA MINI: 044215F,44212F, FLEXIMA MAXI: 044070F,044170F INTEGRALE: F72520F,F02525F,F02530F, F02535F,F02540F,F02545,F02550F,F02560F,F02570F
	2° Convatec	€ 1,596	COLODRESS PLUS: 9156,9158,9160,9162,9164,9166, 9168,9170,9172,9174; COLODRESS PLUS MINI: 9000,9001,9002; Esteem [®] +: 4167XX; ESTEEM MEDIO E GRANDE: 4047XX
	3° Teleflex	€1,5970	SACCA COLO 99 OVALE: R0118530X0; SACCA ANGEL : R01185314X; SACCA FLAIR EXTRA: R01185309X; SACCA IDEAL PLUS: R01185302X ; SACCA IDEAL PLUS MINI: R01185303X;
	4° Coloplast	€1,5990	ALTERNA MIO SISTEMA A 1 PEZZO: 463XX; ALTERNA SISTEMA A 1 PEZZO: 57XX,56XX; SENSURA A 1 PEZZO CON APERTURA ISPEZIONABILE: 1502XX, 150300,150310; SENSURA A 1 PEZZO: 154XX; SENSURA MIO A 1 PEZZO CON APERTURA ISPEZIONABILE: 108XXX;
2	1° B. Braun	€ 1,430	ALMARYS OPTIMA: F018710F,F008710F,F019510F, F009510F,F009525F,F009530F, F009535F,F009540F,F009545F, F009550F,F009560F; CRYNALIS APERTO: F12915F,F02925F,F02930F,F02935F, F02940F,F02945F; DRAINAS: H08560F, H28556F, H28555F,H28566F; FLEXIMA: 044815F,044715F,044725F,044730F, 044735F,044740F, 04415F, 044515F, 044425F,044430F,044435F, 044440F,042715F, 042815F, 042725F, 042730F,042735F,042740F FLEXIMA ACTIVE: 4620115F,4620125F,4620130F, 4620135F,4620140F,4621115F; FLEXIMA ACTIVE: 4620115F,4620125F,4620130F, 4620135F,4620140F,4621115F;
	2° Convatec	€ 1,700	ESTEEM A FONDO APERTO: 405836,405843,405850; ESTEEM InvisiClose: 411203,411204;

			ESTEEM+: 416718,416719,416721; ESTEEM+ SET POST OP: 416915 ILEODRESS PLUS: 9189; ILEODRESS: 6406,6409; SACCA MONOPEZZO A FONDO APERTO: 9400; STOMADRESS POST-OP: 9472; SACCA MONOPEZZO EXTRA SMALL A FONDO APERT CON CHIUSURA INVISICLOSE: 411633;
	3° Hollister (*)	€ 1,790	MODERMA FLEX CON LOCK'N ROLL: 28500,28100,282XX; MODERMA FLEX CON MORSETTO: 26200,26500; MODERMA FLEX MAXI OVAL CON LOCK'N ROLL: 28401,28301; COMPACT: 325X; DANSAC SOLO: 324-10, 315-15 ; (**) DANSAC NOVA LIFE 1 APERTA: 92XX-10, 9162-10; DANSAC NOVA 1: 823-15,824-15 DANSAC NOVA 1 Simmetrico/FoldUp/Asimmetrico: 813-15,814-15 (**) DANSAC NOVA 1 D INFANT: 818-10; (**) MODERNA FLEX POST-OP:20070,20110; HOLLISTER KARAYA: 322X ;
	4° Teleflex (*)	€ 1,790	SACCA FLAIR ANGEL ILEO: R01185329X; SACCA ILEO 99: R011853160, R011853164; SACCA ILEO 99 OVALE: R0118531X0; SACCA IDEAL PLUS ILEO: R01185321X; SACCA PEDIATRIC 99 ILEO OVALE: R011853179; SACCA ILEO 99 MINI: R011853200; POST-OP 99 ILEO:R011853190 ;
	5° Coloplast	€ 1,798	ALTERNA SISTEMA A 1 PEZZO: 58XX,5975,5985,8002; ALTERNA MIO SISTEMA A 1 PEZZO: 138XX; SENSURA A 1 PEZZO CON APERTURA ISPEZIONABILE: 152510,152810; SENSURA A 1 PEZZO: 155XX; SENSURA A 1 PEZZO CON APERTURA ISPEZIONABILE CONVEX LIGHT: 150610, 150710;(**)
3	1° B. Braun	€ 4,089	FLEXIMA: 440XXF,428XXF, 447XXF,448XXF, 427XXF;
	2° Convatec (*)	€ 4,090	Esteem [®] convesso con InvisiClose: 4116XX; ESTEEM +: 4167XX;
	3° Coloplast (*)	€ 4,090	SENSURA 1 PEZZO CONVEX LITE PER COL.: 1540X; SENSURA A 1 PEZZO PER ILEO: 155XX,15205,15206; ALTERNA MIO CONVESSO 1 PEZZO PER COL.: 140XX; ALTERNA MIO CONVEX LITE 1 PEZZO PER ILEO CON HIDE-AWAY: 141XX;
	4° Teleflex (*)	€ 4,090	SACCA CURVEX : R0118530XX; SACCA CONVEX: R0118533XX;
4	1° B. Braun	€ 2,340	FLEXIMA KEY: 620XXF; ALMARYS TWIN PLUS: 036240F,036250F,036260F,036280F; BIO LOCKRING placca: F34XXXF;
	2° Coloplast	€ 2,493	SENSURA CLICK 2 PEZZI PLACCA: 100XX ; EASIFLEX PLACCA : 143XX; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI: 283XX; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI MIO PRO: 131XX;
	3° Teleflex	€ 2,495	PLACCA PIANA PER COLO STOMIA ED ILEOSTOMIA PER SISTEMA A DUE PEZZI MODELLO FLAIR 2: R011PPX5-XXXX, R011PP70-70RT; PLACCA PER COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA PER SISTEMA A DUE PEZZI MODELLO SECURE: R01185324X; PLACCA PER COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA PER SISTEMA A DUE PEZZI MODELLO SECURE MICRO COLO e ILEO: R011853249-R011853250;

	4° Convatec	€ 2,495	<p>CONSECURA E CONSECURA PLACCA ULTRA: 85XX; Esteem synergy: 405484,405485,405486,405487, 409265,409266,409267,409294, 409295,409296,416984,416985, 416986; Placca con Aggancio Adesivo: 411642; Natura +: 401906,401948,401949,401950, 401951,401980,401981,401982, 401983,901984,411809,411811, 411813,411815,413100,413101, 413102,413103,413104, 420219; Placca con flangia e barriera Protetiva idrocolloidale: 8504,8505; SISTEMA 2°S PLUS: 9401,9402,9403,9404,9406; SISTEMA 2°S: 9407, 9408, 9409, 9410,9411,411825,411827,411829, 411831; SISTEMA 2°S ULTRA: 9412,9413,9414,9415,9416;</p>
5	1° (*) Coloplast	€ 5,190	<p>SENSURA CLICK 2 PEZZI: 100XX,110XX; EASI FLEX PLACCA:14401,14403,14601,14603; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI PLACCA MIO PRO: 142XX, 127XX; SENSURA CLICK XPRO: 110XX;</p>
	2° (*) Convatec	€ 5,190	<p>Esteem synergy: 40927X; SISTEMA 2°S: 85XX; 86XX; 94XX; 41145X; Natura+: 1252XX;42023X;</p>
	3° (*) Teleflex	€ 5,190	<p>PLACCHE CONVESSA PER COLOSTOMIA ED ILEOSTOMIA PE SISTEMA A 2 PEZZI MODELLO "FLAIR 2": R011PC45-25RT, R011PC55-35XX, R011PC70-48RT</p>
	4° (*) B.Braun	€ 5,190	<p>FLEXIMA KEY: 620XX; ALMARYS TWIN PLUS: 0363XXF;</p>
6	1° B.Braun	€ 0,868	<p>FLEXIMA KEY : 62140F,62150F,62160F,62180F; ALMARYS TWIN PLUS: 037240F,037250F,037260F,037280F; BIO LOCKRING sacca: F34535F, F34550F,F34635F,F34650F,F34575F,</p>
	2° (*) Convatec	€ 0,898	<p>CONSECURA: 8560,8561,8562,8563,8564,8565, 8566, 8567; ESTEEM synergy: 405436,405437,405438,405439, 405440,409240,409241, 409242; ESTEEM synergy*+: 416774,416775,416778,416779, 416782,416783; Natura*+:416400,416401,416403, 416404,416406,416407,416409, 416410,416412,416413; SISTEMA 2°S: 8512,8513,8514,8515,8516,8517, 8518, 8519,8520,8521,8522; Sacca con aggancio adesivo a fondo chiuso: 411639</p>
	3° (*) Coloplast	€ 0,898	<p>SENSURA CLICK 2 PEZZI SACCA CHIUSA: 101XX; EASI FLEX SACCA CHIUSA: 143XX; ALTERNA MIO SISTEMA 2 PEZZI: 464XX; ALTERNA SISTEMA 2 PEZZI: 16XX,1785,1786;</p>
	4° Teleflex	€ 0,899	<p>SACCA PER COLOSTOMIA SISTEMA A 2 PEZZI MODELLO "SECURE COLO SACCA ": R011853251, R011853252, R011853254, R011853253</p>
7	1° B.Braun	€ 0,868	<p>FLEXIMA KEY: 621241F,621251F,621261F,621281F, 621253F,62340F,62350F,62360F, 62550F,62560F,621240F,621250F, 621260F,621280F,62680F,62450F, 62460F, ALMARYS TWIN PLUS: 038740F,038750F,038760F,038840F, 038850F,038860F,037740F,037750F, 037760F,037780F,037880F BIO LOCKRING sacca: F34735F,F34750F,F34835F,F34850F, F34775F, F34975F,F34775F</p>
	2° Convatec	€ 0,900	<p>CONSECURA: 8572,8573,8574,8575,8577,8578, 8579,8580; ESTEEM synergy +: 416795,416796,416798,416799, 416901,416902; Sacca con aggancio adesivo a fondo aperto con chiusura InvisiClose: 411637; SISTEMA 2°S: 8523,8524,8525,8526,8527,8528, 8529,8530,8531,8532,8533,411384,411385,411386,411387,411388, 411394,411395,411396,411397, 411398,411399,411400,411401, 411402,411403; SISTEMA 2°S MINI: 8534,8535,8536,8537; ESTEEM synergy: 405404,405405,405406,409201, 409212, 409213,</p>

			413340,413341,413342,413352, 413353,413354,413358,413359; Natura®+: 416415,416416,416417,416419,416420,416422,417423,416472;
	3° (*) Hollister	€ 0,990	CONFORM 2: 23750,24750,25750,23760,24760,25760,27760,24860,25860,27860; CONFORM 2 MINI: 24743,25743; CONFORM 2 MAXI: 27600; CONFORM 2 CON MORSETTO DI CHIUSURA: 23720, 24720, 25720, 23820,24820,25820;; CONFORM 2 POST-OP: 38255,38270,38200; POUCHKINS:3799; TANDEM: 380X; DANSAC NOVA LIFE 2 APERTA: 13152-XX,13162-XX, 13212-XX, 13222-XX; DANSAC NOVA 2 APERTA: 1215-XX, 1216-XX ;
	4° (*) Teleflex	€ 0,990	SACCA PER ILEOSTOMIA SISTEMA A 2 PEZZI MODELLO "SECURE ILEO SACCA": R011853255, R011853256, R011853257, R011853258; SACCA PER ILEOSTOMIA SISTEMA A 2 PEZZI MODELLO "FLAIR 2": R011SOXX-ILEO, R011SOXX-IMAX, R011STXX-ILEO;
	5° Coloplast	€ 0,998	SENSURA CLICK 2 PEZZI: 103XXX; EASIFLEX SACCA APERTA: 143XX; EASIFLEX SACCA PEDIATRICA: 14681,14682; ALterna MIO SISTEMA A 2 PEZZI: 139XX; ALterna SISTEMA A 2 PEZZI: 16XX,1782;
8	1° (*) Teleflex	€ 3,240	SACCA PER UROSTOMIA MONOPEZZO MODELLO "IDEALURO": R01185323X SACCA MONOPEZZO "FLAIR ACTIVE" UROSTOMIA: R01185343X;
	2° (*) Coloplast	€ 3,240	SENSURA SACCA: 118XX; ALterna MIO CON MULTICHAMBER: 14221,14222; ALterna SISTEMA A 1 PEZZO: 5575,5585; ALterna SISTEMA A 1 PEZZO LINEA PEDIATRICA: 8009;
	3° (*) B.Braun	€ 3,240	FLEXIMA URO SILK: 044913F FLEXIMA URO: 044912F
	4° (*) Convatec	€ 3,240	Esteem® Uro: 401232,401233,401234,401235; URODRESS: 9207,9208,9209,9210,9211;
9	1° (*) B.Braun	€ 3,890	FLEXIMA URO SILK: 44917F
	2° (*) Hollister	€ 3,890	MODERMA FLEX CONVEX: 29201,293XX; MODERMA FLEX CONVEX CON ADESIVO: 29600,297XX; COMPACT CONVEX: 145X; DANSAC NOVA 1 X3: 891-12, 892-XX; DANSAC NOVA 1CONVEX:894-XX
	3° (*) Teleflex	€ 3,890	SACCA CURVEX URO: R0111853097,R0111853098,R0111853099, R011185309100;
	4° Coloplast	€ 3,898	SENSURA SACCA: 118XX; ALterna SISTEMA A 1 PEZZO: 1299X;
10	1° B.Braun	€ 2,340	FLEXIMA KEY: 62040F,62050F,62060F,62080F, ALMARYS TWIN PLUS: 036240F,036250F, 036260F BIO LOCKRING placca: F34035F,F34050F,F34235F,F34250F
	2° (*) Convatec	€ 2,345	CONSECURA: 8556,8557,8558,8559; CONSECURA PLACCA ULTRA: 8552,8554,8555; Esteem synergy: 405484,405485,405486,405487, 4092665,409266,409267,409294, 409295,409296,416984,416985, 416986; Placca con Aggancio Adesivo: 411642; Natura +: 401906,401948,401949,401950, 401951,401980,401981,401982, 401983,901984,411809,411811, 411813,411815,413100,413101, 413102,413103,413104, 420219; Placca con flangia e barriera Protettiva idrocolloidale: 8504,8505;

			SISTEMA 2°S PLUS: 9401,9402,9403,9404,9406; SISTEMA 2°S: 9407, 9408, 9409, 9410,9411,411825,411827,411829, 411831; SISTEMA 2°S ULTRA: 9412,9413,9414,9415,9416;
	3° (*) Coloplast	€ 2,345	SENSURA CLICK SISTEMA A 2 PEZZI: 100XX; EASI FLEX PLACCA: 143XX; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI: 131XX,142XX; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI: 28310,28320,28330,14243,14246,14249; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI LINEA PEDIATRICA:8110;
11	1° B.Braun	€ 5,190	FLEXIMA KEY: 62052F,62062F,62063F ALMARYS TWIN PLUS: 036355F, 036365F
	2° Coloplast	€ 5,480	SENSURA CLICK SISTEMA A 2 PEZZI: 110XX; SENSURA CLICK XPRO: 110XX; EASI FLEX PLACCA: 144XX, 14601,14603; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI: 142XX, 127XX;
	3° Convatec	€ 5,490	SISTEMA 2°S: 8506,8507,8508,8509,8510,8511, 8605,8606,9458,9459,9460,9461, 411452,411453,411454; Natura+: 125278,125280,125281,125282, 125283,125284,125285,125286, 125287,125288,125289,420233,420234,420235,125279
12	1° Convatec	€ 1,200	CONSECURA: 8581,8582,8583,8584; Esteem synergy: 405446,405447,405448,405449, 405450,405451,405452,405453; Sacca con flangia per urostomia: 8502,8503; SISTEMA 2°S MINI: 8545,8546,8547; SISTEMA 2°S: 8539,8540,8541,8542,8543,400988,400989,400990,400991,402553, 402554,402555,402556;
	2° (*) Hollister	€ 1,340	DANSAC NOVA 2 URO: 1218-XX; CONFORM 2: 23830,24830,25830,27830; TANDEM: 390X;
	3° (*) Teleflex	€ 1,340	SECURE URO SACCA: R011853274; R011853275;
	4° (*) B.Braun	€ 1,340	FLEXIMA KEY URO: 62840F, 62850F,62860F, ALMARYS TWIN PLUS: 037940F,037950F,037960F BIO LOCKRING sacca uro: F34935F,F34950F,
	5° Coloplast	€ 1,348	SENSURA CLICK 2 PEZZI: 118XX; EASI FLEX SACCA CON MULTI CHAMBER: 14553,14555,14552,14554; ALTERNA MIO SISTEMA A 2 PEZZI CON MULTICHAMBER: 142XX; ALTERNA MIO MINICAP: 28070,28080; ALTERNA SISTEMA A 2 PEZZI: 175X, 1789;
13	1° B.Braun	€ 31,500	IRYFLEX TM SET: 60251F
	2° Hollister	€ 33,190	DANSAC SET IRRIGAZIONE CONO + CANNULA : 900-20,900-35;
	3° Coloplast	€ 33,198	SET DI IRRIGAZIONE ALTERNA: 12830
14	1° Convatec	€ 16,500	IRRIGATORE VISI-FLOW: 9051
	2° Hollister	€ 17,190	HOLLISTER KIT D'IRRIGAZIONE: 7718
15	1° Convatec	€ 0,900	IRIDRESS: 9219
	2° (*) B.Braun	€ 0,970	MANICOTTI: 60630F
	3° (*) Hollister	€ 0,970	MINI CAP: 7728,7724; DANSAC SACCHE DI SCARICO:950-20,950-35;
	4° Coloplast	€ 0,978	SACCHE SCARICO DI IRRIGAZIONE: 1003,12834,12835,12836
17	1° Convatec	€ 1,000	STOMADRESS PLUS: 9232

	2° (*) B. Braun	€ 1,140	PETITE: F00015F
	3° (*) Hollister	€ 1,140	HOLLISTER MINI CAP: 3184, 3186; DANSAC NOVA 1 MINI CAP: 829-XX;
	4° Coloplast	€ 1,147	MINICAP ALTERNA: 5876
18	1° Coloplast	€ 2,247	CONSEAL SISTEMA A 1 PEZZO: 14XX; PERISTEEN ANAL PLUG: 1450,1451;
19	1° Convatec	€ 4,000	Cono di ricambio: 9055
	2° (*) B. Braun	€ 4,390	CONO : F05062F, F05068F
	3° (*) Hollister	€ 4,390	DANSAC SET IRRIGAZIONE CONO + CANNULA: 95205; CONNETTORE DI IRRIGAZIONE: 7723;
	4° Coloplast	€ 4,398	CONO PER IRRIGAZIONE: 1110
20	1° Teleflex	€ 1,000	HYDROFRAME : R011853700;
	2° BSN	€ 4,500	CUTIMED PROTECT CREMA: 726520000300;
	3° Convatec	€ 4,800	Stomahesive Pasta: 7598
	4° B. Braun	€ 4,850	SUPER FILLER PASTA PROTETTIVA: F05008F
	5° Hollister	€ 5,990	ADAPT BARRIER STRIPS: 79400; ADAPT RING : 7805, 7806; ADAPT BARRIER RING: 795XX DANSAC SOFT PASTE: 77550 ADAPT PASTE: 79300; KARAYA PASTE: 7910;
	6° Coloplast	€ 5,997	PASTA PROTETTIVA RIEMPITIVA: 2650; PASTA IN STRISCE: 2655;
21	1° Teleflex	€ 0,800	FILM BARRIERA IN SALVIETTE: WBF-050
	2° BSN	€ 5,000	CUTIMED PROTECT FILM SPRAY: 726530000101;
	3° B. Braun	€ 7,500	ASKINA BARRIER SWAP: 4000105F; ASKINA BARRIER FILM: 4002801F;
	4° Hollister	€ 8,990	HOLLISTER SKIN GEL: 7917; ADAPT STOMIA POWDER: 7906;
	5° Coloplast	€ 8,997	SPRAY BRAVA: 12020; SALVIETTE BRAVA: 12021; POLVERE BRAVA: 01907;
22	1° Eurofarm	€ 0,893	EURODERM FOAM PLUS: 893110;
	2° Sofar	€ 1,290	SORFADRESS 16x16: 10000162
	3° MOLNLYCKE	€ 1,400	MEPILEX: 294100; MEPILEX LITE : 284100;
	4° Svas	€ 1,700	PHARMACOLL : COLL100100
	5° B. Braun	€ 1,790	ASKINA DRESSIL: 5395210F, 5391010F, 5391510F, ASKINA FOAM BORDER: 7231610F SKINA TRANSORBENT: 0072789UF, 0072710CF ASKINA HYDRO: F72041F, F72042F ASKINA BIOFILM TRANSPARENT: F72090, ASKINA DRESSIL: 5291005F, ASKINA DRESSIL SACRUM: 5491605F,
	6° Coloplast	€ 1,799	BIATAIN SCHIUMA ADESIVA (12,5X12,5 e 15x15) : 3420,3421; CONFEEEL BIANCO: 3200,3201;
23	1° Eurofarm	€ 2,683	EURODERM FOAM PLUS: 893120;
	2° (*)	€ 6,200	ASKINA DRESSIL: 5292005F

	B.Braun		ASKINA FOAM BORDER 26 X 26 ASKINA TRANSORBENT: 0072791WF, 007272EF, ASKINA HYDRO: F72047F ASKINA BIOFILM TRANSPARENT: F72092F; ASKINA DRESSIL BORDER: 5392005F
	3° (*) BSN	€ 6,200	CUTIMED SILTEC B 22,5X 22,5: 7263100004;
	4° Svas	€ 6,450	PHARMACOLL : COLL100200,COLL150150,COLL200200;
	5° MOLNLYCKE	€ 6,500	MEPILEX: 294400;
	6° Coloplast	€ 6,730	CONFEEEL BIANCO: 3200,3201; BIATAIN ADESIVO: 3423
	7° Convatec	€ 6,750	VERSIVA XC: 410615; AQUACEL Foam: 420623,420636 ; DUODERM Signal: 403328; COMBIDERM: 9270; DUODERM CGF:9187; DUODERM CGF CON BORDO ADESIVO: 9083;
24	1° Svas	€ 3,050	PHARMACOLL : COLL180165
	2° Coloplast	€ 3,100	BIATAIN SACRO 17x17 : 3483 COMFEEL CONTOUR: 3280
25	1° Sofar	€ 4,800	SOFARDRESS SACRALE 18X20: 10000253
	2° MOLNLYCKE	€ 6,000	MEPILEX HEEL: 288100,288300 ; MEPILEX SACRUM:282000
	3° BSN	€ 6,200	CUTIMED SILTEC SACRUM: 726470000100;
	4° B.Braun	€ 7,500	ASKINA FOAM SACRUM: 7228205F ASKINA TRANSORBENT SACRUM: 0072792XF ASKINA HEEL: 7240105F, 7240210F
	5° (*) Svas	€ 7,700	PHARMACOLL SACRALE: COLL220220
	6° (*) Convatec	€ 7,700	VERSIVA XC: 410612,410613; AQUACEL Foam: 420625,420626; DUODERM Signal: 410500,410501; COMBIDERM: 9273; DUODERM CGF CON BORDO ADESIVO: 9085;
	7° Coloplast	8,168	BIATAIN SACRO 23x23: 3485; BIATAIN TALLONE 19x20: 3488; COMFEEL CONTOUR: 3283
26	1° Covidien	€ 0,850	IDROGEL AMORFO KENDAL: 9251
	2° Coloplast	€ 1,8496	PURILON GEL : 3900,3903
	3° Eurofarm	€ 1,950	HYDROMED GEL : 501715
	4° B.Braun	€ 2,500	ASKINA GEL (TUBO DA 15 grammi): 0014195F
	5° Convatec	€ 3,000	DUODERM IDROGEL :9225; DUODERM PASTA: 9184;
	6° BSN	€ 3,500	CUTIMED GEL : 726100000201
27	1° Clinilab	€ 2,440	AQUARIUS DYNAMIC: 10112010XX80AQ
	2° Covidien	€ 3,000	FOLEY DOVER ARGYLE: 8887605122,8887605148, 8887605163,8887605189, 8887605205,8887605221, 8887605247,8887605262.
	3° Bard	€ 4,000	CAT. FOLEY BARD: 1658XXCE, 1661XXCE, 1668XXCE; INTERGLIDE CAT. : D6031XX
	4° Svas	€ 8,500	CATETERE SECURDRAIN: 11501392, 11501392101, 11501392121, 11501392241
	5° Coloplast	€ 9,475	FOLYSIL CATETERE: AA66XX;
	6° Teleflex	€ 9,490	PROFILCATH PLUS AQUA FLATE: 850086. 850088; PROFILCATH PRECONESSO: 851086-000XX0

28	1° Air Liquid	€ 0,0706	CATETERE URETRALE NELATON FEMMINILE: 01931301,01931311,01931321,01931331,01931341,01931351, 01931361
	2° Benefis	€ 0,074	NELATON CATHETER FEMALE: 195XX051;
	3° Svas	€ 0,210	CATETERE FEMMINILE PENNINE: FC14XX;
	4° Convatec	€ 0,228	UNO FEMALE: 02016022, 02017022,02019022, 02056022,02057022, 02058022, 02062022;
	5° Teleflex	€ 0,229	ERUPLAST PLUS: 850160, 850164
29	1° Air Liquid	€ 0,0706	CATETERE URETRALE NELATON MASCHILE: 01931201, 01931211, 01931221, 01931231, 01931241, 01931251, 01931261, 01931271, 01931281, 01931291
	2° Benefis	€ 0,074	NELATON CATHETER PER UOMO: 195XX011
	3° Svas	€ 0,210	CATETERE NELATON PENNINE: NC12XX
	4° Convatec	€ 0,228	UNO NELATON: 01004022,01007022,01008022, 01009022,01013022,01015022, 01047022,01054022,01055022;
	5° Teleflex	€ 0,229	EUROPLAST PLUS : 850162
30	1° Covicien	€ 0,819	VaQua CATETERE AUTOLUBRIFICANTE: VAQ08P,VAQ10P
	2° Lombarda H	€ 1,07588	HOMECATH PEDIATRICO: HCP2006,HCPC2208, HCP2010, HCP3006,HCP3008,HCP3010; HOMECATH PLUS: HCPSN2006,HCPNS2008, HCPSN2010, HCPSN3006, HCPS3008, HCPSN3010;
	3° Coloplast	€ 1,506	EASICATH: 5086,5088,5090,5006,5008,5010 SPEEDICATH: 28608,28610,28612,28706,28708, 28710;
	4° (*) Dentsply	€ 1,509	LOFRIC PRIMO POBE BAMBINO: 4110630,4110830,4111030; LOFRIC POBE BAMBINO: 4010630,4010830,4011030;
	5° (*) B. Braun	€ 1,509	ACTREEN LITE NELATON CH 6: 228306F; ACTREEN GLYS CATH CH 6 : 225306F;
31	1° Covicien	€ 0,819	VaQua CATETERE AUTOLUBRIFICANTE: VAQ08P,VAQ10P
	2° Lombarda H	€ 1,07588	HOMECATH PEDIATRICO: HCP2006,HCPC2208, HCP2010, HCP3006,HCP3008,HCP3010; HOMECATH PLUS: HCPSN2006,HCPNS2008, HCPSN2010, HCPSN3006, HCPS3008, HCPSN3010;
	3° Bard	€ 1,300	INTERGLIDE TIPO BAMBINO: D603208, D603210;
	4° Coloplast	€ 1,506	EASICATH: 5086,5088,5090,5006,5008,5010 SPEEDICATH: 28608,28610,28612,28706,28708, 28710;
	5° (*) Dentsply	€ 1,509	LOFRIC PRIMO POBE BAMBINO: 4110630,4110830,4111030; LOFRIC POBE BAMBINO: 4010630,4010830,4011030;
	6° (*) B. Braun	€ 1,509	ACTREEN LITE NELATON CH 6: 228306F; ACTREEN GLYS CATH CH 6 : 225306F;
	7° (*) Teleflex	€ 1,509	FLOCATH HYDROGEL: 851131,851132
32	1° Covicien	€ 0,797	CATETERE VAQUA DONNA AUTOLUBRIFICANTE: VAQ08F,VAQ10F,VAQ12F, VAQ14F,VAQ16F,VAQ18F
	2° Lombarda H	€ 1,07588	HOMECATH PEDIATRICO: HCP2006,HCPC2208, HCP2010, HCP3006,HCP3008,HCP3010; HOMECATH PLUS: HCPSN2006,HCPNS2008, HCPSN2010, HCPSN3006, HCPS3008, HCPSN3010; HOMECATH DONNA: HCF2012,HCF2014, HCF2016;

			HOMECATH PLUS DONNA: HCFSN2012, HCFSN2014, HCFSN2016;
	3° Bard	€ 1,300	INTERGLIDE TIPO BAMBINO: D603208, D603210; INTERGLIDE TIPO DONNA: D6031XX;
	4° B.Emun	€ 1,500	ACTREEN LITE NELATON: 228208F, 228210F,228212F,228214F,228216F, 228218F,228308F,228310F,228312F,228314F,228316F,228010F,228012F,228014F ACTREEN GLYS CATH NELATON : 225208F,225210F,225212F,225214F,225216F,225218F, 225308F,225310F,225312F,225314F,225316F
	5° Svas	€ 1,550	PRELUBE PENNINE (FEMMINILE): FC16XX
	6° Coloplast	€ 1,598	EASICATH: 5086,5088,5090,5368,5370,5372, 5374,5376,5006,5008,5010 SPEEDICATH: 20508,28510,28512,28514,28516, 28608,28610,28612,28706,28708, 28710; EASICATH CON LUER LOCK: 5270,5272,5274; SPEEDICATH COMPACT: 285XX; SPEEDICATH COMPACT PLUS: 28810,28812,28814;
	7° (*) Teleflex	€ 1,599	FLOCATH HYDROGEL: 851121,851122; FLOCATH QUICK: 851221
	8° (*) Dentsply	€ 1,599	LOFRIC SENSE DONNA 15CM: 4160830,4161030,4161230, 4161430 LOFRIC PRIMO POBE BAMBINO: 4110630,4110830, 4111030; PRIMO POBE DONNA 20CM: 4130830,4131030,4131230, 4131430 ,4131630,4131830, LOFRIC PRIMO DONNA POBE 15CM: 4140830,4141030,4141230, 4141430 LOFRIC DONNA POBE 20CM: 4030830,4031030,4031230, 4031430,4031630,4031830, LOFRIC DONNA POBE 15CM: 4040830,4041030,4041230, 4041430 LOFRIC POBE BAMBINO: 4010630,4010830,4011030
	1° Cov. Gen	€ 0,819	CATERERE VAQUA UOMO AUTOLUBRIFICANTE: VAQ08M,VAQ10M,VAQ12M, VAQ14M,VAQ16M,VAQ18M
	2° Lombarda H	€ 1,07588	HOMECATH UOMO: HCM4006, HCM4008,HCM4010,HCM4012,HCM4014,HCM4016,HCM4018; HOMECATH PLUS UOMO: HCMSN4006, HCMSN4008, HCMSN4010,HCMSN4012, HCMSN4014,HCMSN4016,HCMSN4018; ;
	3° Bard	€ 1,300	INTERGLIDE TIPO UOMO: DSA30XX
	4° B. Braun	€ 1,500	ACTREEN LITE NELATON: 228208F, 228210F,228212F,228214F,228216F, 228218F, ACTREEN LITE TIEMANN: 228108F,228110F,228112F,228114F, 228116F,228118F ACTREEN GLYS CATH NELATON: 225208F,225210F,225212F,225214F,225216F,225218F, ACTREEN GLYS CATH TIEMANN: 225108F,225110F,225112F,225114F, 225116F,225118F
	5° Svas	€ 1,550	PRELUBE PENNINE NELATON: NC16XX
33	6° Coloplast	€ 1,598	SPIDICATH TIEMANN: 28490,28492,28494 SPIDICATH CONTROL: 28212; SPIDICATH: 284XX EASICATH: 5348,5350,5352,5354,5356,5358, 5360,5362 EASICATH CON LUER LOCK: 5288,5290,5292,5296; EASICATH TEMANN: 538X;
	7° (*) Teleflex	€ 1,599	FLOCATH HYDROGEL: 851141,851142,851143; FLOCATH LUER LOCK: 850218; FLOCATH QUICK: 851241;
	8° (*) Dentsply	€ 1,599	LOFRIC PRIMO : 9600830,9601030,9601230, 9601430,9601630,9601830; LOFRIC POBE RAGAZZO: 4020830,4020830,4021030; LOFRIC ORIGO : 4431030,4431230,4431430, 4431630,4431830, 4420830,4421030,4421230;

34	1° Lornbarda H	€ 2,2888	HOME CATH UOMO KIT CATETERE IDROFILO: HKM4006, HKM4008, HKM4010, HKM4012, HKM4014, HKM4016, HKM4018; HOME CATH DONNA: HKF2012, HKF2014, HKF2016; HOME CATH PEDIATRICO: HKP2006, HKP2008, HKP2010, HKP3006, HKP3008, HKP3010
	2° B. Braun	€ 3,250	ACTREEN GLYS SET TIEMANN: 226108F, 226110F, 226112F, 226114F, 226116F ACTREEN GLYS SET NELATON: 226208F, 226210F, 226212F, 226214F, 226216F, 226218F, 226306F, 226308F, 226310F, 226312F, 226314F, 226316F
	3° Svas	€ 3,960	CATETERE VESCICALE LUBRIFICATO CON SACCA O'NEIL: NC16XX/BG
	4° (*) Teleflex	€ 3,990	VIALOG LIBERO: 5400XXG; LIBERO PLUS: 5000XXG, 500210G; CATETERE LIQUICK PLUS: 6200XX, 6202XX; FLOCATH INTROGEL: 8516XX;
	5° (*) Coloplast	€ 3,990	EASICATH SET: 280XX; SPEEDICATH COMPLETE: 284XX;
	6° Densply	€ 3,995	LOFRIC HYDRO KIT II UOMO: 9830830, 9831030, 9831230, 9831430, 9831630, 9831830 LOFRIC HYDRO KIT POBE BAMBINO: 4210630, 4210830, 4211030 LOFRIC HYDRO KIT POBE DONNA: 4230830, 4231030, 4231240, 4231430, 4231630, 4231830 LOFRIC HYDRO KIT II TIEMANN: 9871030, 9871230, 9871430, 9871630, 9871830
35	1° Coloplast	€ 27,950	CATETERE AC68++: AC68XX;
	2° Teleflex	€ 27,990	PROTESI URETEROCUTANEO STOMIA: 850275-0000XX, 850276-0000XX, 850270-0000XX, 850271-0000XX, 850281
36	1° (*) Teleflex	€ 5,999	SLKOSPRAY: 850699;
37	1° Beneris	€ 0,171	MALE CATH: GS1010-XX
	2° Covicien	€ 0,189	CAT. ESTERNO DOVER TEXAS: 8884730300;
	3° Hollister	€ 0,860	INVIEW: 972XX, 971XX, 973XX; EXTENDED WEAR: 9206, 9207, 9208, 9209;
	4° (*) Teleflex	€ 0,868	CAT. RUECCO :854460; SILKOKONDOM: 850327, 850328, 850329;
	5° (*) Coloplast	€ 0,868	CONVEEN GUAINE CON STRISCIA: 5120, 5125, 5130, 5135, 5140; CONVEEN GUAINE AUTOADESIVE: 5212, 5200, 5205, 5210, 5215; CONVEEN GUAINE CON STRISCIA SECURITY + : 5021, 5025, 5030, 5035, 5040; CONVEEN GUAINE AUTOADESIVI SECURITY + : 5221, 5225, 5230, 5235, 5240; CONVEEN OPTIMA GUAINE AUTOADESIVE: 22025, 22030, 22035, 22040;
38	1° Convatec	€ 0,280	UNOLEGBAG: 29.003.020
	2° (*) Hollister	€ 0,310	SACCA DA GAMBA CON RUBINETTO DI SCARICO E SISTEMA ANTIREFLUSSO: 9034-30, 9034-250, 935-30 SACCA DA GAMBA CON RUBINETTO DI SCARICO E SISTEMA ANTIREFLUSSO E SISTEMA ANTI SCIABORDIO: 9031-30, 9032-30
	3° (*) Teleflex	€ 0,310	SACCHE URINA DA GAMBA: 85034X, 850331, 850333, 850330, 850332;
	4° Coloplast	€ 0,318	CONVEEN CONFORT MONOUSO: 21062, 21063, 21064, 21065; SPEEDIBAG COMPACT: 28592;
39	1° Teleflex	€ 1,390	SACCA URINA DA GAMBA: 850352, 850354;
	2° Coloplast	€ 1,398	CONVEEN SACCA DA GAMBA SECURITY+: 5160, 5161; CONVEEN ACTIVE SACCA DA GAMBA CON VELCRO INCORPORATO: 25501;

40	1° Corvatec	€ 0,090	UNOPHARMAP1BEDBAG: 35.906.020
	2° Berofis	€ 0,117	SACCA URINA STANDARD con morsetto: 2230013
41	1° Berofis	€ 0,142	SACCA URINA CON VALVOLA E RUBINETTO :22310013
	2° Clinifab	€ 0,648	SACCA PER URINA UNOMEDICAL A4 CONVATEC (STERILE): 3815515
	3° Corvatec	€ 0,690	UNOPHARMAPLASTP4: 38.715.1S 20
	4° Teleflex	€ 1,990	sacca raccogliurina : 850414 ; SACCA DA LETTO CON RUBINETTO: 850412 e 850419;



